

SLE6000

Istruzioni per l'uso

V2.0.90

V2.0.92



When the smallest thing matters



SLE Limited
Twin Bridges Business Park
232 Selsdon Road
South Croydon
Surrey CR2 6PL

CE 2797

Telefono: **+44 (0)20 8681 1414**

Fax: **+44 (0)20 8649 8570**

E-mail: **sales@sle.co.uk**

Sito Web: **www.sle.co.uk**



Questo manuale è destinato all'uso solo con:
i ventilatori neonatali SLE6000.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi di recupero o trasmessa in qualsivoglia forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, mediante fotocopia, registrazione o altro, senza il preliminare consenso di SLE.

OxyGenie® è un marchio registrato nel SEE.

Distributore

© Copyright SLE 13/03/2020
Rif documento: UM165/IT numero 6

REF UM165/IT

Indice rapido

Questo indice consente agli utenti di spostarsi direttamente alle aree di interesse.
È disponibile una pagina con i contenuti completi dell'indice: 5.

Sezione	Pagina
Selezione circuito paziente per ventilazione invasiva e modifica per ventilazione non invasiva	50
Configurazione ventilatore Ventilazione invasiva	66
Configurazione ventilatore Ventilazione non invasiva - Circuito paziente a doppia sezione	82
Configurazione ventilatore Ventilazione non invasiva - Circuito paziente a sezione singola	90
Configurazione ventilatore Ventilazione non invasiva - Terapia con cannula nasale ad alto flusso	94
Funzionamento base modalità invasiva	
CPAP	66
CMV	68
PTV	70
PSV	72
SIMV	74
HFOV	76
HFOV+CMV	78
Funzionamento base modalità non invasiva - Circuito paziente a doppia sezione	
nCPAP	82
NIPPV	84
NIPPV Tr.	86
nHFOV	88
Funzionamento base modalità non invasiva - Circuito paziente a sezione singola	
NCPAP	90
DuoPAP	92
Alti Flussi	94
Informazioni tecniche	
Sensori SpO₂ e etCO₂	98
OxyGenie®	110
Descrizione dell'interfaccia utente	128
Dati tecnici	147
Risoluzione dei problemi	244
Verifica funzionale	252
Preferenze operatore	266
Istruzioni di installazione	260

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Indice

1. Introduzione	14
1.1 Moduli software (V2.0)	14
2. Descrizione delle modalità di ventilazione (invasive)	15
2.1 CPAP	15
2.2 CMV	16
2.3 PTV	16
2.4 PSV	17
2.5 SIMV	17
2.6 HFOV	18
2.7 HFOV+CMV	19
3. Descrizione delle modalità di ventilazione (circuiti paziente a doppio lume - non invasivi)	19
3.1 nCPAP	19
3.2 NIPPV	19
3.3 NIPPV Tr.	20
3.4 nHFOV	21
4. Descrizione delle modalità di ventilazione (circuiti paziente a singolo lume - non invasivi)	21
4.1 nCPAP	21
4.2 DuoPAP	22
5. Descrizione delle modalità di ventilazione (Non Invasiva - cannula O2)	22
5.1 Alti Flussi	22
6. Uso previsto di SLE6000	24
6.1 Riepilogo	24
6.1.1 Indicazione medica	24
6.1.2 Controindicazione medica	24
6.1.3 Tipo di paziente	24
6.1.4 Apparato del paziente sotto trattamento	24
6.1.5 Terapia clinica	24
6.1.6 Profilo utente principale	24
6.2 Condizioni d'uso	24
7. Avvertenze e avvisi - Ventilatore	26
7.1 Avvertenze- generale	26
7.2 Avvertenze - EMC	27
7.3 Avvisi - EMC	27
7.4 Avvertenze - circuito paziente e umidificatore	27
7.5 Avvertenze - nCPAP (Singolo lume)	28
7.6 Avvertenze- cliniche	28
7.6.1 Monitoraggio	28
7.6.2 Clinico - invasivo	28
7.6.3 Clinico - non invasivo	28
7.7 Avvisi - generali	28
7.7.1 Filtri batterici	29
7.7.2 Sensore di flusso	29
7.8 Avvisi - clinici	29
8. Avvertenze e avvisi - Sensori esterni	29
8.1 Avvertenze per Masimo SET®	29
8.2 Avvisi per Masimo SET®	30
8.2.1 Informazioni generali	30
8.2.2 Pulizia	31
8.2.3 Avvisi per allarmi	31
8.2.4 Avvisi per le misure	31
8.2.5 Avvisi per i sensori Masimo	32
8.3 Avvertenze per Oridion Micropod™	33
8.4 Avvisi per Oridion Micropod™	34
9. Avvertenze e avvisi - OxyGenie®	35
9.1 Avvertenze per OxyGenie®	35
9.2 Avvisi per OxyGenie®	35
9.3 Avvertenze cliniche	35
10. Layout ventilatore	38
10.1 Parte anteriore	38
10.2 Parte posteriore	39
11. Configurazione base del ventilatore	42
11.1 Ispezione sull'uso preliminare	42
11.2 Collegamento del cavo di collegamento equipotenziale	42
11.3 Collegamento dell'alimentazione elettrica di rete	42
11.3.1 Cavi di alimentazione in base alla specifica IEC/BS 1363/A3	42
11.3.2 Cavi di alimentazione in base alla specifica Schuko e NEMA	42
11.4 Collegamento di alimentazione ausiliario 24 V CC	42
11.4.1 Alimentazione di rete o ausiliaria - spia stato interruttore di alimentazione	43
11.5 Montaggio del silenziatore e del blocco di esalazione	43
11.6 Collegamenti gas	43
11.7 Ventilatore - posizione di paziente e operatore	43
11.8 Accensione del ventilatore	44
11.8.1 Con alimentazione di rete collegata	44

11.8.2 Senza alimentazione di rete collegata.....	44	12.6 Modifica dei circuiti BC6188 o BC6188/DHW per Alti flussi - Singolo lume non invasiva.....	61
11.8.3 Con alimentazione CC connessa	44	12.6.1 Filtri batterici	61
11.9 Test funzionale sull'uso preliminare	44	12.6.2 Camera di umidificazione	61
11.9.1 Accensione per test automatico	44	12.6.3 Montaggio delle sonde di temperatura	62
11.9.2 Verifica alimentazione inversa	44	12.6.4 Montaggio di una cannula nasale per terapia con ossigeno.	63
11.9.3 Selezione circuito paziente.....	45	13. Ventilazione - Invasiva	66
11.9.4 Verifiche test prima dell'uso.....	45	13.1 CPAP	66
11.9.5 Test funzionale (Doppio lume invasivo).....	45	13.2 CMV	68
11.9.6 Test funzionale (Doppio lume non invasivo)....	46	13.3 PTV	70
11.9.7 Test funzionale (sezione singola non invasiva).....	46	13.4 PSV	72
11.10 Spegnimento del ventilatore	47	13.5 SIMV.....	74
11.10.1 Isolamento dall'alimentazione di rete	47	13.6 HFOV	76
12. Selezione circuito paziente	50	13.7 HFOV+CMV	78
12.1 Tipo di ventilazione.....	50	13.8 Avvertenze comuni	80
12.1.1 Invasiva	50	13.9 Avvisi comuni.....	80
12.1.2 Non invasiva (sezione doppia).....	50	13.9.1 Funzioni alternative comuni (ventilazione convenzionale).....	80
12.1.3 Non invasivo (singolo lume).....	50	13.9.1.1 Respiro manuale o pausa inspiratoria	80
12.1.4 Alti flussi non invasivi (singolo lume).....	50	13.9.1.2 Incremento O ₂ o aspirazione O ₂	80
12.1.4.1 Selezione circuito paziente	50	13.9.2 Funzioni alternative comuni (ventilazione ad alta frequenza)	80
12.2 Montaggio del circuito paziente BC6188 (Ø 10 mm) o BC6198 (Ø 15 mm).....	50	13.9.2.1 Sigh o Pausa respirone	80
12.2.1 Filtri batterici.....	50	13.9.2.2 Incremento O ₂ o aspirazione O ₂	80
12.2.2 Camera di umidificazione.....	51	13.10 Ventilazione senza sensore di flusso	80
12.2.3 Montaggio delle sonde di temperatura sul circuito paziente BC6188.....	52	14. Non-invasiva - Sezione doppia	82
12.2.4 Montaggio delle sonde di temperatura sul circuito paziente BC6198.....	52	14.1 nCPAP D	82
12.2.5 Montaggio del sensore di flusso sul circuito paziente BC6188.....	53	14.2 NIPPV D.....	84
12.2.6 Montaggio del sensore di flusso sul circuito paziente BC6198.....	53	14.3 NIPPV Tr.....	86
12.2.7 Montaggio del polmone di prova	53	14.4 nHFOV	88
12.3 Montaggio del circuito paziente BC6188/DHW.....	54	15. Non-invasiva - Singolo lume	90
12.3.1 Filtri batterici.....	54	15.1 nCPAP S.....	90
12.3.2 Camera di umidificazione.....	54	15.2 DuoPAP	92
12.3.3 Montaggio del polmone di prova	56	15.3 cAlti Flussi	94
12.4 Modifica dei circuiti BC6188 o BC6188/DHW per una ventilazione a doppio lume non invasiva.....	57	15.4 Avvertenze comuni	96
12.4.1 Montaggio di un generatore nCPAP a doppio lume.	57	15.5 Avvisi comuni.....	96
12.5 Modifica dei circuiti BC6188 o BC6188/DHW per ventilazione a singolo lume non invasivo.	58	15.6 Nota comune	96
12.5.1 Filtri batterici.....	58	16. Monitoraggio SpO₂ ed etCO₂	98
12.5.2 Camera di umidificazione.....	58	16.1 Monitoraggio SpO ₂ (Masimo SET).....	98
12.5.3 Montaggio delle sonde di temperatura.....	59	16.1.1 Principio di funzionamento	98
12.5.4 Montaggio di un generatore nCPAP a singolo lume.....	60	16.2 Collegamento Masimo SET®.....	99
		16.2.1 Collegamento al ventilatore.....	99
		16.2.2 Disconnessione	99
		16.2.3 Selezione dei sensori Masimo SET®.....	99
		16.2.4 Siti di applicazione del sensore	99
		16.2.5 Collegamento di un sensore.....	99
		16.2.6 Disconnessione	99

16.3 Configurazione	100	17.1.1.2 Modalità alternativa:	110
16.3.1 ON/OFF monitoraggio SpO ₂	100	17.1.1.3 Override manuale	111
16.3.2 FastSat™	100	17.1.1.4 Modalità inattiva.....	111
16.3.3 Tempo medio.....	100	17.2 OxyGenie® Modalità alternativa	111
16.3.4 Ritardo allarmi	100	17.2.1 Verifica della risposta OxyGenie®	111
16.3.5 Auto O2: limiti di allarme intervallo stabilito SpO ₂	100	17.2.2 Attivazione di OxyGenie®	111
16.3.6 Sensibilità SpO ₂	100	17.2.3 Disattivazione di OxyGenie®	111
16.3.7 Desaturazione rapida	101	17.2.4 Attivazione override manuale	112
16.3.8 Indice perf.	101	17.2.5 Modifica dell'intervallo stabilito SpO ₂	112
16.4 Valori monitorati.....	101	17.2.6 Tempo medio	112
16.5 Soglie di allarmi SpO ₂	101	17.3 Opzione display forma d'onda SpO ₂ e OxyGenie®	112
16.6 Forma d'onda SpO ₂ e opzioni di visualizzazione	101	17.4 OxyGenie® e Aumento O ₂	113
16.7 Opzione display forma d'onda standard.....	102	17.5 OxyGenie® e aspirazione O ₂	113
16.7.0.1 SpO ₂ e visualizzazione forma d'onda doppia etCO ₂	102	18. Funzioni operative 116	
16.8 Opzione display forma d'onda SpO ₂	102	18.1 Informazioni generali	116
16.8.1 Forma d'onda SpO ₂ in Alti Flussi	103	18.1.1 Modalità Attesa	116
16.9 Test del modulo SpO ₂	103	18.1.2 Allarme apnea impostato su "Off"	116
16.10 Funzionamento durante l'interruzione di alimentazione elettrica (Mancanza di alimentazione elettrica)	103	18.1.3 Fonte di alimentazione di riserva	116
16.11 Monitoraggio EtCO ₂ (MicroPod™)	104	18.1.4 Memoria parametri	116
16.11.1 Principio di funzionamento	104	18.1.5 Rapporto I:E variabile HFO (Disponibile solo con le opzioni HFOV e NHFOV)	116
16.11.2 Collegamento al ventilatore	104	18.1.6 Respiri di supporto pressorio non forniti come impostato	117
16.11.3 Tempo di inizializzazione	104	18.1.7 Sensibilità del trigger	117
16.11.4 Disconnessione	104	18.1.8 Ventilazione a volume prefissato, Vte (VTV) ...	117
16.11.5 Montaggio del modulo	104	18.1.8.1 Ti (T insp).....	117
16.11.6 Collegamento di una linea del filtro™	105	18.1.8.2 Risoluzione Vte obiettivo	117
16.12 Configurazione	105	18.1.9 T insp max in PSV	117
16.12.1 Monitoraggio EtCO ₂	105	18.1.10 Aspirazione (aspirazione chiusa).....	117
16.12.2 Controllo pompa	105	18.1.11 VTV e HFOV	117
16.12.3 Tempo di allarme per assenza di respiro	105	18.1.11.1 Risoluzione Vte obiettivo	117
16.12.4 Informazioni sul dispositivo	105	18.2 Tipi di compensazione di perdita	118
16.13 Forme d'onda	106	18.2.1 VTV e perdita al paziente	118
16.13.0.1 Visualizzazione forma d'onda doppia EtCO ₂ e SpO ₂	106	18.2.2 Modalità NIV e perdita paziente	118
16.14 Valori monitorati.....	106	18.2.3 Compensazione perdita automatica modalità PSV.....	118
16.15 Soglie di allarmi EtCO ₂	106	18.3 Aspirazione O ₂	118
16.16 Compensazione della misurazione del flusso quando si utilizza il monitoraggio etCO ₂ del flusso laterale.	106	18.4 Aumento O ₂	119
16.17 Test del modulo EtCO ₂	106	18.5 Soglie di allarme	120
16.18 Note operative relative al monitoraggio etCO ₂ utiizzando MicroPod™	106	18.5.1 Soglie di allarme per modalità convenzionali (invasiva e non invasiva - doppio lume).....	120
16.19 Funzionamento durante l'interruzione di alimentazione elettrica (Mancanza di alimentazione elettrica)	107	18.5.2 Le soglie di allarme per le modalità oscillatorie (invasiva e non invasiva - doppio lume).....	121
16.20 Pulizia della custodia MicroPod™	107	18.5.2.1 HFOV e NHFOV	121
17. OxyGenie® 110		18.5.2.2 HFOV+CMV (invasiva - doppio lume)	122
17.1 Introduzione	110	18.5.3 Soglie di allarme per modalità convenzionali (non invasiva - singolo lume).....	122
17.1.1 Modalità di funzionamento OxyGenie®	110	18.5.4 Funzionamento dell'allarme di soglia di alta pressione.	123
17.1.1.1 Modalità auto.....	110	18.5.5 Funzionamento dell'allarme di soglia di bassa pressione.....	123

18.6 Circuiti paziente, umidificazione e terapia con ossido nitrico	124
18.6.1 Ventilazione invasiva e camere di umidificazione ad alimentazione automatica	124
18.6.2 Ventilazione non invasiva e camere di umidificazione ad alimentazione automatica.....	124
18.6.3 Terapia con ossido nitrico.....	124
18.6.4 Erogazione di farmaci per aerosol	125
18.6.4.1 Erogazione di farmaci per aerosol con Aerogen®.....	125
18.7 Uso del ventilatore SLE6000 con i compressori ad aria medici SLE500E e SLE500S.....	125

19. Descrizione dell'interfaccia utente 128

19.1 Modalità Attesa.....	128
19.1.1 Interfaccia utente (1)	128
19.1.2 Pannello informazioni (2)	128
19.1.3 Barra informazioni (3).....	128
19.1.4 Pulsante generico/funzioni pannello	128
19.1.4.1 Funzioni pannello.....	128
19.1.4.2 Scadenza parametro.....	128
19.1.4.3 Scadenza pannello.....	128
19.1.4.4 Stati Pulsante	128
19.1.4.5 Pulsante Modalità (A).....	128
19.1.4.6 Pulsante Avvia/Riprendi ventilazione (E).....	128
19.1.4.7 Allarmi (B).....	128
19.1.4.8 Pulsante Strumenti (C).....	128
19.1.4.9 Pulsante Calibrazione e Strumenti (F) ...	129
19.1.4.10 Pulsante Grafici (D).....	129
19.1.4.11 Pulsante Multifunzione (G).....	129
19.1.5 Pulsante Modalità e Avvia/Riprendi ventilazione	129
19.1.6 Pulsante Allarme	129
19.1.6.1 Scheda Limiti	129
19.1.6.2 Scheda Registro.....	130
19.1.6.3 Scheda Volume.....	130
19.1.7 Pulsante Strumenti & Calibrazione & Strumenti.....	130
19.1.7.1 Scheda Sensori (senza sensori esterni).....	131
19.1.7.2 Scheda Sensori (con sensori esterni)	131
19.1.7.3 Scheda Luminosità.....	131
19.1.7.4 Scheda Sistema	132
19.1.7.5 Scheda Dati.....	133
19.1.7.6 Download foto schermata	134
19.1.8 Scheda Grafici.....	135
19.1.8.1 Forme d'onda	136
19.1.8.2 Loop	136
19.1.9 Cattura, recupero ed eliminazione dei loop....	137
19.1.9.1 Per acquisire i Loop	137
19.1.9.2 Trend	137
19.1.9.3 Display andamento singolo e doppio	138
19.1.9.4 Visualizzazione andamenti.....	138
19.2 Modalità di ventilazione.....	140
19.2.1 Pulsante silenziamento	

e pre-silenziamento allarme (A)	140
19.2.2 Parametri	140
19.2.2.1 Tipi di parametri	140
19.2.2.2 Stati parametro	140
19.2.2.3 Modifica di un parametro	140
19.2.2.4 Accensione di una funzione parametro	140
19.2.3 Modalità Anteprema.....	141
19.2.4 Selezione circuito paziente.....	141
19.2.5 Valori monitorati.....	141
19.2.5.1 Grafico colonna singola/colonna doppia.....	141
19.2.6 Scheda Allarmi - modalità ventilatoria	142
19.2.6.1 Regolazione della soglia di allarme	142
19.2.6.2 Tracciatura automatica allarme/soglie impostate automaticamente	142
19.2.7 Registro e Volume	143
19.2.8 Scheda Strumenti - modalità ventilatoria... ..	143
19.2.8.1 Calibrazione sensore di flusso	143
19.2.8.2 Calibrazione O ₂	144
19.2.9 Scheda Luminosità - Modalità Ventilatoria ...	144
19.2.10 Scheda Sistema - Modalità Ventilatoria	144
19.2.11 Scheda Dati - modalità ventilatoria	144
19.2.12 Layout.....	144
19.2.13 Pulsante Blocco Funzioni	144
19.2.14 Pausa/play.....	144
19.2.15 Foto schermata	144
19.2.16 Barra Allarmi.....	145
19.2.17 Controlli specifici modalità	145
19.2.17.1 Respiro manuale (pausa inspiratoria).....	145
19.2.17.2 Sigh (Pausa Respire)	145
19.2.18 Pausa di oscillazione	145
19.2.19 Attività HFO	145

20. Descrizione tecnica 148

21. Descrizione delle modalità di ventilazione (invasiva) 149

21.1 CPAP	149
21.2 CMV	149
21.2.1 CMV & VTV	149
21.3 PTV	149
21.3.1 PTV & VTV	149
21.4 PSV	149
21.4.1 PSV & VTV	149
21.5 SIMV.....	149
21.5.1 SIMV con Supporto Press.	150
21.5.2 SIMV & VTV	150
21.6 HFOV	150
21.6.1 HFO & VTV	150
21.7 HFOV+CMV	150

22. Descrizione delle modalità di ventilazione (non invasive) 150

22.1 nCPAP (sezione singola o doppia).....	150
22.2 NIPPV (doppio lume).....	150
22.3 NIPPV Tr. (Doppio lume).....	150

22.4 nHFOV (Doppio lume solo)	150	25.5.6 Precisione respiro controllato dalla pressione (ventilazione non invasiva)	165
22.5 Terapia O ₂ (a singolo lume).....	150	25.5.7 Parametri misurati.....	165
23. Routine di calibrazione dell'ossigeno	151	25.5.7.1 Concentrazione ossigeno	166
23.1 Calibrazione di O ₂ a un punto	151	25.5.7.2 Pressione.....	166
23.2 Calibrazione O ₂ a due punti	151	25.5.7.3 Trend	166
24. N5402-REV2 & N5302 sensore di flusso	152	25.5.7.4 Livello pressione sonora.....	166
24.1 Calibrazione del sensore di flusso	152	25.5.7.5 Dimensioni dei getti della porta del blocco di esalazione	166
24.2 Pulizia e sterilizzazione profonda del sensore N5402-REV2	153	25.5.8 Dichiarazione BS EN ISO 80601-2-12	166
24.2.1 Pulizia:.....	153	25.5.9 Incertezze di misurazione.....	167
24.2.2 Disinfezione:.....	153	25.6 Circuiti paziente.....	167
24.2.3 Sterilizzazione profonda	153	25.7 Filtri del sistema di respirazione	167
25. Specifiche tecniche	154	25.7.1 N3029.....	167
25.1 Modalità operative - Ventilazione invasiva convenzionale	154	25.7.2 N3587	167
25.1.1 Modalità CPAP	154	25.7.3 N3588	167
25.1.2 Modalità CMV.....	154	25.8 Pressioni limitate massime	167
25.1.3 Modalità PTV.....	155	25.9 Alimentazioni gas.....	167
25.1.4 Modalità PSV	155	25.9.1 Alimentazione ossigeno.....	167
25.1.5 Modalità SIMV	156	25.9.2 Alimentazione aria	167
25.1.6 Modalità HFOV.....	156	25.9.2.1 Connettori.....	168
25.1.7 Modalità HFOV+CMV.....	157	25.9.3 Flussi	168
25.2 Modalità operative Convenzionale Non invasiva Ventilazione	157	25.10 Durata utile	168
25.2.1 Modalità nCPAP D (doppio lume).....	157	25.11 Alimentazione, Dimensioni, Classificazione ...	168
25.2.2 Modalità NIPPV D (doppio lume)	158	25.11.1 Alimentazione CA.....	168
25.2.3 Modalità NIPPV Tr. (Doppio lume)	158	25.11.2 Alimentazione CC	168
25.2.4 Modalità nHFOV (Doppio lume)	158	25.12 Ambiente operativo.....	168
25.2.5 Modalità nCPAP S (a singolo lume)	159	25.12.1 Connettori.....	168
25.2.6 Modalità DuoPAP (a singolo lume).....	159	25.13 Classificazione (elettrica).....	168
25.2.7 Alti Flussi (a singolo lume)	159	25.14 Numero di classificazione GMDN.....	168
25.2.8 OxyGenie	159	25.15 Protezione IP	168
25.2.8.1 Attributi OxyGenie PCLCS	159	25.16 Condizioni ambientali di immagazzinaggio	168
25.3 Modalità di funzionamento	160	26. Porte di uscita (elettriche)	169
25.4 Controlli	160	26.1 Porta RS232	169
25.4.1 Pulsante Power	160	26.2 Uscita dati base SLE6000 (V2.0)	169
25.4.2 Interfaccia utente.....	160	26.2.1 Specifiche uscita dati base SLE6000 (V2.0).....	169
25.4.2.1 Pulsanti	160	26.2.2 Impostazioni di comunicazione (V2.0).....	169
25.4.2.2 Schede	162	26.2.2.1 Velocità dati e dimensioni (V2.0)	169
25.4.2.3 Controlli	163	26.2.2.2 Formato dati	169
25.5 Misurazione	164	26.2.3 Grafico dati	169
25.5.1 Sensore di flusso.....	164	26.2.4 Formato dati	170
25.5.2 Flusso.....	164	26.3 Uscita dati migliorata SLE6000 (V3.0).....	175
25.5.3 Volume	164	26.3.1 Specifiche uscita dati migliorata SLE6000 (V3.0).....	175
25.5.4 Precisione respiro controllato del volume .	164	26.3.2 Impostazioni di comunicazione (V3.0).....	175
25.5.5 Precisione respiro controllato dalla pressione (Ventilazione invasiva)	164	26.3.2.1 Velocità dati e dimensioni (V3.0)	175
		26.3.2.2 Formato dati	175
		26.3.3 Grafico dati	175
		26.3.4 Formato dati	176
		26.4 Vuelink & Intellibridge EC10	183
		26.4.1 Collegamento al monitor paziente VueLink	183
		26.4.2 Collegamento al modulo IntelliBridge EC10	183
		26.4.3 Descrizioni del parametro.....	184

26.4.4	Messaggi di allarme	185	30.4	Monitoraggio EtCO ₂ (allarmi di sistema)	226
26.4.5	Forma d'onda	187	30.5	Monitoraggio EtCO ₂ (allarmi paziente)	229
26.4.6	Grafico finestra attività VueLink.....	187	31. Messaggi di stato del sensore ...	231	
26.5	Chiamata infermiera.....	188	31.1	Messaggi di stato SpO ₂	231
26.5.1	Ritardo chiamata infermiera	188	31.2	Messaggi di stato EtCO ₂	232
26.6	Ethernet.....	188	32. Pulizia e disinfezione	235	
26.7	USB (Dati).....	188	32.1	Istruzioni	235
26.8	USB (alimentazione)	188	32.2	Istruzioni di pulizia della superficie esterna.....	235
26.9	Monitor esterno	188	32.3	Istruzioni per la disinfezione della superficie esterna	236
27. Porte di ingresso (elettriche)	189		32.4	Istruzioni di pulizia del blocco di esalazione	236
27.1	SpO ₂ e etCO ₂	189	32.5	Istruzioni di disinfezione del blocco di esalazione	236
27.2	Sensore di flusso.....	189	32.6	Istruzioni di disinfezione del silenziatore autoclavabile	236
27.3	DC 24V.....	189	32.7	Disinfezione delle porte del getto di gas.....	236
28. Specifiche del sensore	189		32.8	Valvola di occlusione	236
28.1	Masimo SET®	189	32.9	Pulizia del filtro di ingresso dell'aria principale.....	236
28.1.1	SpO ₂ (%) funzionale	189	33. Compliance elettromagnetica	237	
28.1.2	Frequenza pulsazioni (BPM).....	189	33.1	Livelli di compliance sul test delle emissioni	237
28.1.3	Indice perfusione (%)	190	33.2	Livelli di compliance sui test di immunità.....	237
28.1.3.1	Intervallo lunghezza d'onda sensore.....	190	33.3	Avvertenze - EMC.....	238
28.1.4	Note di precisione	190	33.4	Avvisi - EMC	238
28.1.5	Temperatura ambiente	191	34. Schema dell'unità pneumatica	239	
28.1.5.1	Condizioni di esercizio	191	34.1	Diagrammi pneumatici circuito paziente.....	240
28.1.5.2	Condizioni di immagazzinaggio.....	191	35. Identificazione della versione software	241	
28.1.5.3	Dichiarazione di licenza implicita	191	36. Tabella di individuazione e soluzione dei problemi	244	
28.2	MicroPod™	191	36.1	Problemi correlati alla ventilazione.....	244
28.2.1	Limiti di allarme	192	36.2	Problemi correlati al ventilatore	246
28.2.2	Formati di misurazione.....	192	36.3	Problemi correlati al sensore.....	249
28.2.3	Metodi di calcolo per capnografia	192	37. Manutenzione preventiva programmata (PPM)	252	
28.2.4	Temperatura ambiente	192	37.1	Pianificazione PPM	252
28.2.4.1	Condizioni di esercizio	192	37.2	Kit PPM	252
28.2.4.2	Condizioni di immagazzinaggio.....	192	37.2.1	Kit A	252
28.2.4.3	Marchi commerciali	192	37.2.2	Kit B	252
29. Allarmi	193		37.3	Numeri pezzi kit.....	252
29.1	Priorità allarme	193	37.4	Sostituzione cavo di alimentazione elettrica di rete.....	252
29.1.1	Caratteristiche di allarme	193	37.5	MicroPod™ PPM.....	253
29.1.2	Volume segnalatore acustico di allarme....	193	38. Verifica funzionale del ventilatore	253	
29.1.3	Log di allarmi.....	193	38.1	Test di allarme	253
29.2	Caratteristiche indicatori di allarme	193			
29.3	Tabella allarmi	196			
29.4	"Alimentazione guasta" tabella guasti	218			
29.5	"Ventilatore fuori taratura" tabella guasti	219			
29.6	"Guasto hardware del controller" tabella guasti.....	220			
29.7	"Guasto hardware monitor" tabella guasti	220			
30. Allarmi sensore	221				
30.1	Priorità allarme	221			
30.1.1	Messaggi di stato	221			
30.2	Monitoraggio SpO ₂ (allarmi di sistema)	222			
30.3	Monitoraggio SpO ₂ (allarmi paziente)	225			

38.1.1 Alta concentrazione di ossigeno/Bassa concentrazione di ossigeno/Test di allarme perdita di alimentazione del gas	253	42. Software Log viewer eventi e pazienti SLE 6000	270
38.1.2 Allarme di ostruzione - Gas fresco bloccato	254	42.1 Requisiti minimi di sistema	270
38.1.3 Allarme di occlusione parziale - Prolungata pressione positiva	254	42.1.1 Requisiti chiavetta memoria	270
38.1.4 Allarme alta pressione - Soglia alta pressione superata	254	42.2 Installazione del software	270
38.1.5 Allarme volume scaduto - Volume corrente oltre/sotto la soglia	254	42.3 Download dei Dati paziente o del log di eventi	270
38.1.6 Allarme Volume - Volume minuto sopra/sotto la soglia	254	42.4 Esporta formati di file	271
38.1.7 Allarme mancanza di alimentazione elettrica - Mancanza di alimentazione e verifica batteria	254	42.4.1 Tipi di file	271
38.2 Test di prestazioni	255	42.4.1.1 RealtimeLog	271
38.2.1 Convenzionale	255	42.4.1.2 AlarmsLog	271
38.2.2 Oscillatoria	255	42.4.1.3 TrendsDataLog	272
39. Verifica funzionale del sensore esterno	256	42.4.1.4 SystemLog	272
39.1 Masimo SET®	256	42.4.1.5 DebugLog	272
39.1.1 Verifica funzionale Masimo SET®	256	42.4.1.6 Record log	272
39.1.2 Allarmi Masimo SET® SpO ₂ e PR	256	42.5 Funzioni Log Viewer	273
39.2 MicroPod™	257	42.5.1 Carica file	273
39.2.1 Verifica funzionale di MicroPod™	257	42.5.2 Esporta in XML	273
39.2.2 Allarme MicroPod™ etCO ₂	257	42.5.3 Esporta in Excel	273
40. Istruzioni di installazione	260	42.5.3.1 Registro Eventi Allarmi / Trend	273
40.0.1 Strumenti richiesti per il montaggio del carrello	260	42.5.4 Filtro di ricerca	274
40.1 Disimballaggio	260	42.5.5 Carica dati andamento per giorno	274
40.2 Montaggio Medcart	261	42.5.6 Impostazioni Trend	274
40.2.1 Contenuto del kit Medcart	261	42.5.6.1 Pulsante Trend	274
40.2.2 Montaggio	261	42.5.6.2 Pulsante Dati andamento	274
40.3 Disimballaggio del ventilatore	262	42.5.7 Tutti i trend	274
40.4 Punti di sollevamento del ventilatore	263	42.5.8 Carica dati in tempo reale	274
40.5 Montaggio del ventilatore su Medcart	263	42.5.8.1 Dati d'onda	274
40.6 Collegamento del cavo di alimentazione elettrica	264	42.5.8.2 Curve intere	274
40.7 Test funzionale sull'uso preliminare	264	42.5.8.3 Curve	274
40.8 Configurazione del ventilatore	264	42.5.9 Opzione "UTAS"	275
41. Preferenze operatore	266	42.5.10 Calendario	275
41.1 Accesso alle preferenze operatore	266	42.5.11 Mostra dati ultimo giorno	275
41.1.1 Scheda Parametri	266	43. Formazione (utente)	277
41.1.1.1 Parametri	266	44. Formazione (assistenza)	277
41.1.2 Scheda Ventilazione	267	45. Parti consumabili e accessori	280
41.1.3 Scheda Allarmi	267	46. Glossario	285
41.1.4 Scheda Interfaccia	268	47. Marchi e simboli SLE6000	287
41.1.5 Scheda Regionale	268	47.1 Descrizione dei marchi del ventilatore	287
41.1.6 Scheda Salva / Esci	268	47.2 Descrizione dei marchi opzionali	288
		47.3 Descrizione dei marchi di interfaccia	288
		47.4 Descrizione dei marchi Micropod™	290

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.


Introduzione



1. Introduzione

Il ventilatore neonatale SLE6000 con software versione 2.0 ha un design modulare. Questa versione ha 9 moduli che si adattano al modulo centrale.

Il grafico in basso mostra come tutti i moduli quando acquistati si interfacciano con il modulo centrale.

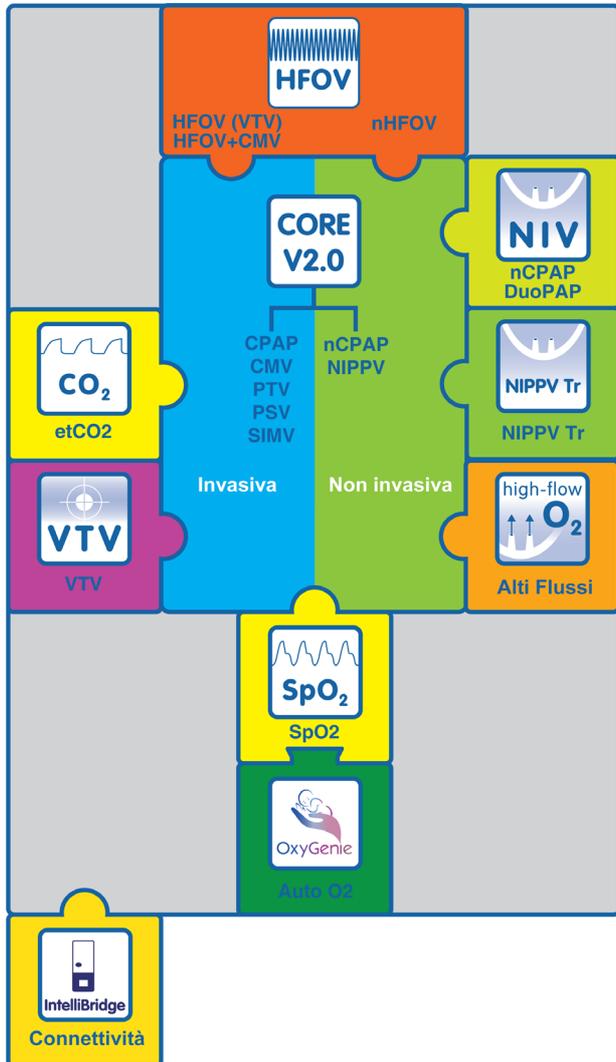

Tutti i moduli sono moduli software. Fare riferimento al lato del ventilatore per vedere le opzioni installate.

1.1 Moduli software (V2.0)

Modulo software di configurazione centrale

Il software principale è installato in tutti i ventilatori SLE6000 e include modalità invasive (CPAP, CMV, PTV, PSV, SIMV) e modalità non invasive (nCPAP, NIPPV) come standard.

Modulo software SLE6000 HFOV (incluso HFOV VTV)

Questo modulo software aggiunge la modalità HFOV al sistema SLE6000 consentendo l'uso di HFOV (doppio lume) invasivo e non invasivo. La ventilazione

HFOV invasiva include la sovrapposizione del VTV come standard.

Modulo software NIV a singolo lume SLE6000

Questo modulo software consente la ventilazione utilizzando nCPAP e DuoPAP con un circuito a singolo lume.

Modulo software SLE6000 NIPPV Tr.

Questo modulo software consente la ventilazione utilizzando NIPPV con supporto di respiri triggerati dal paziente con un circuito a doppio lume (non invasivo).

Modulo software per terapia con ossigeno SLE6000

Questo modulo software aggiunge gli alti flussi nasali utilizzando un circuito a singolo lume non invasivo.

Modulo software SLE6000 VTV (ventilazione convenzionale)

Questo modulo software aggiunge la funzione VTV a tutte le modalità di monitoraggio invasive convenzionali.

Modulo software di monitoraggio SLE6000 etCO₂

Questo modulo software aggiunge il software etCO₂ che permette a un Oridion MicroPod™ di interfacciarsi con SLE6000. Richiede un Oridion MicroPod™ e linee di campionatura neonatale.

Modulo software di monitoraggio SLE6000 Masimo SpO₂

Questo modulo software aggiunge il software SpO₂ che consente a un modulo Masimo uSpO₂ di interfacciarsi con il ventilatore SLE6000. Per funzionare richiede un cavo SLE uSpO₂ (Masimo SET) e sensori per infanti, neonatali e neonatali/pediatrici SpO₂.

Modulo software SLE6000 OxyGenie®

Questo modulo software aggiunge il sistema Auto-O₂ che è stato progettato per controllare la fornitura di ossigeno, in modo di mantenere la SpO₂ del paziente nell'intervallo predefinito di SpO₂.



Modulo software IntelliBridge SLE6000

Questo modulo software aggiunge la possibilità di connettere il sistema SLE 6000 ai sistemi di monitoraggio esterni forniti dai moduli Philips Vuelink e IntelliBridge.

2. Descrizione delle modalità di ventilazione (invasive)

Il ventilatore ha la possibilità di essere utilizzato come ventilatore a pressione controllata, volume prefissato, sia come ventilatore a pressione limitata, time cycled che come ventilatore ad alta frequenza oscillatoria (Disponibile solo con l'opzione.HFOV).

2.1 CPAP

Pressione positiva continua delle vie respiratorie



Il ventilatore genera una pressione positiva continua delle vie respiratorie impostata dall'utente. L'allarme di apnea suona se il paziente non compie alcun tentativo di respirazione entro il periodo di apnea impostato.

L'utente può impostare quanto segue:

- Ti (tempo inspiratorio)
- CPAP
- PIP
- O₂%

Pulsanti addizionali

- Supporto Apnea
- Fronte di salita
- Sensibilità del trigger (soglia di rilevamento del respiro di flusso o pressorio)

Allarmi

- PIP alta e bassa
- CPAP alta e bassa
- FR alta
- Tempo di apnea (può essere disattivato)

Allarmi disponibili quando il sensore di flusso è collegato

- Vte alto e basso
- Vmin alto e basso
- Perdita percentuale (attiva con sensore di flusso collegato)

Pulsanti Addizionali

- Pulsante Respiro manuale o Pausa


Caratteristiche del modulo SpO₂

- Forma d'onda Pletis se selezionata
- Soglie di allarme SpO₂ alta e bassa
- Soglie di allarme PR alta e bassa



Modulo OxyGenie® + SpO₂

- Intervallo stabilito SpO₂
- Allarme O₂% alta



Caratteristiche del modulo etCO₂

- Forma d'onda etCO₂ se selezionata
- Soglie di allarme etCO₂ alto e basso



2.2 CMV

Ventilazione obbligatoria continua

In questa modalità, il ciclo inspiratorio viene avviato dal ventilatore alla frequenza FR impostata. I respiri sono time cycled.



L'utente può impostare quanto segue:

- PEEP
- PIP
- RR (frequenza respiratoria)
- Ti (tempo inspiratorio)
- O₂%

Pulsanti addizionali

- Fronte di salita

Soglie di allarmi

- PIP alta e bassa
- PEEP alta e bassa

Allarmi disponibili quando il sensore di flusso è collegato

- Vte alto e basso
- Vmin alto e basso
- Perdita percentuale

Pulsanti Addizionali

- Pulsante Respiro manuale o Pausa

Caratteristiche del modulo VTV

- VTV sui respiri CMV



Caratteristiche del modulo SpO₂

- Forma d'onda Pletis se selezionata
- Soglie di allarme SpO₂ alta e bassa
- Soglie di allarme PR alta e bassa



Modulo OxyGenie®+ SpO₂

- Intervallo stabilito SpO₂
- Allarme O₂% alta



Caratteristiche del modulo etCO₂

- Forma d'onda etCO₂ se selezionata
- Soglie di allarme etCO₂ alto e basso



2.3 PTV

Ventilazione triggerata dal paziente



In questa modalità, tutti i tentativi di respirazione del paziente sono a supporto pressorio. Se non vengono identificate azioni ventilatorie del paziente, la ventilazione meccanica avviene ai parametri impostati (T insp, PEEP e PIP).

L'utente può impostare quanto segue:

- RR (frequenza respiratoria)
- Ti (tempo inspiratorio)
- PEEP
- PIP
- O₂%

Pulsanti addizionali

- Fronte di salita
- Sensibilità del trigger (soglia di rilevamento del respiro di flusso o pressorio)

Soglie di allarmi

- PIP alta e bassa
- PEEP alta e bassa
- FR alta
- Tempo di apnea (può essere disattivato)

Allarmi disponibili quando il sensore di flusso è collegato

- Vte alto e basso
- Vmin alto e basso
- Perdita percentuale

Pulsanti Addizionali

- Pulsante Respiro manuale o Pausa

Caratteristiche del modulo VTV

- VTV sui respiri del paziente



Caratteristiche del modulo SpO₂

- Forma d'onda Pletis se selezionata
- Soglie di allarme SpO₂ alta e bassa
- Soglie di allarme PR alta e bassa



Modulo OxyGenie®+ SpO₂

- Intervallo stabilito SpO₂
- Allarme O₂% alta



Caratteristiche del modulo etCO₂

- Forma d'onda etCO₂ se selezionata
- Soglie di allarme etCO₂ alto e basso



2.4 PSV

Ventilazione con supporto pressorio

È una modalità di ventilazione a pressione limitata nella quale ogni respiro è triggerato dal paziente e con supporto pressorio. Il respiro è triggerato dal paziente, con supporto pressorio e terminato dal paziente. Il bambino ha pertanto il controllo sull'intero ciclo, ovvero sul tempo inspiratorio, sulla frequenza e sul volume minuto. Questa forma di ventilazione è resa possibile dall'uso di un sensore di flusso posto tra il connettore del tubo endotracheale e il circuito paziente. Eventuali variazioni del segnale di flusso o volume identificano la presenza di respirazione spontanea.

L'utente può inoltre regolare la sensibilità di fine flusso (da 0% a 50%).

L'utente può impostare quanto segue:

- RR (frequenza respiratoria)
- Max Ti (tempo inspiratorio massimo.)
- PEEP
- PIP
- O₂%

Pulsanti aggiuntivi

- Fronte di salita
- Sensibilità del trigger (soglia di rilevamento del respiro di flusso o pressorio)
- Sensibilità fine flusso

Soglie di allarmi

- PIP alta e bassa
- PEEP alta e bassa
- FR alta
- Tempo di apnea (può essere disattivato)

Allarmi disponibili quando il sensore di flusso è collegato

- Vte alto e basso
- Vmin alto e basso
- Perdita percentuale

Pulsanti Aggiuntivi

- Pulsante Respiro manuale o Pausa

Caratteristiche del modulo VTV

- VTV su tutti i respiri



Caratteristiche del modulo SpO₂

- Forma d'onda Pletis se selezionata
- Soglie di allarme SpO₂ alta e bassa
- Soglie di allarme PR alta e bassa



Modulo OxyGenie®+ SpO₂

- Intervallo stabilito SpO₂
- Allarme O₂% alta



Caratteristiche del modulo etCO₂


- Forma d'onda etCO₂ se selezionata
- Soglie di allarme etCO₂ alto e basso




2.5 SIMV

Ventilazione obbligatoria intermittente sincronizzata

La frequenza degli atti respiratori obbligatori è determinata dal controllo RR. Nel momento in cui deve verificarsi un atto respiratorio obbligatorio, si apre una finestra di respirazione assistita e si attende l'azione ventilatoria del paziente. Allorché ciò si verifica, il ventilatore fornisce un atto respiratorio sincronizzato (respiri SIMV), al termine del quale la finestra di respirazione assistita si chiude fino al momento in cui deve verificarsi l'atto respiratorio successivo impostato.

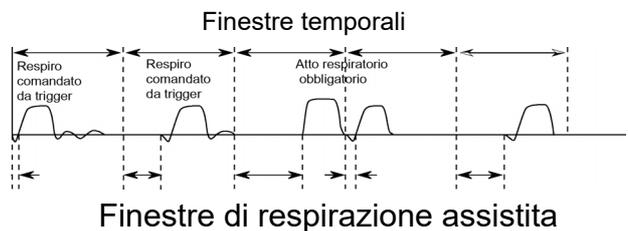

Se il ventilatore non rileva alcun tentativo di respirazione del paziente prima della fine della finestra temporale predefinita, viene generato un atto respiratorio obbligatorio. Il punto dell'atto respiratorio obbligatorio è la Finestra temporale meno il Tempo inspiratorio.

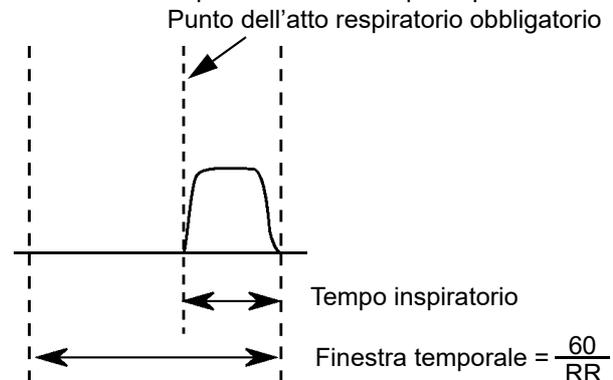

L'utente può impostare quanto segue:

- RR (frequenza respiratoria)
- Ti (tempo inspiratorio)
- PEEP
- PIP
- O₂%

Pulsanti aggiuntivi

- Fronte di salita
- Sensibilità del trigger (soglia di rilevamento del respiro di flusso o pressorio) – Azioni ventilatorie del paziente richieste per riconoscere il respiro.
- Supporto pressorio

Soglie di allarmi

- PIP alta e bassa
- PEEP alta e bassa
- FR alta
- Tempo di apnea (può essere disattivato)

Allarmi disponibili quando il sensore di flusso è collegato

- Vte alto e basso
- Vmin alto e basso
- Perdita percentuale

Caratteristiche del modulo VTV

- VTV su tutti i respiri



Caratteristiche del modulo SpO₂

- Forma d'onda Pletis se selezionata
- Soglie di allarme SpO₂ alta e bassa
- Soglie di allarme PR alta e bassa



Modulo OxyGenie®+ SpO₂

- Intervallo stabilito SpO₂
- Allarme O₂% alta



Caratteristiche del modulo etCO₂

- Forma d'onda etCO₂ se selezionata
- Soglie di allarme etCO₂ alto e basso



2.6 HFOV

Oscillazione ad alta frequenza



In questa modalità, il ventilatore fornisce una continua oscillazione ad alta frequenza per vie nasali e non vi è interazione con il paziente.

L'utente può impostare quanto segue:

- Frequenza
- Rapporto I:E
- MAP
- Delta P
- VTV
- O₂%

Pulsanti aggiuntivi

- Rr Respirone
- Per. Insp Resp
- Press. Resp.

Soglie di allarmi

- Paw alta e bassa

Allarmi disponibili quando il sensore di flusso è collegato

- Vte alto e basso
- Vmin alto e basso
- Perdita percentuale

Caratteristiche del modulo SpO₂

- Forma d'onda Pletis se selezionata
- Soglie di allarme SpO₂ alta e bassa
- Soglie di allarme PR alta e bassa



Modulo OxyGenie®+ SpO₂

- Intervallo stabilito SpO₂
- Allarme O₂% alta



2.7 HFOV+CMV

Una combinazione di oscillazioni durante la fase espiratoria o inspiratoria ed espiratoria di una ventilazione time cycled a pressione limitata in modalità CMV.



L'utente può impostare quanto segue:

- RR (frequenza respiratoria)
- Ti (tempo inspiratorio)
- Frequenza
- PEEP
- PIP
- Delta P
- O₂%

Pulsanti aggiuntivi

- Attività HFO

Caratteristiche del modulo SpO₂

- Forma d'onda Pletis se selezionata
- Soglie di allarme SpO₂ alta e bassa
- Soglie di allarme PR alta e bassa



Modulo OxyGenie®+ SpO₂

- Intervallo stabilito SpO₂
- Allarme O₂% alta



3. Descrizione delle modalità di ventilazione (circuiti paziente a doppio lume - non invasivi)

3.1 nCPAP

Pressione positiva continua delle respiratorie per via nasale.



Il ventilatore genera una pressione positiva continua delle vie respiratorie selezionata dall'utente.

L'utente può impostare quanto segue:

- Ti (tempo inspiratorio)
- CPAP
- PIP
- O₂%

Pulsanti aggiuntivi

- Supporto Apnea
- Fronte di salita
- Sensibilità del trigger Soglia di rilevamento del respiro pressorio – Azioni ventilatorie del paziente richieste per riconoscere il respiro.

Allarmi

- PIP alta e bassa
- CPAP alta e bassa
- FR alta
- Tempo di apnea (può essere disattivato)

Caratteristiche del modulo SpO₂

- Forma d'onda Pletis se selezionata
- Soglie di allarme SpO₂ alta e bassa
- Soglie di allarme PR alta e bassa



Modulo OxyGenie®+ SpO₂

- Intervallo stabilito SpO₂
- Allarme O₂% alta



3.2 NIPPV

Ventilazione con due livelli di pressione positive per vie nasali.



In questa modalità, il ciclo inspiratorio viene avviato dal ventilatore alla frequenza respiratoria impostata. I respiri sono time cycled.

L'utente può impostare quanto segue:

- RR (frequenza respiratoria)
- Ti (tempo inspiratorio)
- PEEP
- PIP
- O₂%

Pulsanti addizionali

- Fronte di salita

Allarmi

- PIP alta e bassa
- PEEP alta e bassa

Pulsanti Addizionali

- Pulsante Respiro manuale o Pausa

Caratteristiche del modulo SpO₂

- Forma d'onda Pletis se selezionata
- Soglie di allarme SpO₂ alta e bassa
- Soglie di allarme PR alta e bassa



Modulo OxyGenie®+ SpO₂

- Intervallo stabilito SpO₂
- Allarme O₂% alta



3.3 NIPPV Tr.

Ventilazione intermittente a pressione positiva con trigger per vie nasali (is the same as above)



In questa modalità, tutti i tentativi di respirazione del paziente sono a supporto pressorio. Se non vengono identificate azioni ventilatorie del paziente, la ventilazione meccanica avviene ai parametri impostati (T insp, PEEP e PIP).

L'utente può impostare quanto segue:

- RR (frequenza respiratoria)
- Ti (tempo inspiratorio)
- PEEP
- PIP
- O₂%

Pulsanti addizionali

- Fronte di salita
- Sensibilità del trigger Soglia di rilevamento del respiro pressorio

Allarmi

- PIP alta e bassa
- PEEP alta e bassa

Pulsanti Addizionali

- Pulsante Respiro manuale o Pausa

Caratteristiche del modulo SpO₂

- Forma d'onda Pletis se selezionata
- Soglie di allarme SpO₂ alta e bassa
- Soglie di allarme PR alta e bassa



Modulo OxyGenie®+ SpO₂

- Intervallo stabilito SpO₂
- Allarme O₂% alta



3.4 nHFOV

Ventilazione nasale ad alta frequenza Oscillatoria



In questa modalità, il ventilatore fornisce una continua oscillazione ad alta frequenza per vie nasali e non vi è interazione con il paziente.

L'utente può impostare quanto segue:

- Frequenza
- Rapporto I:E
- MAP
- Delta P
- O₂%

Pulsanti addizionali

- Rr Respirone
- Per. Insp Resp
- Press. Resp.

Soglie di allarmi

- Paw alta e bassa

Pulsanti Addizionali

- Pulsante Sigh o Pausa Respirone

Caratteristiche del modulo SpO₂

- Forma d'onda Pletis se selezionata
- Soglie di allarme SpO₂ alta e bassa
- Soglie di allarme PR alta e bassa



Modulo OxyGenie®+ SpO₂

- Intervallo stabilito SpO₂
- Allarme O₂% alta



4. Descrizione delle modalità di ventilazione (circuiti paziente a singolo lume - non invasivi)

4.1 nCPAP

Pressione positiva continua delle respiratorie per via nasale.



Il ventilatore genera una pressione positiva continua delle vie respiratorie selezionata dall'utente.

L'utente può impostare quanto segue:

- Ti (tempo inspiratorio)
- CPAP
- PIP
- O₂%

Pulsanti addizionali

- Supporto Apnea
- Fronte di salita
- Sensibilità del trigger Soglia di rilevamento del respiro pressorio – Azioni ventilatorie del paziente richieste per riconoscere il respiro.

Allarmi

- PIP alta e bassa
- CPAP alta e bassa
- FR alta
- Tempo di apnea (può essere disattivato)

Pulsanti Addizionali

- Pulsante Respiro manuale o Pausa

Caratteristiche del modulo SpO₂

- Forma d'onda Pletis se selezionata
- Soglie di allarme SpO₂ alta e bassa
- Soglie di allarme PR alta e bassa



Modulo OxyGenie®+ SpO₂

- Intervallo stabilito SpO₂
- Allarme O₂% alta



4.2 DuoPAP

Ventilazione con due livelli di pressione positive per vie nasali.



In questa modalità, il ciclo inspiratorio viene avviato dal ventilatore alla frequenza respiratoria impostata. I respiri sono time cycled.

L'utente può impostare quanto segue:

- RR (frequenza respiratoria)
- Ti (tempo inspiratorio)
- PEEP
- PIP
- O₂%

Pulsanti Addizionali

- Pulsante Respiro manuale o Pausa

Caratteristiche del modulo SpO₂

- Forma d'onda Pletis se selezionata
- Soglie di allarme SpO₂ alta e bassa
- Soglie di allarme PR alta e bassa



Modulo OxyGenie®+ SpO₂

- Intervallo stabilito SpO₂
- Allarme O₂% alta



5. Descrizione delle modalità di ventilazione (Non Invasiva - cannula O₂)

5.1 Alti Flussi

Il ventilatore genera un flusso continuo al livello impostato dall'utente.



L'utente può impostare quanto segue:

- Flusso
- O₂%

Caratteristiche del modulo SpO₂

- Forma d'onda Pletis se selezionata
- Soglie di allarme SpO₂ alta e bassa



Modulo OxyGenie®+ SpO₂

- Intervallo stabilito SpO₂
- Allarme O₂% alta



Uso previsto

“Riepilogo” a pagina 24

“Condizioni d'uso” a pagina 24



6. Uso previsto di SLE6000

6.1 Riepilogo

Il ventilatore SLE6000 è concepito per fornire un supporto respiratorio continuo o intermittente per neonati con peso superiore ai 300 gr., neonati a termine infanti, e pazienti pediatrici fino a 30 kg in base alla condizione del piccolo paziente

Il ventilatore è stato concepito per l'uso in ventilazioni invasive e non invasive. Le modalità e le funzioni disponibili del ventilatore sono configurabili in base ai requisiti del cliente come Oscillazione ad alta frequenza, monitoraggio etCO₂ e il monitoraggio SpO₂ (misura e monitoraggio del livello di saturazione dell'ossigeno del sangue utilizzando il cavo SLE SpO₂) e OxyGenie® una funzione che regola automaticamente lo O₂ fornito per incrementare il periodo di terapia nell'intervallo stabilito SpO₂).

Va inteso che il ventilatore SLE6000 sia usato da un medico o da personale sanitario autorizzato e qualificato

Il ventilatore è mobile quando è montato su carrello ma è destinato al funzionamento statico in una struttura sanitaria professionale. Per le esclusioni vedere la sezione '7. Avvertenze e avvisi - Ventilatore' a pagina 26.

6.1.1 Indicazione medica

Qualsiasi patologia, in cui lo scambio ottimale di gas è compromesso e/o dove la condizione del paziente necessita di supporto respiratorio.

6.1.2 Controindicazione medica

Non ci sono controindicazioni note alla ventilazione. È necessario attenersi agli avvisi e alle avvertenze presenti in questo manuale.

L'uso di OxyGenie® è controindicato nei pazienti il cui obiettivo SpO₂ è fuori dai seguenti intervalli stabiliti.

90-94%

91-95%

92-96%

94-98%

6.1.3 Tipo di paziente

Il ventilatore SLE6000 va utilizzato sui neonati e pazienti pediatrici con peso compreso tra i 300 gr fino ai 30 kg e in base alle condizioni polmonari.

6.1.4 Apparato del paziente sotto trattamento

Il ventilatore viene usato per gestire la ventilazione nel sistema respiratorio del paziente.

6.1.5 Terapia clinica

Si può usare il sistema SLE 6000 in modalità di ventilazione convenzionale o ad alta frequenza oscillatoria per:

- Ventilazione non salvavita
- Ventilazione salvavita (è necessaria la misura del Vte o etCO₂)
- Ventilazione invasiva o non invasiva

6.1.6 Profilo utente principale

Il ventilatore SLE 6000 va utilizzato in applicazioni cliniche esclusivamente da parte di personale medico e di tecnici formati per la manutenzione ed assistenza.

6.2 Condizioni d'uso

Il ventilatore SLE6000 è concepito per fornire un supporto respiratorio continuo o intermittente per neonati prematuri, neonati a termine infanti, e pazienti pediatrici fino a seconda della condizione del piccolo paziente.

E' possibile spostare il ventilatore in luoghi più consoni se montato su un carrello,, ma lo si può anche collocare su piani di lavoro statici predisposti dalle unità di terapia intensiva ospedaliera.

Il ventilatore va usato in un ambiente medico pulito in modo appropriato, con Aria e Ossigeno per uso medico e con sistemi respiratori del ventilatore MEDICAMENTE PULITO e relativi accessori.

Avvertenze e avvisi

“Avvertenze e avvisi - Ventilatore” a pagina 26

“Avvertenze e avvisi - Sensori esterni” a pagina 29



7. Avvertenze e avvisi - Ventilatore

7.1 Avvertenze- generale

Prima di usare il ventilatore, leggere attentamente le avvertenze che seguono. La mancata lettura di tali avvertenze può determinare lesioni o morte del paziente.

- 1 Leggere attentamente il manuale in ogni sua parte prima di usare il ventilatore. Gli operatori devono essere adeguatamente addestrati e clinicamente autorizzati nell'usare il ventilatore sui pazienti. N.B.: controllare le pressioni del ventilatore prima di cambiare modalità.
- 2 Ossigeno - Uso clinico. L'ossigeno è una sostanza terapeutica e deve essere prescritto come tale.
- 3 Ossigeno – Pericolo di incendio. L'ossigeno favorisce la combustione quindi il suo impiego richiede precauzioni speciali al fine di evitare pericoli di incendio. Tenere tutte le fonti di accensione lontane dall'ossigeno laddove viene impiegato. Non usare olii o grassi sui raccordi per l'ossigeno o dove viene impiegato ossigeno.
- 4 Controllare la condizione dei tubi di alimentazione gas al ventilatore. Non usare tubi che presentano segni di incrinature, abrasione, attorcigliamento, tagli, usura eccessiva o invecchiamento. Accertarsi che il tubo dell'aria o dell' O₂ non sia venuto a contatto con olii o grassi.
- 5 Quando il ventilatore viene usato su un paziente, deve esserci sempre una persona adeguatamente addestrata ad adottare misure tempestive in caso di allarme o altra indicazione di problema.
- 6 Non entrare in modalità "Attesa" se il ventilatore è connesso ad un paziente. Non viene fornita alcuna ventilazione.
- 7 In caso di guasto di ventilazione, la mancanza di accesso immediato a mezzi alternativi appropriati di ventilazione può risultare pericolo di morte del paziente.
- 8 Non toccare contemporaneamente il paziente e le parti metalliche del ventilatore per evitare di folgorare il paziente.
- 9 Non utilizzare il ventilatore in camera iperbarica.
- 10 Non utilizzare il ventilatore nello scanner MRI (Risonanza Magnetica).
- 11 Non utilizzare il ventilatore con elio o miscele a base di elio.
- 12 La precisione del ventilatore può essere influenzata dal gas aggiunto mediante l'uso di un nebulizzatore.
- 13 Qualsiasi computer connesso al ventilatore deve essere classificato e approvato per uso medico.
- 14 Non utilizzare la porta VGA se connesso a un paziente. Serve solo per scopi di formazione.
- 15 Il ventilatore non contiene parti in lattice. Questa sostanza non è stata utilizzata neppure nelle fasi di produzione.
- 16 Prima di effettuare le operazioni di pulizia, scollegare il ventilatore dall'alimentazione elettrica di rete.
- 17 Il ventilatore non va coperto durante l'uso con stoffe o tendaggi. Non posizionare il ventilatore in prossimità di tendaggi o tessuti, al fine di evitare che le porte di scarico o le aperture di ingresso vengano ostruite o bloccate.
- 18 Il ventilatore non dispone di prese d'aria d'emergenza.
- 19 In caso di allarme "Mancanza di alimentazione elettrica di rete" e l'utente cancella l'allarme "Mancanza di alimentazione elettrica di rete", il successivo allarme relativo all'alimentazione che scatterà sarà l'allarme di media priorità "Mancanza di alimentazione elettrica di rete". Questo significa che l'alimentazione interna ha raggiunto una capacità del 25%. Se l'utente cancella l'allarme di media priorità "Mancanza di alimentazione elettrica di rete", il successivo allarme relativo all'alimentazione che scatterà sarà l'allarme di alta priorità "Batteria scarica". Questo significa che l'alimentazione interna ha una durata di meno di 10 minuti. L'utente dovrà sottoporre il paziente a una forma di ventilazione alternativa se non è possibile ripristinare l'alimentazione.
- 20 Non conservare le batterie completamente scariche. Ricaricare le batterie prima possibile per preservarne la vita utile. Se il ventilatore viene conservato in magazzino, verificare che le batterie siano completamente cariche.
- 21 Quando il ventilatore viene usato senza sensore di flusso e per la ventilazione di un paziente vengono utilizzati tubi endotracheali di dimensioni uguali o inferiori a 3 mm soltanto il monitoraggio del flusso o di SpO₂, o dell'ossigeno e dell'anidride carbonica transcutanei – e non quello delle pressioni – allenterà il team medico in modo affidabile di una situazione di allarme in caso di estubazione del paziente o di disconnessione del tubo endotracheale dall'apposito connettore.
- 22 Il mancato rispetto dei programmi di manutenzione può determinare lesioni del paziente, dell'operatore o danni al ventilatore. È responsabilità dell'utente garantire che l'apparecchiatura sia regolarmente sottoposta a manutenzione.
- 23 Per evitare il rischio di folgorazioni, questa apparecchiatura deve essere connessa solo a fonti di alimentazione elettrica di rete con messa a terra.
- 24 Il ventilatore non deve essere avviato solo con alimentazione della batteria.

- 25 Se il ventilatore viene negativamente influenzato da apparecchiature che generano interferenze elettromagnetiche, spegnere o allontanare tali apparecchiature. Viceversa, se fosse il ventilatore fonte di interferenze con altre apparecchiature vicine, spegnerlo oppure spostarlo.
- 26 La funzionalità di questa macchina può essere negativamente influenzata dal funzionamento di strumenti come apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza (per diatermia), defibrillatori, telefoni cellulari o dispositivi per terapia ad onde corte, nelle sue vicinanze.
- 27 L'apparecchiatura non è idonea per l'uso con o in presenza di miscele anestetiche infiammabili.
- 28 Non pulire il touch screen mentre il ventilatore è in funzione.
- 29 Nessuna modifica del ventilatore è consentita. Eventuali modifiche al ventilatore o al sistema richiedono la valutazione BS EN 60601-1. (Contattare SLE se sono necessarie modifiche al ventilatore o al sistema).
- 30 Il ventilatore va utilizzato solo con gli accessori approvati da SLE.
- 31 La porta RS232 non va collegata a una rete IT.
- 32 I dispositivi di dati USB non vanno collegati alla porta dati durante l'uso del paziente.
- 33 Solo il controller USB Aerogen va collegato alla porta USB montata sul retro contrassegnata come "controller USB Aerogen".
- 34 Assicurarsi che il ventilatore non sia posizionato in modo che sia difficile effettuare la disconnessione del dispositivo.
- 35 Quando le forniture di aria e ossigeno sono note nel contenere umidità e il ventilatore viene utilizzato in modo continuo, l'utente deve verificare i sifoni montati sul retro a intervalli regolari.
- 36 L'utente deve sapere che gli allarmi del ventilatore SLE6000 possono essere configurati alle impostazioni definite dall'utente. Questo può risultare che le unità nello stesso dipartimento abbiano impostazioni di allarme diverse.

7.2 Avvertenze - EMC

- 1 Va evitato usare il ventilatore adiacente o sopra altre apparecchiature perché potrebbe causare un funzionamento improprio. Se tale uso è necessario, osservare questa apparecchiatura e le altre per verificare che funzionino normalmente.

- 2 L'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore sul ventilatore potrebbe produrre un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica di questa apparecchiatura e quindi un improprio funzionamento.
- 3 Le apparecchiature di comunicazione portatili a radiofrequenza (incluse le periferiche come cavi di antenna e antenne esterne) vanno utilizzate ad una distanza di almeno 30 cm dal SLE6000, inclusi i cavi specificati dal produttore. Diversamente, potrebbe verificarsi una riduzione delle prestazioni di queste apparecchiature.

7.3 Avvisi - EMC

Utilizzare solo i cavi indicati nel capitolo 45. Parti consumabili e accessori a pagina 280 per il collegamento agli accessori e ai trasduttori.

7.4 Avvertenze - circuito paziente e umidificatore

- 4 Vanno utilizzati solo circuiti pazienti approvati SLE. La precisione dei parametri controllati e misurati è garantita solo dall'uso dei circuiti approvati.
- 5 Non usare mai tubazioni conduttive antistatiche o elettricamente conduttive.
- 6 L'umidificatore usato nel circuito paziente deve essere usato e sottoposto a manutenzione in conformità alle istruzioni del rispettivo fabbricante.
- 7 Il sifone dell'acqua usato nel circuito paziente deve essere tenuto in posizione verticale sotto il paziente e regolarmente svuotato prima che si riempia.
- 8 Non modificare il circuito paziente diversamente da come descritto per l'uso non invasivo. Circuiti paziente modificati o circuiti con sezioni o componenti aggiuntivi possono produrre elevate resistenze circuitali e compliance per una ventilazione efficace.
- 9 Non lasciare che la parte riscaldata del circuito paziente tocchi il paziente.
- 10 Aggiungendo collegamenti o altri componenti o sottogruppi al sistema di respirazione del ventilatore è possibile modificare il gradiente di pressione nel sistema di respirazione del ventilatore e tali modifiche al sistema di respirazione del ventilatore possono influenzare in modo avverso le prestazioni del ventilatore.
- 11 La nebulizzazione o l'umidificazione può incrementare la resistenza dei filtri del sistema di respirazione e la necessità da parte dell'operatore di monitorare il filtro del sistema di respirazione frequentemente per una maggiore resistenza e blocco.

- 12 Non lasciare che la parte riscaldata del circuito paziente sia coperta, ad esempio da una coperta o copertura.
- 13 Non toccare la piastra calda dell'umidificatore se esposta, perché potrebbe ustionare la pelle quando calda.
- 14 Assicurarsi che le sonde di temperature siano pulite e sterilizzate in base alle istruzioni dei produttori.

7.5 Avvertenze - nCPAP (Singolo lume)

- 1 Quando si utilizzano cannule nasali piccole o extra piccole durante la CPAP, il ventilatore potrebbe non dare l'allarme se si verifica una disconnessione del paziente. Si raccomanda che i respiri di backup siano sempre accesi, in quanto in questo modo si ottengono respiri di riserva e si avverte l'utente di una condizione di PIP bassa se le cannule nasali si staccano. Solo il monitoraggio della SpO₂ o dell'ossigeno e dell'anidride carbonica transcutanei avviserà in modo affidabile l'equipe medica della disconnessione del paziente.

7.6 Avvertenze- cliniche

- 1 La mancata adozione di misure correttive quando gli allarmi vengono attivati, può causare lesioni o morte del paziente.
- 2 L'uso della funzione chiamata infermiera non esula dalla necessità di monitorare sia il paziente che il ventilatore a intervalli regolari.

7.6.1 Monitoraggio

I requisiti minimi di monitoraggio del paziente a letto sono i seguenti:

- ECG/frequenza cardiaca.
- Pressione sanguigna.
- Frequenza respiratoria.
- Saturazione di ossigeno.

Se il monitor paziente lato letto non può fornire il monitoraggio della pressione sanguigna e della saturazione di ossigeno, vanno utilizzati monitoraggi della pressione sanguigna e della saturazione di ossigeno indipendenti.

Ulteriore Monitoraggio per HFOV e per ventilazione non invasiva

- Monitoraggio anidride carbonica transcutanea.

Altre modalità invasive convenzionali di monitoraggio

- Monitoraggio anidride carbonica transcutanea o monitoraggio etCO₂

Per le unità che sono senza funzioni monitoraggio dell'anidride carbonica o etCO₂ devono essere disponibili il prelievo di sangue arterioso/venoso o capillare.

7.6.2 Clinico - invasivo

- 1 Quando si passa dalla ventilazione convenzionale a quella ad alta frequenza, o viceversa, possono

essere necessarie modifiche delle impostazioni del ventilatore e delle concentrazioni dell'ossigeno inalato.

- 2 Tutte le ventilazioni devono essere avviate esclusivamente da personale medico esperto e perfettamente addestrato.
- 3 Umidificazione inappropriata può causare mobilitazione delle secrezioni e blocco delle vie respiratorie.
- 4 Emorragia intraventricolare, ischemia cerebrale dovute all'alto livello di anidride carbonica.
- 5 Volutrauma che comporta malattie polmonari croniche (displasia broncopolmonare nel neonato)
- 6 L'uso di un tubo endotracheale senza cuffia può causare perdite che impediscono l'ossigenazione e la ventilazione.
- 7 E' massima importanza il mantenimento delle vie respiratorie adeguate.

7.6.3 Clinico - non invasivo

- 1 Danni alle narici.
- 2 Ipo o iperventilazione (con conseguenti anomalie a livello di emogas);
- 3 Umidificazione inappropriata può causare mobilitazione delle secrezioni e blocco delle vie respiratorie.
- 4 Danni a trachea e bronchi;
- 5 Iper o ipo-inflazione del polmone;
- 6 Atelettasia;
- 7 Sindrome da perdita d'aria (pneumotorace, pneumomediastino, pneumopericardio, enfisema polmonare interstiziale).

7.7 Avvisi - generali

- 1 Durante l'uso separato dal sensore di flusso non ci sono articoli di ventilatori sottoposti a manutenzione.
- 2 Il ventilatore deve essere smaltito in base alle linee guida WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
- 3 Non usare soluzioni detergenti a base di solventi per pulire il touchscreen o i coperchi.
- 4 Non usare strumenti appuntiti, come per esempio una penna, per attivare i controlli in quanto la pressione eccessiva applicata dalla punta potrebbe danneggiare la membrana del touch screen.
- 5 Il ventilatore contiene dispositivi termo-dipendenti che funzionano normalmente in ambienti ospedalieri controllati. Tuttavia, se il ventilatore è stato conservato a una temperatura diversa da quella a cui viene usato, è opportuno lasciare acclimatare l'unità prima di accenderla. (Campo temperatura operativa da +10°C a +40°C)
- 6 Smaltire la cella di misura ossigeno in conformità alle normative vigenti in materia di sostanze pericolose. Non incenerire. SLE offre un servizio di smaltimento.

- 7 Prestare attenzione quando si collegano altre apparecchiature perché ciò può influenzare la stabilità meccanica.
- 8 Quando si utilizza il ventilatore SLE6000 insieme ai compressori ad aria medici SLE500E o SLE500S l'utente deve sapere che le prestazioni HFOV sono limitate. Il flusso massimo dei compressori ad aria medici SLE500E o SLE500S è 60 l/min il SLE6000 richiede 85 l/min. Questa disparità sarà evidente solo in modalità HFOV in cui le pressioni Delta P superiori a 150 mbar causeranno l'instabilità MAP (mean airway pressure).

7.7.1 Filtri batterici

- 1 È consigliato l'uso di filtri batterici tra la porta del gas e la linea di alimentazione dell'umidificatore e il blocco di esalazione e la linea di alimentazione espiratoria.

7.7.2 Sensore di flusso

- 1 Il sensore di flusso riutilizzabile e monouso sono soggetti a manutenzione e potrebbero richiedere la pulizia durante l'uso.

7.8 Avvisi - clinici

- 1 Evitare di impostare i limiti di allarme a valori estremi perché ciò può limitare la capacità del ventilatore di rilevare condizioni pericolose.

8. Avvertenze e avvisi - Sensori esterni



8.1 Avvertenze per Masimo SET®

- 1 Pericolo di esplosione. Non utilizzare il pulsossimetro in presenza di anestetici infiammabili o di altre sostanze infiammabili in combinazione con aria, ambienti arricchiti di ossigeno o protossido di azoto.
- 2 Il pulsossimetro NON va utilizzato come monitor di apnea.
- 3 Avviare o far funzionare il pulsossimetro solo dopo aver controllato che la configurazione sia corretta.
- 4 Non utilizzare il pulsossimetro se appare o si sospetta che sia danneggiato.
- 5 Per garantire la sicurezza, evitare di porre l'uno sopra l'altro più dispositivi o di posizionare qualsiasi cosa sul dispositivo stesso durante il funzionamento.
- 6 La misura delle pulsazioni è basata sul rilevamento ottico di pulsazioni di flusso periferiche e potrebbe quindi non rilevare determinate aritmie. Il pulsossimetro non va utilizzato come sostitutivo per l'analisi delle aritmie basate sull'ECG.
- 7 Il pulsossimetro rappresenta il primo dispositivo di allarme. È indicato come trend per la deossigenazione del paziente, i campioni di sangue devono essere analizzati da un co-ossimetro da laboratorio per comprendere completamente la condizione del paziente.
- 8 Se si verifica una condizione di allarme (diversa dalle eccezioni elencate qui) mentre il periodo di silenziamento allarme è impostato su off, le uniche indicazioni di allarme saranno simboli e schermate relative alla condizione di allarme.
- 9 Per la protezione dalle scosse elettriche, prima di bagnare il paziente, rimuovere sempre il sensore e scollegare completamente il pulsossimetro.
- 10 Misurare la corrente di perdita dell'ossimetro ogni qual volta viene collegato un dispositivo esterno alla porta seriale. La corrente di perdita non deve superare i 100 microampere.
- 11 Non posizionare il pulsossimetro o gli accessori in qualsiasi posizione che potrebbe causare la caduta sul paziente.
- 12 Non utilizzare cavi di prolunga o adattatori di qualsiasi tipo. Il cavo e la presa di corrente devono essere intatti e integri.
- 13 In caso di dubbi sull'integrità della sistemazione del conduttore di terra protettivo, azionare l'ossimetro con la batteria interna fino a quando il conduttore protettivo della CA non è completamente funzionale.
- 14 Per garantire l'isolamento elettrico del paziente, collegare l'apparecchiatura solo con circuiti isolati elettronicamente.

- 15 Come per tutte le apparecchiature mediche, inserire attentamente il cavo del paziente per ridurre la possibilità di strangolamento o aggrovigliamento del paziente.
- 16 Sostanze interferenti: la carbossiemoglobina potrebbe erroneamente far incrementare le letture. Il livello di incremento è quasi uguale al quantitativo di carbossiemoglobina presente. I coloranti o qualsiasi altra sostanza che contiene coloranti, che modifica la pigmentazione arteriosa potrebbe causare letture errate.
- 17 Non utilizzare il pulsossimetro o altri sensori dell'ossimetro Masimo nello scanner MRI (Risonanza Magnetica). La corrente indotta potrebbe causare potenziali ustioni. Il pulsossimetro potrebbe influenzare l'immagine MRI e l'unità MRI influenzare la precisione delle misure dell'ossimetro.
- 18 Interconnessione sistema RS-232. Consultare IEC-601-1-1 per la guida all'interconnessione di sistema. I requisiti specifici per l'interconnessione di sistema dipendono dal dispositivo connesso al pulsossimetro e le relative posizioni di ciascun dispositivo rispetto al paziente e la relativa posizione del dispositivo connesso alla camera per uso medico che contiene l'ossimetro. In tutti i casi l'ossimetro deve essere collegato all'alimentazione CA con messa a terra. Il pulsossimetro è noto come dispositivo IEC 601/F nel riepilogo della tabella delle situazioni contenute in IEC 601-1-1.

8.2 Avvisi per Masimo SET®

8.2.1 Informazioni generali

- 1 Non posizionare l'ossimetro dove i comandi possono essere modificati dal paziente.
- 2 Quando i pazienti sono sottoposti ad una terapia fotodinamica potrebbero essere sensibili alle fonti luminose, L'ossimetro a impulsi può essere utilizzato esclusivamente sotto supervisione medica per periodi di tempo brevi per ridurre le interferenze con la terapia fotodinamica.
- 3 Non posizionare l'ossimetro sull'apparecchiatura elettrica che potrebbe influenzare il dispositivo, impedendogli di funzionare correttamente.
- 4 Cambiare il sito di applicazione o sostituire il sensore e/o il cavo del paziente quando viene mostrato il messaggio "Sostituire il sensore" e/o "Sostituire il cavo del paziente" o quando appare un messaggio persistente sul monitor host di bassa qualità del segnale (come "SIQ basso"). Questi messaggi potrebbero indicare il tempo di lavoro per il monitoraggio paziente sia esaurito sul cavo paziente o sul sensore.
- 5 Se viene utilizzato l'ossimetro durante l'esposizione del corpo del paziente a radiazioni, tenere il sensore fuori dal campo delle radiazioni stesse. Se il sensore viene esposto alle radiazioni, la lettura potrebbe non essere precisa o il dispositivo leggere zero per la durata del periodo di irraggiamento.
- 6 Pericolo di folgorazioni: eseguire dei test periodici per verificare che le correnti di perdita dei circuiti applicati al paziente ed al sistema siano nei limiti accettabili come specificato dalle norme di sicurezza applicate. La somma delle correnti di perdita deve essere verificata ed essere conforme a IEC 60601-1 e UL60601-1. La corrente di perdita di sistema deve essere controllata quando si collega il dispositivo esterno al sistema. Quando si verifica un evento come la caduta di un componente da circa 1 metro o da un'altezza superiore o la fuoriuscita di sangue o di altri liquidi, riverificare prima dell'uso. Potrebbero verificarsi lesioni al personale.
- 7 Smaltimento del prodotto: rispettare le leggi locali per lo smaltimento del dispositivo e/o i suoi accessori.
- 8 Per ridurre al minimo le interferenze radio, altre apparecchiature elettriche che emettono trasmissioni di frequenza radio non devono essere in prossimità dell'ossimetro.
- 9 Non avvolgere il cavo del paziente in un cappio stretto o avvolgerlo intorno al dispositivo, dal momento che questo potrebbe danneggiare il cavo stesso.

- 10 Maggiori informazioni specifiche sui sensori Masimo compatibili con l'ossimetro, incluse le informazioni sulle prestazioni del parametro/ misurazione durante lo spostamento e la bassa perfusione, sono disponibili nelle indicazioni d'uso del sensore (DFU).
- 11 I cavi e i sensori sono forniti con la tecnologia X-Cal™ per ridurre al minimo il rischio di letture imprecise e la perdita imprevista del monitoraggio paziente. Fare riferimento alle istruzioni del caso o del sensore per la durata specificata del tempo di monitoraggio paziente.
- 12 Non regolare, riparare, aprire, smontare o modificare l'ossimetro o gli accessori se non autorizzati. Potrebbero verificarsi danni al personale o al dispositivo.

8.2.2 Pulizia

- 1 Utilizzare esclusivamente le soluzioni detergenti come indicato nel manuale d'uso.
- 2 Pericolo di folgorazioni e infiammabilità: spegnere sempre il dispositivo e disconnettere dalla fonte di alimentazione, prima di avviare la procedura di pulizia.
- 3 Non immergere l'ossimetro in una soluzione detergente o provare a sterilizzarlo con autoclave, irraggiamento, vapore, gas, ossido di etilene o altri metodi. Questo danneggerà seriamente l'ossimetro.
- 4 Non immergere il monitor nei liquidi.
- 5 Utilizzare la soluzione detergente con moderazione. La soluzione in eccesso può fluire nel monitor e causare danni ai componenti interni.
- 6 Non provare a pulire il dispositivo durante il monitoraggio del paziente.
- 7 Non toccare, premere o strofinare i pannelli del display con composti detergenti abrasivi, strumenti, spazzole, materiali con superfici rugose o portarli a contatto con qualcosa che potrebbe graffiare il pannello.
- 8 Non utilizzare soluzioni a base di petrolio o acetone o altri solventi forti per pulire l'ossimetro. Queste sostanze attaccano i materiali del dispositivo e possono provocare problemi al dispositivo stesso.

8.2.3 Avvisi per allarmi

- 1 Controllare i limiti di allarme ogni volta che l'ossimetro viene utilizzato per garantire che siano appropriati per il paziente monitorato.

8.2.4 Avvisi per le misure

Le variazioni nelle misure possono essere profonde e possono essere influenzate dalla tecnica di campionatura oltre che dalle condizioni psicologiche del paziente. Eventuali risultati che mostrano inconsistenza con lo stato clinico del paziente devono essere ripetuti e/o integrati con i dati di test aggiuntivi. I campioni di sangue devono essere analizzati dagli strumenti di laboratorio prima di prendere decisioni per analizzare in pieno la condizione del paziente.

L'ossimetro non deve essere utilizzato come sistema unico per prendere decisioni mediche. Va utilizzato insieme ai segnali e i sintomi clinici.

Se la precisione della misurazione non sembra ragionevole, controllare per prima cosa i segni vitali del paziente con mezzi alternativi e quindi controllare che l'ossimetro funzioni correttamente.

Misure imprecise possono essere causate da:

- 1 Applicazione o uso non corretto del sensore
- 2 Livelli significativi di emoglobine disfunzionali (ad es., carbossiemoglobina o metaemoglobina)
- 3 Coloranti endovascolari come verde indocianino o blu di metilene.
- 4 Sostanze interferenti: coloranti, smalto per unghie o altre sostanze contenenti coloranti che modificano la pigmentazione sanguigna possono causare letture errate.
- 5 La misura delle pulsazioni è basata sul rilevamento ottico di pulsazioni di flusso periferiche e potrebbe quindi non rilevare determinate aritmie. Il pulsossimetro non va utilizzato come sostitutivo per l'analisi delle aritmie basate sull'ECG.
- 6 Esposizione all'illuminazione eccessiva, come le lampade chirurgiche (specialmente quelle con fonte luminosa allo xenon),
- 7 Lampade di bilirubina, lampade fluorescenti, lampade a infrarossi o luce diretta del sole (l'esposizione all'illuminazione eccessiva può essere corretta coprendo il sensore con un materiale scuro o opaco)
- 8 Spostamento eccessivo del paziente.
- 9 SpO₂ è calibrato empiricamente alla saturazione funzionale dell'ossigeno arterioso in volontari adulti sani con livelli normali di carbossiemoglobina (COHb) e metaemoglobina (MetHb). Un pulsossimetro non può misurare livelli elevati di COHb o MetHb. Gli aumenti di COHb o MetHb influiranno sulla precisione della misurazione SpO₂

Per un aumento del COHb: i livelli di COHb superiori alla norma tendono ad aumentare il livello di SpO₂. Il livello di incremento è approssimativamente pari alla quantità di COHb presente.

Elevati livelli di COHb possono presentarsi con un SpO₂ apparentemente normale. Quando si sospettano elevati livelli di COHb, devono essere

effettuate le analisi di laboratorio di (CO-Ossimetria) su un campione di sangue.

- 10 Per un MetHb maggiore: SpO₂ può essere ridotto dai livelli di MetHb fino a quasi il 10% - 15%. Con livelli superiori di MetHb, l'SpO₂ si tende a leggere nel basso alla metà degli 80. Quando si sospettano livelli elevati di MetHb, deve essere eseguita l'analisi da laboratorio (CO-Ossimetro) di un campione di sangue.
- 11 Si potrebbe causare la congestione venosa con l'attuale lettura della saturazione di ossigeno arterioso. Pertanto, assicurarsi che il sito monitorato abbia un corretto flusso venoso, Il sensore non deve essere sotto il livello del cuore (ad es. sulla mano di un paziente in un letto con un braccio che penzola sul pavimento).
- 12 Le pulsazioni venose possono causare basse letture errate (ad es. il rigurgito del valore tricuspide).
- 13 I pazienti soffrono di pulsazioni anomale.
- 14 Le pulsazioni dal supporto del palloncino intraortico possono essere cumulate con la frequenza pulsazioni sul display della frequenza pulsazioni dell'ossimetro. Verificare la frequenza pulsazioni del paziente rispetto alla frequenza cardiaca ECG.
- 15 Utilizzare solo gli accessori Masimo approvati.
- 16 Artefatti da movimento possono portare a misurazioni imprecise.
- 17 Livelli elevati di bilirubina totale possono portare a misurazioni SpO₂ imprecise.
- 18 Con una bassissima perfusione sul sito monitorato, le letture possono risultare inferiori alla saturazione di ossigeno arterioso centrale.
- 19 Se viene frequentemente mostrato il messaggio Bassa perfusione, trovare un migliore sito di monitoraggio. Nel frattempo, valutare il paziente e, se indicato, verificare lo stato di ossigenazione con altri mezzi.
- 20 Non esporre il CO-ossimetro a umidità eccessiva come l'esposizione diretta alla pioggia.
- 21 L'umidità eccessiva potrebbe non far funzionare il CO-Ossimetro in modo preciso.
- 22 Non immergere il sensore o il cavo paziente in acqua o, solventi o soluzioni detergenti (I sensori e i connettori non sono resistenti all'acqua).
- 23 Posizionamento di un sensore su un'estremità con un bracciale della pressione del sangue, catetere arterioso o linea intravascolare.
- 24 Se i valori SpO₂ indicano ipossiemia, deve essere effettuata un'analisi da laboratorio per confermare la condizione del paziente.
- 25 Non è possibile utilizzare un tester funzionale per valutare la precisione del pulsossimetro.
- 26 Luci ad estrema intensità (come le luci stroboscopiche pulsanti) dirette sul sensore,

potrebbero ostacolare le letture di segni vitali da parte del pulsossimetro.

- 27 Quando si utilizza l'impostazione Massima sensibilità, le prestazioni del rilevamento "Sensore Off" potrebbero essere compromesse. Se il dispositivo è in questa impostazione e il sensore si stacca dal paziente, il potenziale per false letture potrebbe verificarsi per "rumore" ambientale come luce, vibrazione e spostamento d'aria eccessivo .
- 28 La perdita del segnale di impulso può verificarsi in una qualsiasi delle seguenti situazioni:
 - Il sensore è troppo stretto.
 - È presente un'eccessiva illuminazione da fonti di luce come una lampada chirurgica, una lampada a bilirubina o la luce del sole.
 - Un bracciale per la pressione sanguigna è gonfiato sulla stessa estremità con sensore SpO₂ collegato.
 - Il paziente presenta ipotensione, vasocostrizione grave, anemia grave o ipotermia.
 - C'è un'occlusione arteriosa prossimale al sensore.
 - Il paziente è in arresto cardiaco o in shock.
- 29 Il pulsossimetro può essere utilizzato durante l'elettrocauterizzazione, ma questo potrebbe influenzare la precisione o la disponibilità dei parametri e delle misure.
- 30 I sensori applicati troppo stretti o che diventano stretti a causa di un edema causeranno letture imprecise e necrosi della pressione.

8.2.5 Avvisi per i sensori Masimo

- 1 Prima dell'uso, leggere attentamente le indicazioni d'uso del sensore.
- 2 Utilizzare solo sensori di ossimetro Masimo per le misurazioni SpO₂. Altri (sensori) trasduttori di ossigeno potrebbero causare prestazioni improprie della scheda MS.

- 3 I danni ai tessuti possono essere causati da una non corretta applicazione o uso improprio (ad esempio avvolgendo il sensore troppo stretto). Ispezionare il sito del sensore come indicato nelle >Istruzioni d'uso del sensore per garantire l'integrità della pelle e il corretto posizionamento ed adesione del sensore.
- 4 Non utilizzare sensori danneggiati. Non utilizzare sensori con componenti ottici esposti.
- 5 Non immergere il sensore in acqua, solventi o soluzioni detergenti (i sensori ed i connettori non sono resistenti all'acqua). Non sterilizzare con irradiazione, vapore o ossido di etilene. Consultare le indicazioni d'uso per i sensori Masimo riutilizzabili.
- 6 Non utilizzare cavi paziente danneggiati. Non immergere i cavi paziente in acqua, solventi o soluzioni detergenti (i connettori del cavo paziente non sono resistenti all'acqua). Non sterilizzare con irradiazione, vapore o ossido di etilene. Consultare le indicazioni d'uso per la pulizia per i cavi paziente Masimo riutilizzabili.



8.3 Avvertenze per Oridion Micropod™

- 1 In caso di dubbi sulla precisione della misurazione, controllare per prima cosa i segni vitali del paziente in modo alternativo e assicurarsi che il modulo funzioni correttamente.
- 2 Il modulo non va utilizzato come monitor di apnea.
- 3 Per garantire la sicurezza del paziente, non posizionare il modulo in posizioni che potrebbero causare la caduta sul paziente.
- 4 Inserire attentamente la linea del filtro™ per ridurre la possibilità di strangolamento o aggrovigliamento del paziente.
- 5 Controllare regolarmente il tubo di CO₂ e O₂ durante l'uso per assicurarsi che non siano presenti pieghe. I tubi piegati possono causare campionature di CO₂ imprecise o influenzare la fornitura di O₂ al paziente.
- 6 Non sollevare il modulo dalla linea del filtro™, dal momento che la linea del filtro™ potrebbe scollegarsi dal modulo causando la caduta sul paziente.
- 7 Non tirare il modulo in modo che si stacchi dal monitor del paziente. Dopo la nuova regolazione della posizione del modulo per qualche motivo, assicurarsi che non si stacchi dal monitor.
- 8 Per garantire prestazioni precise e impedire problemi al dispositivo, non esporre il modulo a umidità estrema come la pioggia.
- 9 L'uso di accessori e cavi diversi da quelli specificati potrebbe comportare un maggior numero di emissioni e/o ridotta immunità dell'apparecchiatura e/o del sistema.
- 10 Le letture CO₂ e la frequenza respiratoria possono essere influenzate da alcune condizioni ambientali e determinate condizioni del paziente.
- 11 Il modulo è un dispositivo su prescrizione e deve essere azionato esclusivamente da personale sanitario qualificato.
- 12 Se la calibrazione non viene effettuata come indicato, il modulo potrebbe essere fuori taratura. Un modulo non tarato bene potrebbe fornire risultati imprecisi.
- 13 Non utilizzare la linea del filtro™ H Set Infante/ Neonatale nello scanner MRI (Risonanza Magnetica). L'uso della linea del filtro™ H Set Infantile/Neonatale nello scanner MRI potrebbe creare un artefatto sull'immagine MRI.
- 14 Non silenziare l'allarme sonoro sul monitor se la sicurezza del paziente può essere compromessa.

- 15 Rispondere sempre in maniera tempestiva all'allarme di sistema dal momento che il paziente potrebbe non essere monitorato in determinate condizioni di allarme.
- 16 Prima di ogni uso, verificare che i limiti di allarme siano appropriati per il paziente monitorato.
- 17 Quando si utilizza MicroPod™ con gli anestetici, il protossido di azoto o elevate concentrazioni di ossigeno, collegare l'uscita del gas a un sistema scavenger.
- 18 Il MicroPod™ non è adatto per l'uso in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria, ossigeno o protossido di azoto.
- 19 La linea del filtro™ potrebbe accendersi in presenza di O₂ quando direttamente esposta a laser, dispositivi ESU o calore eccessivo. Quando si eseguono interventi su testa e collo con l'uso di laser, dispositivi elettrochirurgici o calore eccessivo, prestare attenzione a impedire l'infiammabilità della linea del filtro™ o di teli chirurgici intorno.
- 20 Per proteggere dal pericolo di folgorazioni, la copertura del modulo deve essere rimossa da personale di assistenza qualificato. Non ci sono parti riparabili da parte dell'utente all'interno.
- 21 Per garantire l'isolamento elettrico del paziente, collegare all'altra apparecchiatura solo circuiti che sono elettricamente isolati.
- 22 L'uso di apparecchiature elettrochirurgiche ad alta frequenza nelle vicinanze del modulo può produrre interferenze nel modulo e causare misurazioni non corrette.
- 23 Non utilizzare il modulo con la tomografia a risonanza magnetica nucleare (MRT, NMR, NMT) dal momento che il funzionamento del modulo potrebbe essere disturbato.
- 24 Non modificare questa apparecchiatura senza l'autorizzazione del produttore.
- 25 Se questa apparecchiatura viene modificata, l'ispezione e il test appropriati devono essere condotti per garantire un uso sicuro e continuo dell'apparecchiatura.
- 26 Quando si utilizza una linea di campionatura per i pazienti intubati con un sistema di aspirazione chiuso, non posizionare l'adattatore delle vie respiratorie tra il catetere di aspirazione e il tubo endotracheale. Questo serve a garantire che l'adattatore delle vie respiratorie non interferisca con il funzionamento del catetere di aspirazione.
- 27 Collegamenti lenti o danneggiati potrebbero compromettere la ventilazione o causare misurazioni imprecise dei gas respiratori. Collegare in modo sicuro tutti i componenti e verificare eventuali perdite in base alle procedure cliniche standard.

- 28 Non tagliare o rimuovere parti della linea di campionatura. Il taglio della linea di campionatura potrebbe portare a letture errate.
- 29 Non utilizzare l'aria compressa per pulire la linea del filtro™.
- 30 Se entra troppa umidità nella linea di campionatura (ad es., dalle secrezioni del paziente), comparirà il messaggio Pulizia della linea del filtro™ nell'area messaggi. Se la linea di campionatura non può essere pulita, comparirà il messaggio Ostruzione della linea del filtro™ nell'area messaggi. Sostituire la linea di campionatura una volta che compare il messaggio Ostruzione della linea del filtro™.

8.4 Avvisi per Oridion Micropod™

- 1 Se il MicroPod™ mostra danni strutturali in modo che i componenti interni siano visibili, non deve essere utilizzato.
- 2 Non usare il cavo di prolunga con la versione USB o la versione RS-232 di MicroPod™.
- 3 Attenzione: prestare attenzione quando si rimuove il MicroPod™ dal supporto in modo che il dito non rimanga bloccato nella clip durante la rimozione.
- 4 Nello scanner MRI, il modulo deve essere posizionato all'esterno della suite MRI. Quando il modulo viene utilizzato fuori dalla suite MRI, il monitoraggio etCO₂ può essere implementato utilizzando la linea del filtro™ XL.
- 5 Negli ambienti ad elevata altitudine, i valori etCO₂ possono essere inferiori ai valori osservati al livello del mare, come descritto dalla legge di Dalton delle pressioni parziali. Quando si utilizza il modulo in ambienti ad elevata altitudine, è consigliabile tenere in considerazione questo aspetto e regolare le impostazioni di allarme etCO₂ di conseguenza.
- 6 L'installazione elettrica della sala o dell'edificio in cui il modulo deve essere utilizzato deve rispettare le normative specificate dal paese nel quale l'apparecchiatura deve essere utilizzata.
- 7 Un forte campo magnetico ubicato a 1 cm o meno da MicroPod™ potrebbe temporaneamente influenzare le prestazioni di MicroPod™.
- 8 Le linee di campionatura Microstream™ etCO₂ sono progettate per l'uso del singolo paziente e non devono essere riutilizzate. Non provare a pulire, disinfettare, sterilizzare o scaricare eventuali parti della linea di campionatura dal momento che questo potrebbe comportare danni per questo modulo.
- 9 Smaltire le linee di campionatura e gli imballi in base alle procedure operative standard o alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti medici contaminati.
- 10 Prima dell'uso, leggere attentamente le indicazioni d'uso delle linee di campionatura Microstream™ etCO₂.
- 11 Utilizzare solo linee di campionatura Microstream™ etCO₂ per garantire che il monitor funzioni correttamente.

- 12 Assicurarsi che il tubo non sia teso durante l'uso.
- 13 L'uso di una linea di campionatura CO₂ con l'H nel nome (che indica che è per l'uso negli ambienti umidificati) nello scanner MRI potrebbe causare interferenze. Queste linee di campionatura includono CapnoLine H/Long, CapnoLine H O₂, Smart CapnoLine H/Long, Smart CapnoLine H O₂, e Smart CapnoLine H Plus O₂/Long. È consigliabile l'uso di linee di campionatura non H.
- 14 Le linee di campionatura CO₂ utilizzate con il monitor sono contrassegnate con il limite superiore dell'ossigeno che può essere fornito con la linea di campionatura. A livelli di fornitura di ossigeno superiori a quelli contrassegnati sull'imballo della linea di campionatura, potrebbe verificarsi la diluizione delle letture CO₂, che portano a valori CO₂ inferiori.
- 15 Durante il monitoraggio con capnografia durante la sedazione, tenere presente che la sedazione potrebbe causare ipoventilazione e la distorsione o la sparizione delle forme d'onda CO₂. L'attenuazione o la sparizione delle forme d'onda è un indicatore che le vie respiratorie del paziente devono essere sempre controllate.
- 16 Durante il monitoraggio dei pazienti durante l'endoscopia superiore, il blocco parziale delle vie respiratorie dovuto al posizionamento dell'endoscopio potrebbe causare periodi di scarse letture e forme d'onda arrotondate. Questo sarà più evidente con livelli di fornitura di alta concentrazione di ossigeno.
- 17 Se l'insufflazione di CO₂ viene effettuata durante il monitoraggio CO₂, i valori EtCO₂ aumenteranno di conseguenza in maniera significativa e potrebbero causare allarmi del dispositivo e forme d'onda insolitamente alte fino a quando il CO₂ non viene scaricato dal paziente.

9. Avvertenze e avvisi - OxyGenie®

9.1 Avvertenze per OxyGenie®

- 1 Non utilizzare OxyGenie® se la differenza tra SpO₂ e SaO₂ supera il 5%.

9.2 Avvisi per OxyGenie®

- 1 Una richiesta crescente di ossigeno durante l'uso di OxyGenie® potrebbe essere indicativa di una condizione sottostante che deve essere risolta, anche se SpO₂ è nell'intervallo stabilito.
- 2 Prima dell'avvio (o del riavvio) OxyGenie, verificare (e regolare se necessario) che l'impostazione O₂ sia appropriata per la condizione clinica corrente dei pazienti. Questa impostazione O₂ iniziale ottimizza la risposta iniziale e il tempo di risposta iniziale dell'algoritmo.
- 3 Deve essere effettuato il monitoraggio paziente indipendente dal ventilatore aggiuntivo (analizzatore gas del sangue per monitoraggio vitale lato letto).

9.3 Avvertenze cliniche

- 1 L'uso di OxyGenie® è controindicato nei pazienti il cui obiettivo SpO₂ è fuori dai seguenti intervalli stabiliti. 90-94%, 91-95%, 92-96%, 94-98%.


Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Layout ventilatore




10. Layout ventilatore

In questa sezione vengono descritte dettagliatamente le funzioni fisiche del ventilatore neonatale SLE6000.

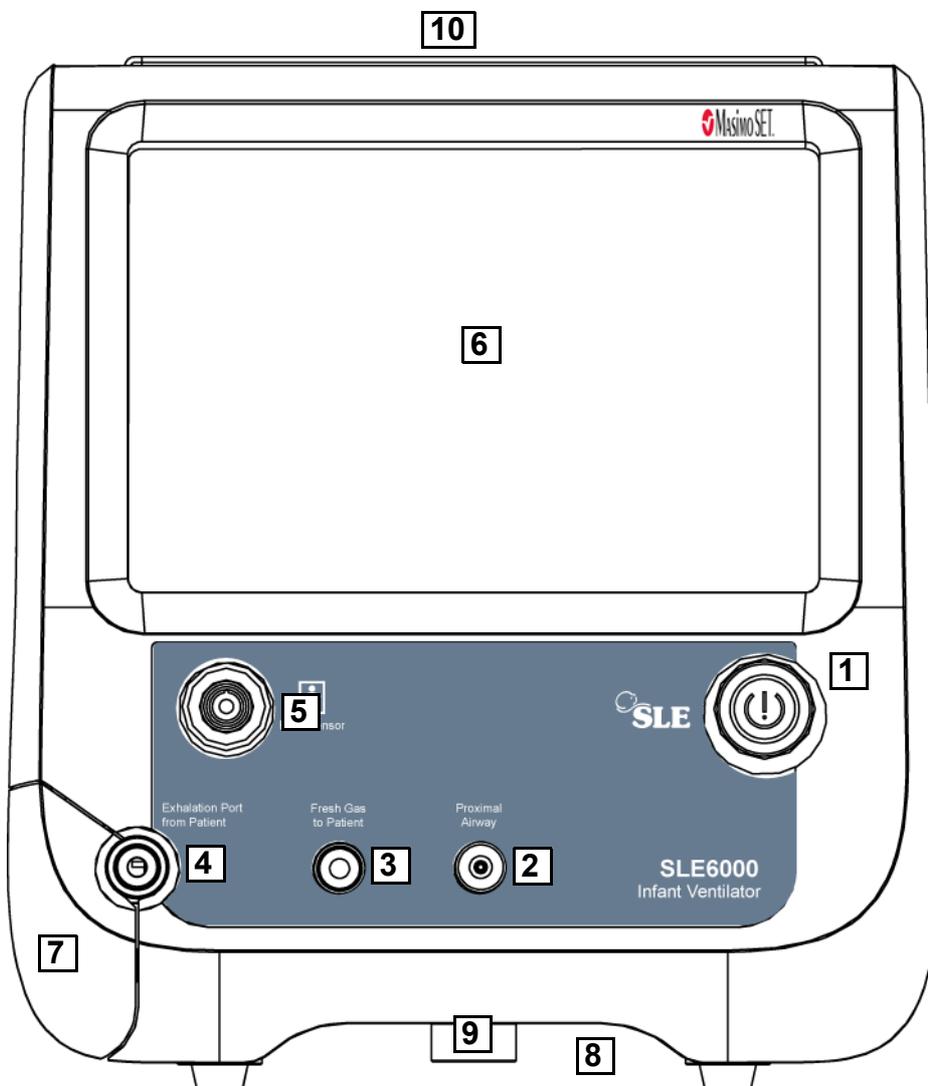

10.1 Parte anteriore



- 1 Pulsante di alimentazione elettrica di rete (controllo On/Off del ventilatore)
- 2 Porta prossimale delle vie respiratorie (Porta monitor pressione)
- 3 Gas fresco alla porta paziente
- 4 Porta di scarico dal paziente
- 5 Sensore di flusso (connettore elettrico)
- 6 Touchscreen
- 7 Coperchio blocco di esalazione
- 8 Punto di sollevamento anteriore
- 9 Punto di fissaggio carrello
- 10 Barra di illuminazione

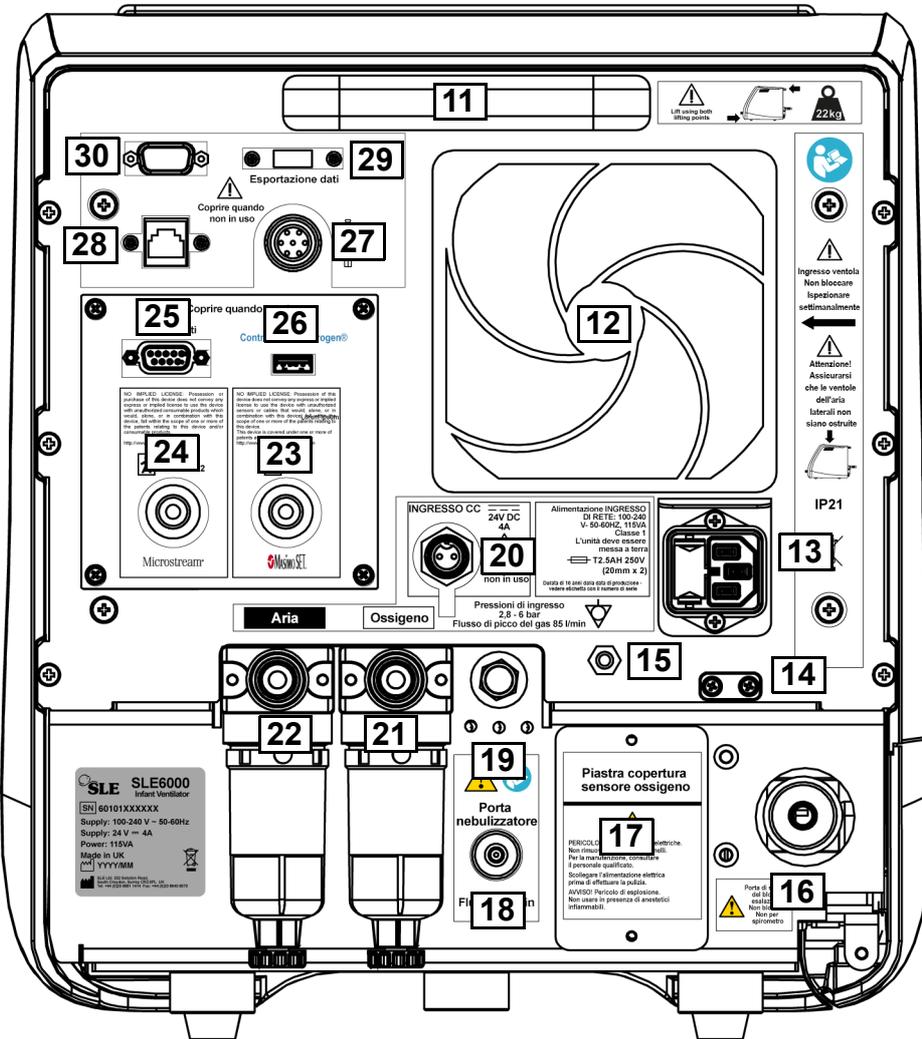

10.2 Parte posteriore

- 11 Maniglia posteriore per il trasporto
- 12 Filtro e ventola di raffreddamento principale
- 13 Presa ingresso alimentazione elettrica di rete IEC
- 14 Morsetto di blocco del cavo di ingresso alla rete elettrica
- 15 Nodo equipotenziale
- 16 Porta di scarico
- 17 Piastra coperchio cella di misura ossigeno
- 18 Porta nebulizzatore
- 19 Valvola di scarico della pressione e porte di scarico.
- 20 Connettore elettrico ingresso CC da 24 V
- 21 Porta ingresso ossigeno e sifone dell'acqua (opzionale)
- 22 Porta ingresso aria e sifone dell'acqua
- 23 Connettore elettrico SpO₂

- 24 Connettore elettrico EtCO₂
- 25 Interfaccia RS232 (D-sub a 9 vie)
- 26 Connettore di alimentazione nebulizzatore Aerogen (USB)
- 27 Connettore elettrico chiamata infermiera
- 28 Interfaccia Ethernet (RJ-45)
- 29 Porta dati (USB)
- 30 Connettore di uscita VGA o DisplayPort

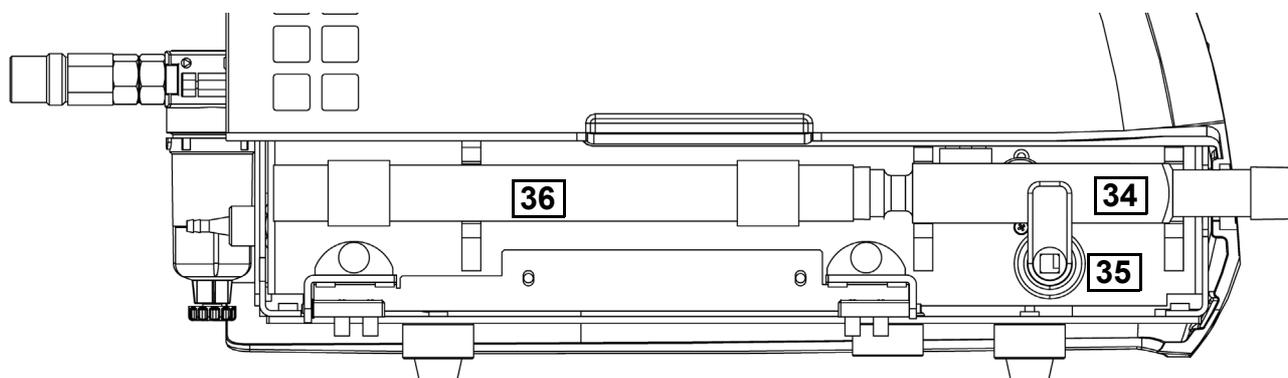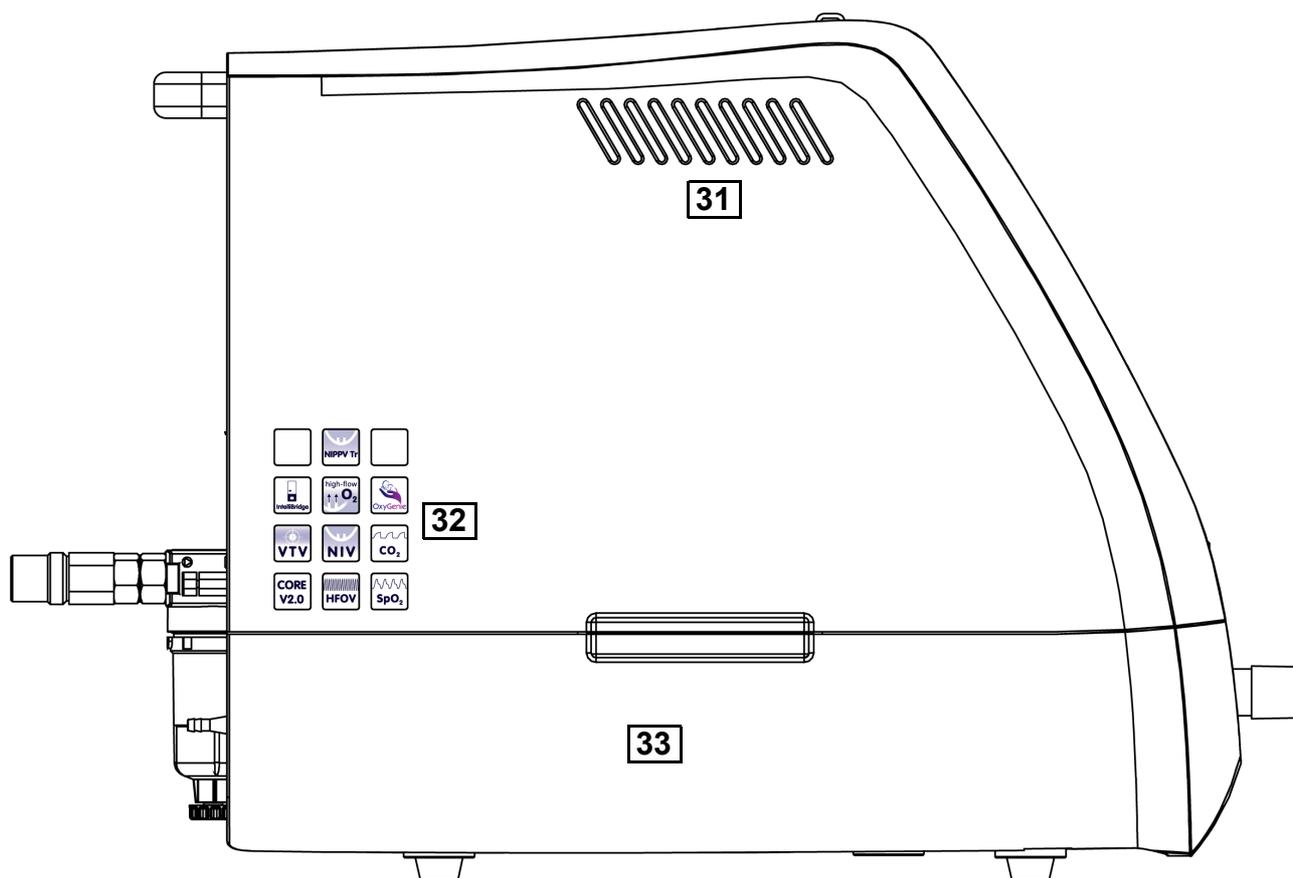

- 31 Sfogo dell'aria (scarico)
- 32 Etichette adesive ID software opzionali
- 33 Sportello blocco di esalazione
- 34 Blocco di esalazione
- 35 Morsetto del blocco di esalazione
- 36 Silenziatore

Configurazione del ventilatore

- “Ispezione sull'uso preliminare” a pagina 42
- “Collegamento del cavo di collegamento equipotenziale” a pagina 42
 - “Collegamento dell'alimentazione elettrica di rete” a pagina 42
 - “Collegamento di alimentazione ausiliario 24 V CC” a pagina 42
- “Montaggio del silenziatore e del blocco di esalazione” a pagina 43
 - “Collegamenti gas” a pagina 43
- “Accensione del ventilatore” a pagina 44



11. Configurazione base del ventilatore

In questa sezione viene descritta in dettaglio la configurazione di un ventilatore neonatale SLE6000 in servizio.

11.1 Ispezione sull'uso preliminare

A. Verificare che i sifoni siano vuoti.

Attenzione. Se i sifoni sono montati con un tappo di scarico manuale e contengono acqua, scaricare manualmente l'acqua prima di procedere con la configurazione.

B. Verificare che il filtro del ventilatore posteriore sia privo di polvere.

Nota: se il filtro è sporco, seguire la procedura di pulizia nella sezione di manutenzione a pagina 235.


C. Assicurarsi che i coperchi siano intatti e che il ventilatore non mostri segni di usura eccessivi o corrosione nelle parti di metallo visibili.

11.2 Collegamento del cavo di collegamento equipotenziale


Nota: se le linee guida ospedaliere richiedono il collegamento equipotenziale dei dispositivi medici, collegarli come descritto in basso. (Il collegamento equipotenziale comporta la connessione tra tutte le componenti metalliche senza corrente per formare una zona nella quale non è possibile per le parti metalliche esposte avere livelli di tensione diversi, il che potrebbe causare folgorazioni ovvero creare una zona equipotenziale messa a terra).

Il punto di collegamento è montato sul retro del ventilatore.

Collegare il cavo di collegamento equipotenziale (1) sul retro della spina di collegamento equipotenziale posteriore (2).

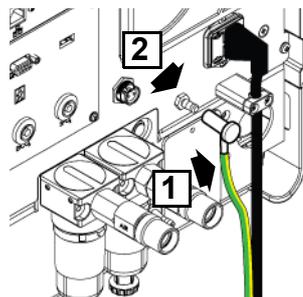

Collegare l'estremità libera del cavo di collegamento equipotenziale dal ventilatore (3) al punto di collegamento equipotenziale (4).

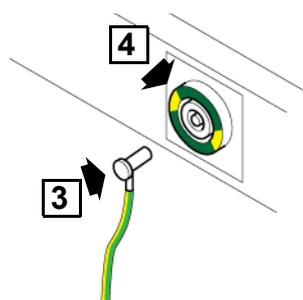


11.3 Collegamento dell'alimentazione elettrica di rete


Nota: l'ambiente ospedaliero può fornire prese staccate per i dispositivi medici.

11.3.1 Cavi di alimentazione in base alla specifica IEC/BS 1363/A3

Inserire la spina di alimentazione di rete nella presa.




Accendere la corrente



11.3.2 Cavi di alimentazione in base alla specifica Schuko e NEMA


Inserire la spina di alimentazione di rete nella presa.

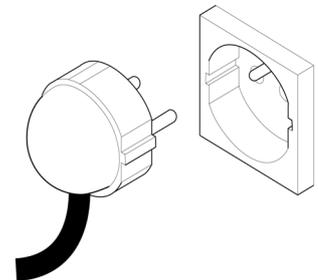

Nota: cavo Schuko mostrato.

11.4 Collegamento di alimentazione ausiliario 24 V CC

Collegare il cavo di alimentazione 24 V CC al connettore di ingresso di alimentazione ausiliario 24 VCC posizionato sul retro del ventilatore.

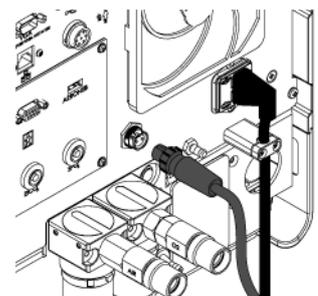

Attenzione: utilizzare esclusivamente un'alimentazione per uso medico da 24 V CC con una corrente nominale di 4 A.

Nota: il cavo di alimentazione non deve essere disconnesso quando si utilizza l'alimentazione ausiliaria da 24 V CC.

11.4.1 Alimentazione di rete o ausiliaria - spia stato interruttore di alimentazione

Quando l'alimentazione di rete o ausiliaria non è connessa al ventilatore la spia alogena intorno all'interruttore di alimentazione verrà spenta.



Quando l'alimentazione di rete o ausiliaria è connessa al ventilatore che è "OFF", la spia alogena intorno all'interruttore di alimentazione si illuminerà. L'alogeno non lampeggiante mostra che le batterie interne sono completamente cariche.




Un alogeno lampeggiante mostra che le batterie interne sono parzialmente o completamente scariche e che sono in carica.




11.5 Montaggio del silenziatore e del blocco di esalazione

Aprire il coperchio di accesso al blocco di esalazione.

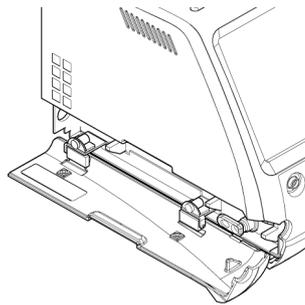


Pulire le porte del gas con alcool.

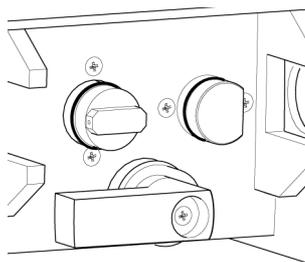

Collegare il silenziatore e il blocco di esalazione insieme.


Le sfere della valvola di scarico indicano il retro del blocco di esalazione.

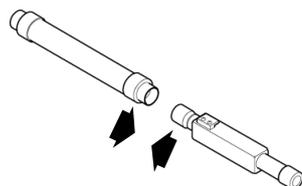

Nota: assicurarsi che il silenziatore e il blocco di esalazione siano stati puliti in conformità con le istruzioni di Pulizia e disinfezione di pagina 235.

Montare il gruppo sulle porte del gas e il blocco in posizione.

Nota: l'utente non sarà in grado di chiudere il coperchio di accesso a meno che il blocco di scarico non sia in posizione ottimale.

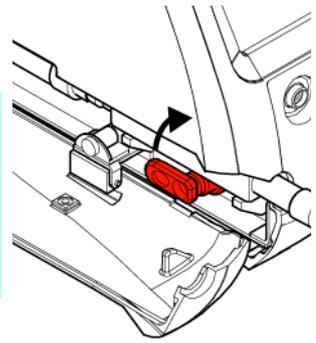


Chiudere il coperchio di accesso.

11.6 Collegamenti gas

Avvertenza. Controllare la condizione dei tubi di alimentazione gas del ventilatore. Non usare tubi che presentano segni di incrinatura, abrasione, attorcigliamento, tagli, usura eccessiva o invecchiamento. Accertarsi che il tubo dell'aria o dell'O₂ non sia venuto a contatto con olii o grassi.


Collegare i tubi di Aria e Ossigeno sul retro di ventilatore.

Assicurarsi che i dadi di aggancio siano stretti a mano.

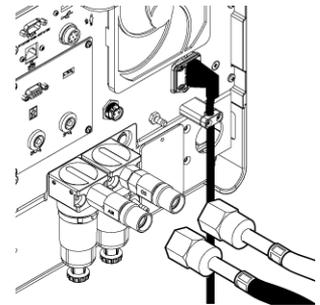

Nota: connettori NIST mostrati.

Collegare le sonde ai collegamenti al muro

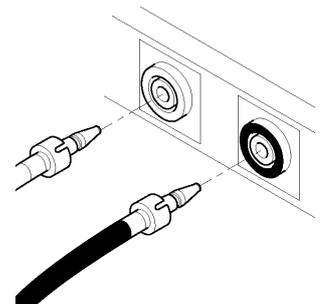

Nota: sonde BS mostrate.

11.7 Ventilatore - posizione di paziente e operatore

In una configurazione standard, il ventilatore deve essere posizionato lateralmente all'estremità della testa dell'incubatore/culla.

La posizione dell'operatore è davanti al ventilatore. L'instradamento del circuito paziente è lasciato a discrezione dell'utente.

Avvertenza. assicurarsi che il sifone sia sempre posizionato sotto il paziente.

11.8 Accensione del ventilatore

11.8.1 Con alimentazione di rete collegata

Tenere premuto l'interruttore di alimentazione per 3 secondi.

La luce alogena deve essere gialla (fissa o lampeggiante).



La luce alogena deve cambiare colore in verde.

Il ventilatore adesso si accenderà ed entrerà in modalità standby.



L'icona della batteria sarà accompagnata dall'icona di alimentazione di rete per mostrare che il ventilatore funziona a corrente.



11.8.2 Senza alimentazione di rete collegata

Tenere premuto l'interruttore di alimentazione per 3 secondi.

La luce alogena deve essere spenta.



La luce alogena deve cambiare colore in verde.

Il ventilatore adesso si accenderà ed entrerà in modalità standby.



L'icona della batteria verrà visualizzata per mostrare che l'unità è in funzione con la batteria.



Nota: dopo che l'unità entri in modalità Standby, l'utente dovrà riconoscere il messaggio di allarme di guasto alimentazione di rete una volta che gli allarmi Calibra il sensore di flusso/ Sensore di flusso vengono cancellati.

11.8.3 Con alimentazione CC connessa

Tenere premuto l'interruttore di alimentazione per 3 secondi.

La luce alogena deve essere gialla (fissa o lampeggiante).



La luce alogena deve cambiare colore in verde.

Il ventilatore adesso si accenderà ed entrerà in modalità standby.



L'icona di alimentazione CC comparirà per mostrare che l'unità è in esecuzione a 24 V CC.



11.9 Test funzionale sull'uso preliminare

11.9.1 Accensione per test automatico

Ogni volta che il ventilatore viene acceso, eseguirà un'accensione per test automatico (POST). Con il POST si verifica il corretto funzionamento dell'unità pneumatica. Eventuali problemi verranno mostrati dalla macchina che mostra gli allarmi tecnici. Il ventilatore attiva inoltre i componenti visivi e audio del sistema di allarme.

- 1 Accendere l'unità
- 2 Verificare che la barra luminosa dell'allarme passi da Rosso, Giallo e Ciano.
- 3 Verificare se sia stato emesso un singolo allarme audio ad alta priorità.

11.9.2 Verifica alimentazione inversa

Guardare l'icona dello stato batteria per vedere lo stato di carica della fonte di alimentazione di riserva.



La capacità nominale va dalla percentuale di 100% completamente carico a 0% completamente scarico.

Se si utilizza il ventilatore senza alimentazione o un'alimentazione da 24 V CC, la seguente è una guida al tempo operativo approssimativo sulla batteria interna.

Il ventilatore funzionerà generalmente per oltre 3 ore con la carica della batteria al 100%, sia in modalità convenzionale che HFO. La durata effettiva della scarica dipenderà dalla condizione della batteria e dalle impostazioni di ventilazione applicate. Fare riferimento all'avviso per un funzionamento sicuro.

Attenzione. Quando la fonte di alimentazione interna del ventilatore raggiunge il 25%, l'utente dovrà sottoporre il paziente a una forma alternativa di ventilazione se la riconnessione dell'alimentazione non è possibile. Al 25% il ventilatore mostrerà ed emetterà l'allarme di "Batteria scarica".

11.9.3 Selezione circuito paziente

- 1 Effettuare la configurazione del circuito paziente, in base al capitolo '12. Selezione circuito paziente' a pagina 50.
- 2 Una volta montato il circuito paziente, continuare con uno dei seguenti test
 - **Sezione doppia invasiva**
Sezione test invasivo '11.9.5 Test funzionale (Doppio lume invasivo)' a pagina 45.
 - **Sezione doppia non invasiva**
Doppia sezione test non invasivo '11.9.6 Test funzionale (Doppio lume non invasivo)' a pagina 46.
 - **Singolo lume non invasivo**
Sezione singola test non invasivo '11.9.7 Test funzionale (sezione singola non invasiva)' a pagina 46.

11.9.4 Verifiche test prima dell'uso.

- Controllare che l'umidificatore sia acceso. (Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni del fabbricante).
- Controllare che la camera di umidificazione sia riempita di acqua sterile appropriata sino al livello indicato.
- Controllare che il connettore di riscaldamento del circuito paziente sia connesso all'umidificatore in modo sicuro. (Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni del fabbricante).
- Controllare il circuito paziente, assicurarsi che tutte le connessioni siano ben fissate e che il sifone dell'acqua sia vuoto e in posizione verticale.
- Controllare che le sonde di temperatura dell'umidificatore siano correttamente inserite nelle porte di monitoraggio del circuito paziente.

11.9.5 Test funzionale (Doppio lume invasivo)

- 1 Rimuovere il sensore di flusso e il polmone di prova.
- 2 Bloccare il connettore endotracheale.
- 3 Selezionare ed entrare nella modalità CMV.

Nota: se viene montato un circuito da 15 mm, selezionare il circuito paziente da 15 mm.

- 4 Premere "Continuare senza sensore di flusso"
- 5 Impostare la soglia di allarme PEEP bassa a -1 mbar.
- 6 Assicurarsi che il ventilatore giri e non ci siano allarmi presenti.
- 7 Assicurarsi che la PIP impostata e la PIP misurata siano entro 1 mbar.
- 8 Assicurarsi che la PEEP impostata e la PEEP misurata siano comprese in 1 mbar.

Nota: se le letture per la fase 7 & 8 sono fuori dalla tolleranza dichiarata, controllare il circuito paziente e verificare di nuovo.

- 9 Scollegare l'alimentazione d'aria.
- 10 Assicurarsi che scatti l'allarme "Nessuna alimentazione d'aria".
- 11 Scollegare l'alimentazione di ossigeno.
- 12 Assicurarsi che scatti l'allarme "Nessun gas".
- 13 Ricollegare l'alimentazione d'aria.
- 14 Ripristinare il messaggio di allarme PIP bassa.
- 15 Assicurarsi che scatti l'allarme "Nessuna alimentazione di ossigeno".
- 16 Ricollegare l'alimentazione di ossigeno.
- 17 Assicurarsi che tutti gli allarmi si cancellino.
- 18 Selezionare ed entrare nella modalità HFOV.
- 19 Impostare un Delta P di 10 mbar.
- 20 Assicurarsi che il ventilatore giri e che non sia presente nessun allarme.
- 21 Assicurarsi che la MAP impostata e la MAP misurata siano entro 1 mbar.

Nota: se la lettura per la fase 21 è fuori dalla tolleranza dichiarata, controllare il circuito paziente e verificare di nuovo.

- 22 Rimuovere la sezione Gas fresco.
- 23 Assicurarsi che scatti l'allarme "Perdita gas fresco".
- 24 Bloccare la porta di gas fresco.
- 25 Assicurarsi che scatti l'allarme "Gas fresco bloccato".
- 26 Rimontare la sezione Gas fresco. Verificare che tutti gli allarmi si cancellino.
- 27 Ricollegare il sensore di flusso e il cavo del sensore di flusso.
- 28 Calibrare il sensore di flusso.
- 29 Attendere che compaia il testo "Calibrazione completata".
- 30 Rimontare il sensore di flusso e il polmone di prova.
- 31 Scollegare l'alimentazione elettrica di rete.
- 32 Assicurarsi che sia triggerato l'allarme "Guasto alimentazione di rete". Verificare che scompaia il simbolo alimentazione di rete.
- 33 Ricollegare l'alimentazione elettrica di rete.
- 34 Assicurarsi che l'allarme "Guasto alimentazione di rete" si annulli. Verificare che scompaia il simbolo alimentazione di rete.
- 35 Ritornare alla modalità standby
- 36 La verifica funzionale adesso è completa.

11.9.6 Test funzionale (Doppio lume non invasivo)

Nota: la ventilazione non invasiva non richiede l'uso del sensore di flusso. Se il sensore di flusso o il cavo del sensore di flusso è collegato, scollegarlo prima di iniziare la verifica funzionale.

- 1 Selezionare e inserire NIPPV D - modalità sezione doppia.
- 2 Occludere le cannule.
- 3 Impostare la soglia di allarme PEEP bassa a -1 mbar.
- 4 Assicurarsi che il ventilatore giri e non ci siano allarmi presenti.
- 5 Assicurarsi che la PIP impostata e la PIP misurata siano entro 1 mbar.
- 6 Assicurarsi che la PEEP impostata e la PEEP misurata siano comprese in 1 mbar.

Nota: se le letture per la fase 5 & 6 sono fuori dalla tolleranza dichiarata, controllare il circuito paziente e verificare di nuovo.

- 7 Scollegare l'alimentazione d'aria.
- 8 Assicurarsi che scatti l'allarme "Nessuna alimentazione d'aria".
- 9 Scollegare l'alimentazione di ossigeno.
- 10 Assicurarsi che scatti l'allarme "Nessun gas".
- 11 Ricollegare l'alimentazione d'aria.
- 12 Ripristinare il messaggio di allarme PIP bassa.
- 13 Assicurarsi che scatti l'allarme "Nessuna alimentazione di ossigeno".
- 14 Ricollegare l'alimentazione di ossigeno.
- 15 Assicurarsi che tutti gli allarmi si cancellino.
- 16 Rimuovere la sezione Gas fresco.
- 17 Assicurarsi che scatti l'allarme "Perdita gas fresco".
- 18 Bloccare la porta di gas fresco.
- 19 Assicurarsi che scatti l'allarme "Gas fresco bloccato".
- 20 Rimontare la sezione Gas fresco. Verificare che tutti gli allarmi si cancellino.
- 21 Selezionare e inserire NHFOV - modalità doppio lume.
- 22 Impostare un Delta P di 10 mbar.
- 23 Assicurarsi che il ventilatore giri e non siano presenti allarmi. Assicurarsi che la MAP impostato e la MAP misurata siano entro 1 mbar.

Nota: se la lettura per la fase 23 è fuori dalla tolleranza dichiarata, controllare il circuito paziente e verificare di nuovo.

- 24 Scollegare l'alimentazione elettrica di rete.
- 25 Assicurarsi che sia triggerato l'allarme "Guasto alimentazione di rete". Verificare che scompaia il simbolo alimentazione di rete.
- 26 Ricollegare l'alimentazione elettrica di rete.
- 27 Assicurarsi che l'allarme "Guasto alimentazione di rete" si annulli. Verificare che scompaia il simbolo alimentazione di rete.
- 28 Ritornare alla modalità standby
- 29 La verifica funzionale adesso è completa.

11.9.7 Test funzionale (sezione singola non invasiva)

Nota: la ventilazione non invasiva non richiede l'uso del sensore di flusso. Se il sensore di flusso o il cavo del sensore di flusso è collegato, scollegarlo prima di iniziare la verifica funzionale.

- 1 Selezionare ed entrare nella modalità della sezione singola nCPAP.
- 2 Occludere le cannule
- 3 Impostare il controllo CPAP a 5 mbar
- 4 Assicurarsi che il CPAP impostato e il CPAP misurato siano entro 1 mbar.
- 5 Scollegare l'alimentazione d'aria.
- 6 Assicurarsi che scatti l'allarme "Nessuna alimentazione d'aria".
- 7 Scollegare l'alimentazione di ossigeno.
- 8 Assicurarsi che scatti l'allarme "Nessun gas".
- 9 Ricollegare l'alimentazione d'aria.
- 10 Ripristinare il messaggio di allarme PIP bassa.
- 11 Assicurarsi che scatti l'allarme "Nessuna alimentazione di ossigeno".
- 12 Ricollegare l'alimentazione di ossigeno.
- 13 Assicurarsi che tutti gli allarmi si cancellino.
- 14 Rimuovere la sezione Gas fresco.
- 15 Assicurarsi che scatti l'allarme "bassa pressione".
- 16 Bloccare la porta di gas fresco.
- 17 Assicurarsi che scatti l'allarme "Gas fresco bloccato".
- 18 Rimontare la sezione Gas fresco. Verificare che tutti gli allarmi si cancellino.
- 19 Scollegare l'alimentazione elettrica di rete.
- 20 Assicurarsi che sia triggerato l'allarme "Guasto alimentazione di rete". Verificare che scompaia il simbolo alimentazione di rete.
- 21 Ricollegare l'alimentazione elettrica di rete.
- 22 Assicurarsi che l'allarme "Guasto alimentazione di rete" si annulli. Verificare che scompaia il simbolo alimentazione di rete.
- 23 Ritornare alla modalità standby
- 24 La verifica funzionale adesso è completa.


11.10 Spegnimento del ventilatore

Al completamento della sessione, l'utente deve entrare in modalità standby.

Tenere premuto il pulsante di alimentazione per 2 secondi.



Il pannello informativo sarà sostituito dalla finestra di dialogo e dal pulsante di arresto.

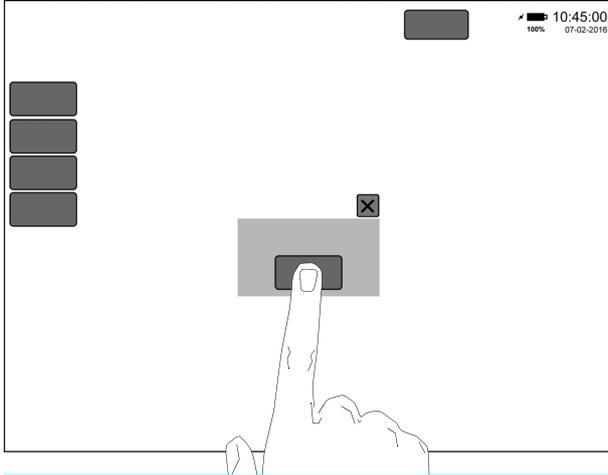


Nota: la finestra di dialogo di arresto si chiuderà tra 10 secondi se non vengono intraprese azioni.

L'utente dovrà premere di nuovo momentaneamente l'interruttore di alimentazione per annullare l'allarme sonoro "Mancanza di alimentazione".

Avvertenza: se la componente sonora dell'allarme mancanza di alimentazione non funziona, portare il ventilatore in assistenza e chiedere la riparazione dell'unità.

11.10.1 Isolamento dall'alimentazione di rete

Per isolare il ventilatore dall'alimentazione di rete, rimuovere la spina.

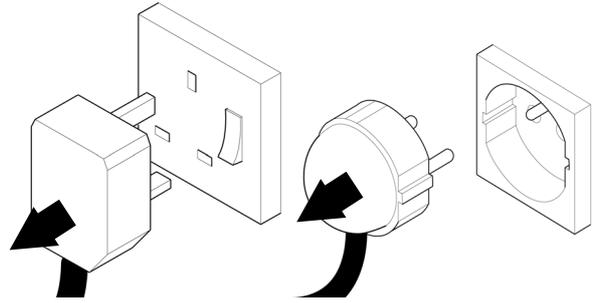

Avvertenza: assicurarsi che il ventilatore sia posizionato in modo tale che non sia difficile effettuare la disconnessione del dispositivo.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Selezione circuito paziente

Vedere “Montaggio del circuito paziente BC6188 (Ø 10 mm) o BC6198 (Ø 15 mm)” a pagina 50.

Vedere “Montaggio del circuito paziente BC6188/DHW” a pagina 54.

Vedere “Modifica dei circuiti BC6188 o BC6188/DHW per una ventilazione a doppio lume non invasiva.” a pagina 57.

Vedere “Modifica dei circuiti BC6188 o BC6188/DHW per ventilazione a singolo lume non invasivo.” a pagina 58.



12. Selezione circuito paziente

Si possono usare con il ventilatore SLE6000 tre circuiti pazienti che sono approvati per l'uso.

BC6188 Circuito di respirazione neonatale/infante monouso – tubo da 10 mm, cavo singolo riscaldato. (Convenzionale e HFOV)

BC6188/DHW Circuito di respirazione neonatale/infante – tubo da 10/15 mm, cavo riscaldato doppio. (Convenzionale e HFOV)

BC6198 Circuito di respirazione pediatrico monouso – tubo da 15 mm. (Uso solo convenzionale).

12.1 Tipo di ventilazione

12.1.1 Invasiva

È consigliata per i pazienti che richiedono volumi correnti inferiori a 50 ml per utilizzare i circuiti pazienti **BC6188** o **BC6188/DHW** per la ventilazione convenzionale e oscillatoria.

È consigliata per i pazienti che richiedono volumi correnti superiori a 50 ml per utilizzare i circuiti pazienti **BC6188** o **BC6188/DHW** per la ventilazione convenzionale e oscillatoria.

12.1.2 Non invasiva (sezione doppia)

Utilizzare:

BC6188

BC6188/DHW

Vedere “Modifica dei circuiti BC6188 o BC6188/DHW per una ventilazione a doppio lume non invasiva.” a pagina 57.

12.1.3 Non invasivo (singolo lume)

Uso

BC6188.

BC6188/DHW

Vedere “Modifica dei circuiti BC6188 o BC6188/DHW per ventilazione a singolo lume non invasivo.” a pagina 58.

12.1.4 Alti flussi non invasivi (singolo lume)

Uso

BC6188.


BC6188/DHW

Vedere “Modifica dei circuiti BC6188 o BC6188/DHW per Alti flussi - Singolo lume non invasiva.” a pagina 61.


12.1.4.1 Selezione circuito paziente

Il pannello della modalità invasiva contiene due pulsanti che consentono all'utente di selezionare circuiti pazienti con diametro compreso tra 10 mm e 15 mm.

Circuito paziente
10 mm



15mm



Nota: la selezione dei circuiti pazienti da 15 mm è disponibile solo per la ventilazione invasiva. Passando alla ventilazione non invasiva si selezionano automaticamente i circuiti paziente da 10 mm.


12.2 Montaggio del circuito paziente BC6188 (Ø 10 mm) o BC6198 (Ø 15 mm)

Le seguenti istruzioni riguardano il montaggio del circuito paziente BC6188 con Ø da 10 mm (Neonatale) e del circuito paziente BC6198 da Ø 15 mm (pediatrico). Entrambi sono circuiti a singolo lume riscaldati.

12.2.1 Filtri batterici

Avviso: è necessario l'uso di filtri batterici tra la porta del gas fresco e la linea di alimentazione dell'umidificatore e il blocco di esalazione ed il ramo espiratorio del circuito.


- 1 Montare il filtro batterico monouso (A) sulla porta di scarico dalla porta paziente.
- 2 Montare il filtro batterico monouso (A) sulla porta di scarico dalla porta paziente.

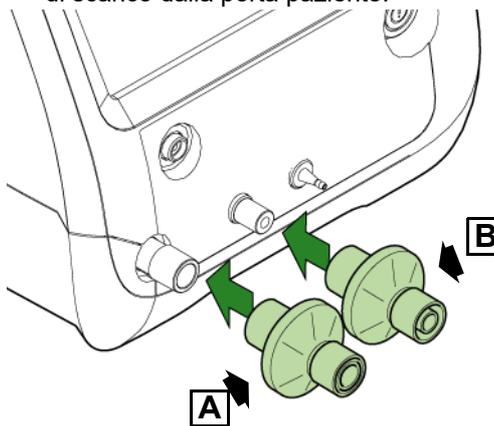

Fare riferimento al catalogo dei prodotti di consumo o al sito Web SLE per i pezzi di ricambio.

12.2.2 Camera di umidificazione

Assicurarsi che la camera sia montata in modo sicuro sull'umidificatore e riempita con il livello corretto di acqua sterile.

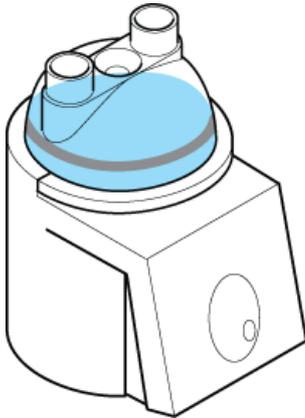

Nota: queste istruzioni sono illustrate con una camera di umidificazione monouso standard.

È possibile utilizzare le camere di riempimento automatico e riutilizzabili. Le camere riutilizzabili richiederanno l'uso di un adattatore per la fornitura di gas fresco.


Nota: fare riferimento al manuale utente dell'umidificatore per avvertenze, avvisi e istruzioni operative.

Fare riferimento alle istruzioni del circuito paziente per l'uso, le avvertenze, gli avvisi e le istruzioni operative.


- 1 Rimuovere il circuito paziente dalla custodia protettiva.

Nota: il circuito BC6188 non è fornito di camera di umidificazione (G).


- 2 Collegare l'estremità femmina da 15 mm (C) della linea di alimentazione del gas fresco (D) al filtro batterico montato sulla porta del ventilatore contrassegnata come "Gas fresco al paziente" (E).

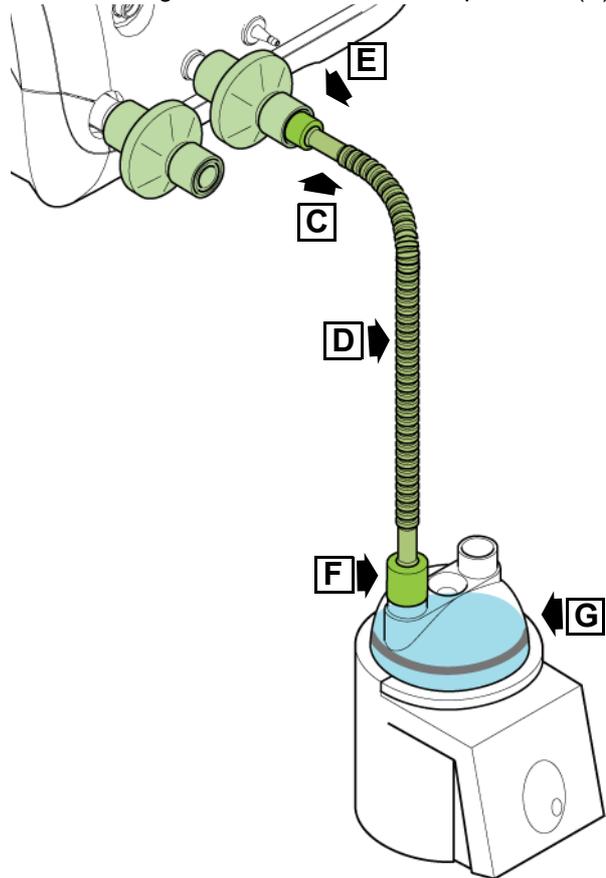

- 3 Collegare l'estremità libera (F) della linea di alimentazione del gas fresco (D) a una delle porte della camera di umidificazione (G).
- 4 La sezione rimanente del circuito è montata.
- 5 Collegare la sezione riscaldata (H) alla porta libera della camera di umidificazione (I).

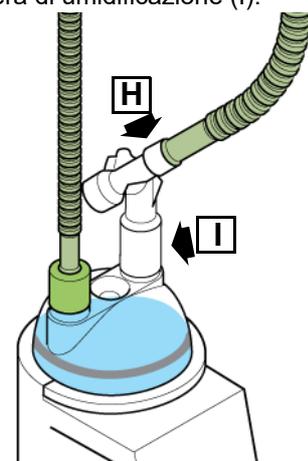


- 6 Collegare il ramo espiratorio (J) al filtro batterico montato sulla porta di scarico (K) contrassegnata "Porta di scarico dal paziente".

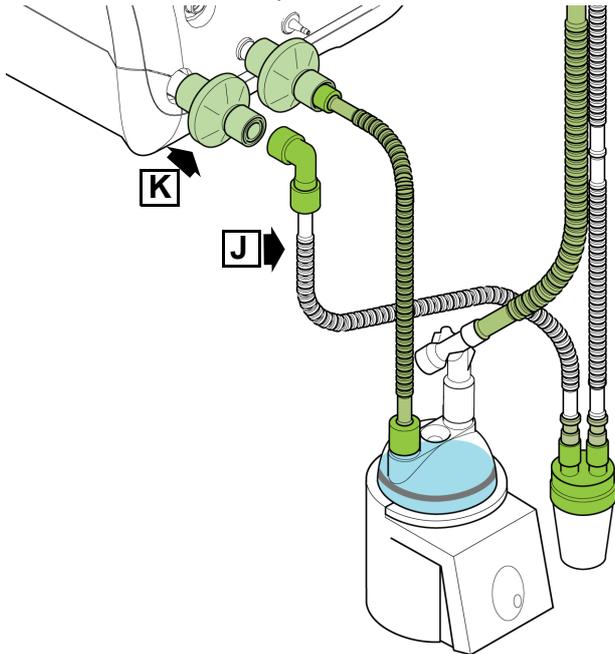


Avvertenza. Assicurarsi che il sifone dell'acqua sia sempre posizionato più in basso del paziente.

- 7 Collegare la linea prossimale delle vie respiratorie (L) alla porta prossimale delle vie respiratorie (M) contrassegnata "Via aerea prossimale".

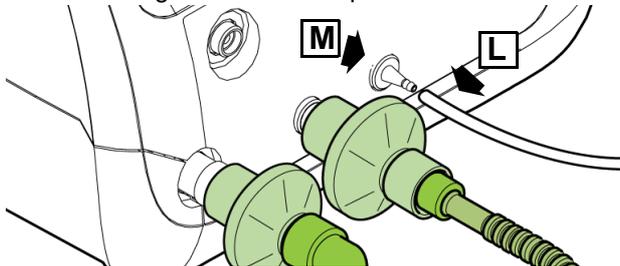


12.2.3 Montaggio delle sonde di temperatura sul circuito paziente BC6188

- 8 Collegare le sonde di temperatura dell'umidificatore alle porte (N e O).

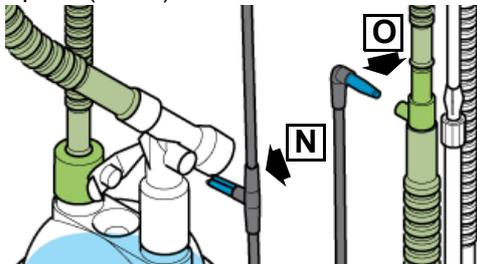


- 9 Assicurarsi che il fermo (P) sia posizionato sulla sonda di temperatura per garantire l'orientamento corretto.

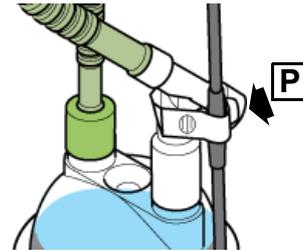


12.2.4 Montaggio delle sonde di temperatura sul circuito paziente BC6198


- 10 Collegare le sonde di temperatura dell'umidificatore alle porte (N e O).

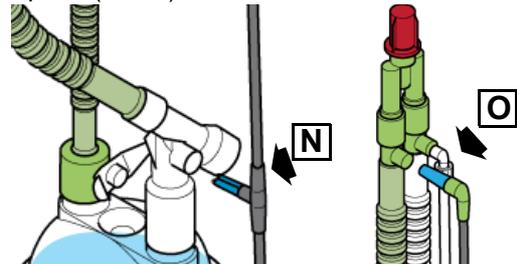


- 11 Assicurarsi che il fermo (P) sia posizionato sulla sonda di temperatura per garantire l'orientamento corretto.

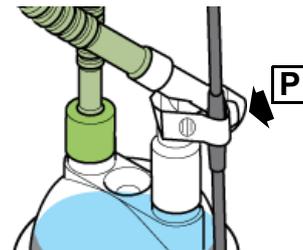


- 12 Collegare il cavo per riscaldatore dell'umidificatore (Q) alla porta sulla sezione inspiratoria riscaldata (H).

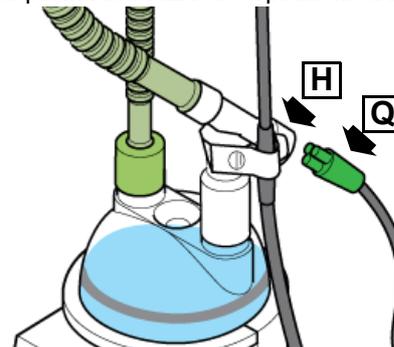


- 13 Collegare il cavo del riscaldatore (Q) e le sonde di temperatura (R) all'umidificatore.

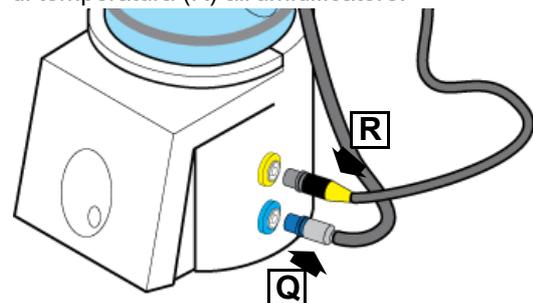

- 14 Collegare il cavo del sensore di flusso (S) al connettore elettrico sulla parte anteriore del ventilatore contrassegnata "Sensore di flusso" (T).

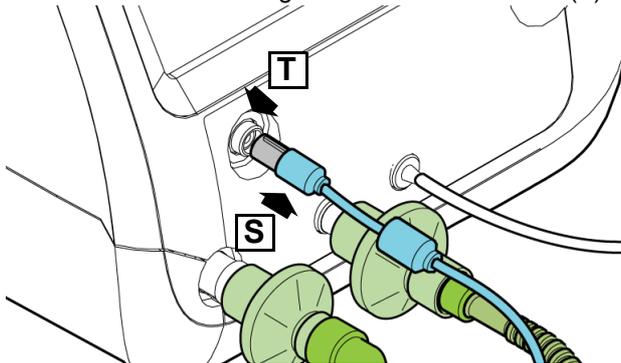


- 15 Collegare il cavo del sensore di flusso al sensore di flusso stesso. Assicurarsi che la chiave del connettore del cavo si adatti all'incavo posteriore del connettore del sensore di flusso.

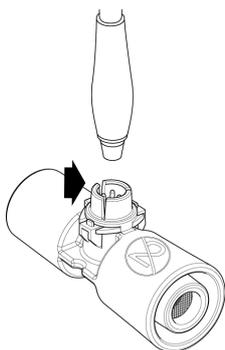

Nota: se il circuito paziente viene montato con il ventilatore spento, saltare le fasi 16 e 20.

- 16 Il ventilatore invierà l'allarme calibra sensore di flusso. Premere il pulsante "Calibra" nella barra delle informazioni per attivare il pannello del sensore o premere il pulsante "Strumenti" o il pulsante "Calibrazione ed UtENZE".

- 17 Bloccare il sensore di flusso per impedire qualsiasi flusso attraverso i fili del sensore.




Attenzione: per evitare la contaminazione del sensore di flusso, utilizzare i guanti quando si effettua la calibrazione.


- 18 Premere il pulsante Avvia calibrazione e il testo "Calibrazione in corso..." verrà mostrato sopra il pulsante
- 19 Una volta che le calibrazioni hanno superato il test, comparirà "Calibrazione completa".
- 20 Il sensore di flusso adesso è calibrato.

12.2.5 Montaggio del sensore di flusso sul circuito paziente BC6188

- 21 Rimuovere il coperchio antipolvere (U) dal collettore endotracheale (V).



- 22 Inserire il sensore di flusso (W) nel collettore endotracheale (V).




- 23 Il circuito paziente adesso è pronto per l'uso.


Nota: l'applicazione del tubo endotracheale non è trattata in questo manuale.

12.2.6 Montaggio del sensore di flusso sul circuito paziente BC6198

- 24 Rimuovere il coperchio antipolvere (U) dal collettore endotracheale (V).

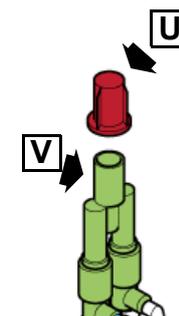

- 25 Inserire il sensore di flusso (W) nel collettore endotracheale (V).




- 26 Il circuito paziente adesso è pronto per l'uso.

Nota: l'applicazione del tubo endotracheale non è trattata in questo manuale.

12.2.7 Montaggio del polmone di prova

Una volta montato il circuito paziente, collegare il polmone di prova (X) al sensore di flusso (W). Il circuito è pronto per il test funzionale di uso preliminare.




12.3 Montaggio del circuito paziente BC6188/DHW

Le seguenti istruzioni coprono il montaggio del circuito paziente BC6188/DHW con Ø da 10 mm (Neonatale), un circuito riscaldato a doppio lume.

12.3.1 Filtri batterici

Avviso: è necessario l'uso di filtri batterici tra la porta del gas fresco e la linea di alimentazione dell'umidificatore e il blocco di esalazione ed il ramo espiratorio del circuito.


- 1 Montare il filtro batterico monouso (A) sulla porta di scarico dalla porta paziente.
- 2 Montare il filtro batterico monouso (A) sulla porta di scarico dalla porta paziente.

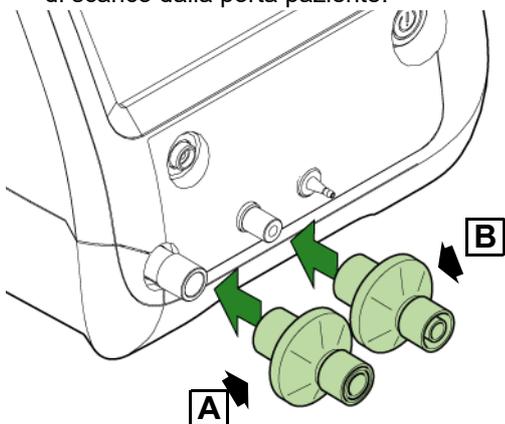

Fare riferimento al catalogo dei prodotti di consumo o al sito Web SLE per i pezzi di ricambio.

12.3.2 Camera di umidificazione

Assicurarsi che la camera sia montata in modo sicuro sull'umidificatore e riempita con il livello corretto di acqua sterile.

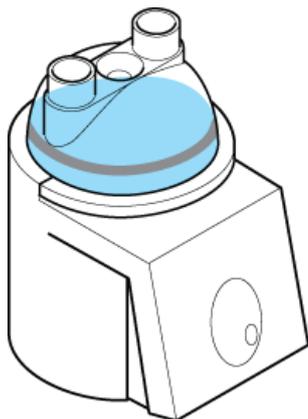


Nota: fare riferimento al manuale utente dell'umidificatore per avvertenze, avvisi e istruzioni operative.

Fare riferimento alle istruzioni del circuito paziente per l'uso, le avvertenze, gli avvisi e le istruzioni operative.


Note: questa configurazione richiede un cavo per doppio filo riscaldato.

- 1 Rimuovere il circuito paziente dalla custodia protettiva.
- 2 Collegare l'estremità femmina da 15 mm (C) della linea di alimentazione del gas fresco (D) al filtro batterico montato sulla porta del ventilatore contrassegnata come "Gas fresco al paziente" (E).

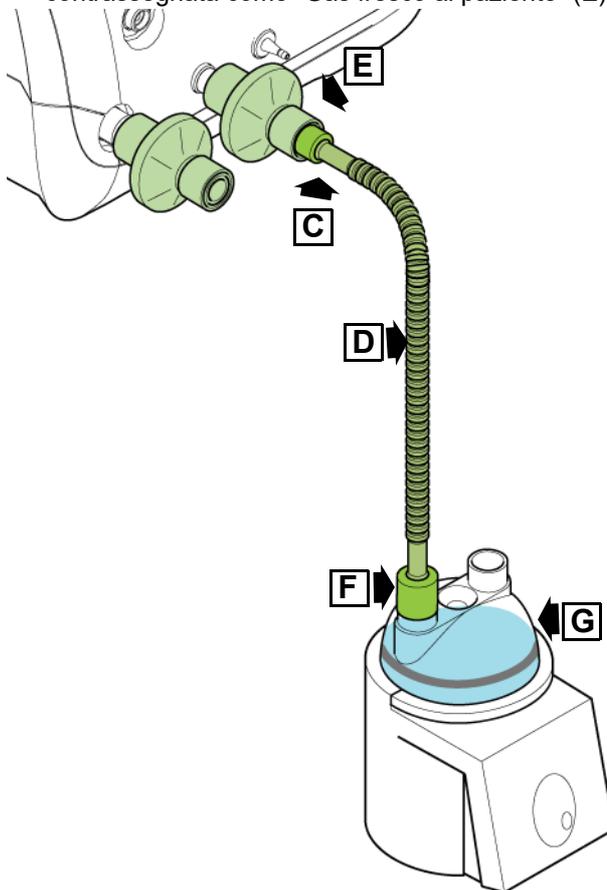


- 3 Collegare l'estremità libera (F) della linea di alimentazione del gas fresco (D) a una delle porte della camera di umidificazione (G).
- 4 La sezione rimanente del circuito è montata.


- 5 Collegare la sezione riscaldata (H) alla porta libera della camera di umidificazione (I).

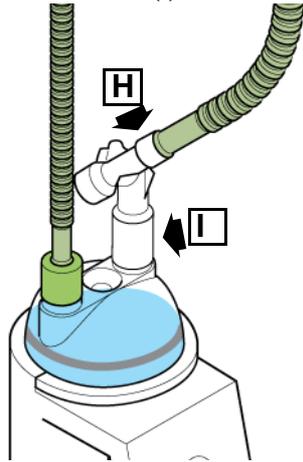


- 6 Collegare il ramo espiratorio (J) al filtro batterico montato sulla porta di scarico (K) contrassegnata "Porta di scarico dal paziente".

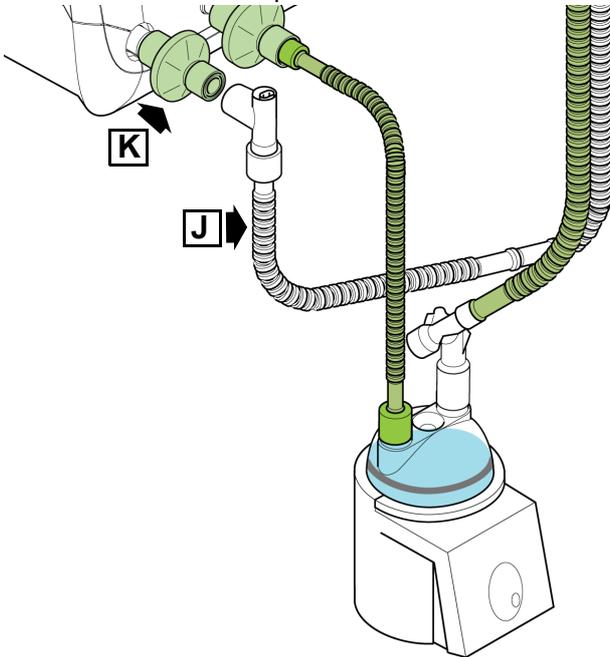


- 7 Collegare la linea prossimale delle vie respiratorie (L) alla porta prossimale delle vie respiratorie (M) contrassegnata "Via aerea prossimale".

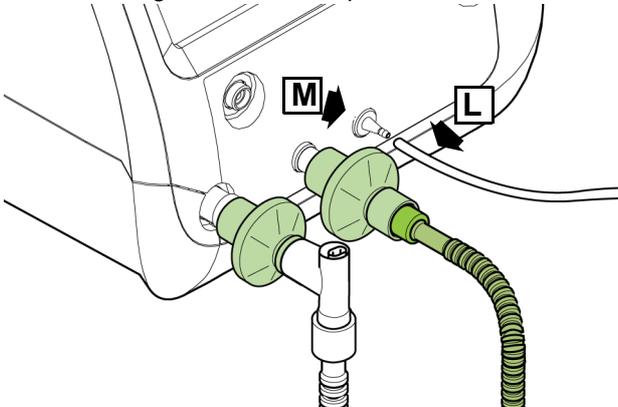


- 8 Collegare le sonde di temperatura dell'umidificatore alle porte (N e O).

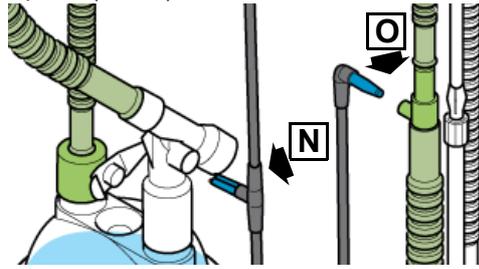


- 9 Assicurarsi che il fermo (P) sia posizionato sulla sonda di temperatura per garantire l'orientamento corretto.

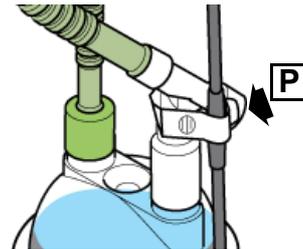


- 10 Collegare il cavo del riscaldatore della sezione inspiratoria alla porta (Q) sulla sezione inspiratoria riscaldata (H).

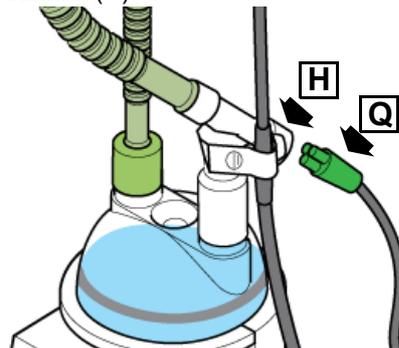


- 11 Collegare il cavo del riscaldatore della sezione espiratoria alla porta (Q) sulla sezione inspiratoria riscaldata (H).

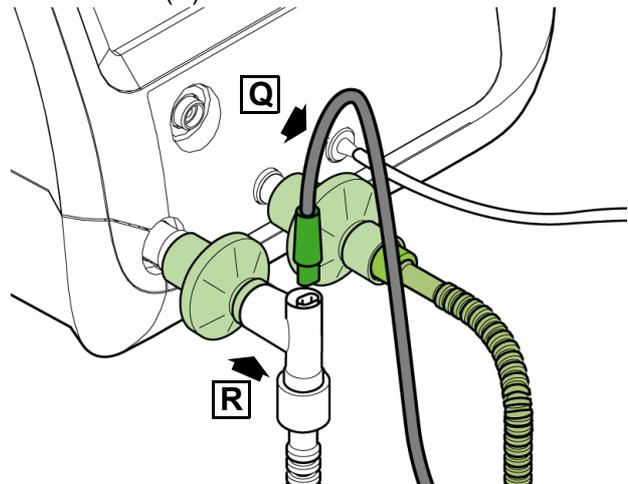


- 12 Collegare il cavo del riscaldatore (S) e le sonde di temperatura (T) all'umidificatore.

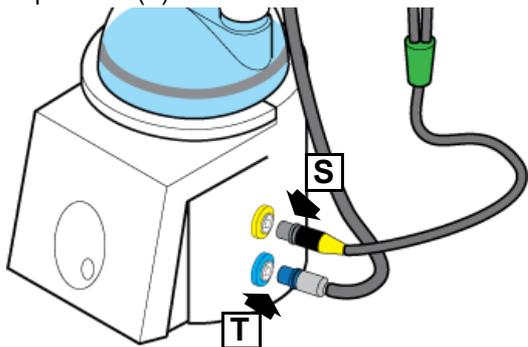

- 13 Collegare il cavo del sensore di flusso (U) al connettore elettrico sulla parte anteriore del ventilatore contrassegnata "Sensore di flusso" (V).

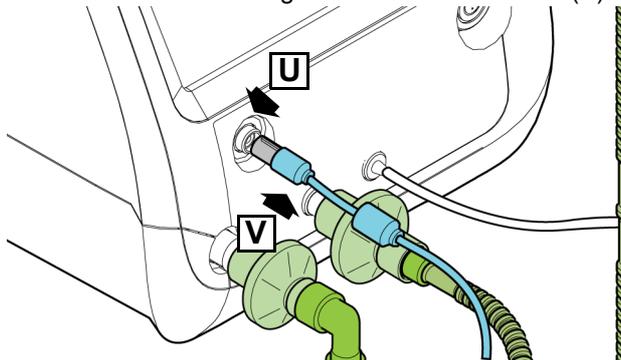


- 14 Collegare il cavo del sensore di flusso al sensore di flusso stesso. Assicurarsi che la chiave del connettore del cavo si adatti all'incavo posteriore del connettore del sensore di flusso.

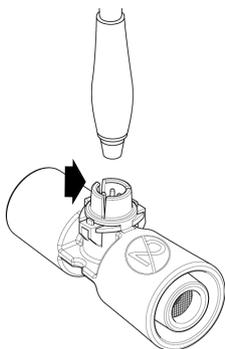

Nota: se il circuito paziente viene montato con il ventilatore spento, saltare le fasi 15 e 19.

- 15 Il ventilatore invierà l'allarme calibra sensore di flusso. Premere il pulsante "Calibra" nella barra delle informazioni per attivare il pannello del sensore o premere il pulsante "Strumenti" o il pulsante "Calibrazione ed UtENZE".

- 16 Bloccare il sensore di flusso per impedire qualsiasi flusso attraverso i fili del sensore.




Attenzione: per evitare la contaminazione del sensore di flusso, utilizzare i guanti quando si effettua la calibrazione.

- 17 Premere il pulsante Avvia calibrazione e il testo "Calibrazione in corso..."verrà mostrato sopra il pulsante

- 18 Una volta che le calibrazioni hanno superato il test, comparirà "Calibrazione completa".


- 19 Il sensore di flusso adesso è calibrato.

- 20 Rimuovere il coperchio antipolvere (W) dal collettore endotracheale (X).



- 21 Inserire il sensore di flusso (Y) nel collettore endotracheale (V).


- 22 Il circuito paziente adesso è pronto per l'uso.



Nota: l'applicazione del tubo endotracheale non è trattata in questo manuale.

12.3.3 Montaggio del polmone di prova


Una volta montato il circuito paziente, collegare il polmone di prova (Z) al sensore di flusso (Y). Il circuito è pronto per il test funzionale di uso preliminare.




12.4 Modifica dei circuiti BC6188 o BC6188/DHW per una ventilazione a doppio lume non invasiva.

Nota: il sensore di flusso e il cavo del sensore di flusso non sono necessari per questa impostazione.


- 1 Montare il circuito paziente BC6188 seguendo le indicazioni sezione 12.2 a pagina 50 o il circuito paziente BC6188/DHW sezione 12.3 a pagina 54.
- 2 Scollegare la linea prossimale delle vie respiratorie (A) dal collettore endotracheale (B) nel connettore luer.

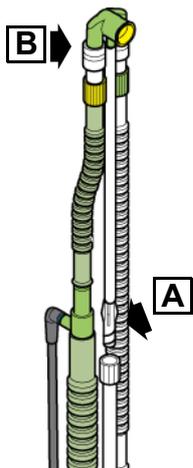

- 3 Scollegare il collettore endotracheale (B) dalla sezione inspiratoria (C) e dalla sezione espiratoria (D).

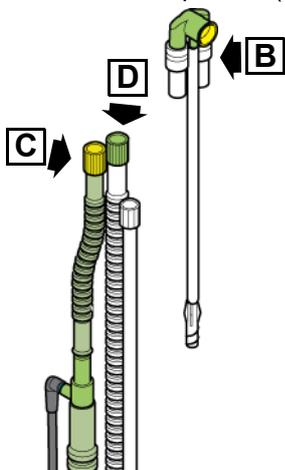


- 4 Rimuovere l'adattatore luer (E) dalla custodia accessoria fornita con il circuito.




- 5 Collegare la linea prossimale vie respiratorie (F) all'adattatore.

- 6 Inserire l'adattatore (G) nella sezione espiratoria (D).



12.4.1 Montaggio di un generatore nCPAP a doppio lume.

- 7 Rimuovere il generatore nCPAP (H) dalla confezione.
- 8 Collegare il generatore alla sezione inspiratoria (C) e la sezione espiratoria (D) del circuito paziente.

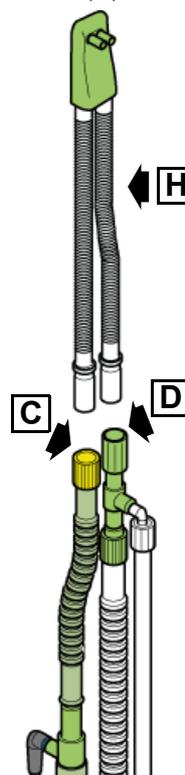

Nota: l'applicazione delle cannule/maschera non è descritta in questo manuale. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il generatore nCPAP.


12.5 Modifica dei circuiti BC6188 o BC6188/DHW per ventilazione a singolo lume non invasivo.

Nota: il sensore di flusso e il cavo del sensore di flusso non sono necessari per questa impostazione.

12.5.1 Filtri batterici

Avviso: è necessario l'uso di filtri batterici tra la porta del gas fresco e la linea di alimentazione dell'umidificatore e il blocco di esalazione ed il ramo espiratorio del circuito.


- 1 Montare il filtro batterico monouso (A) sulla porta di scarico dalla porta paziente (B).

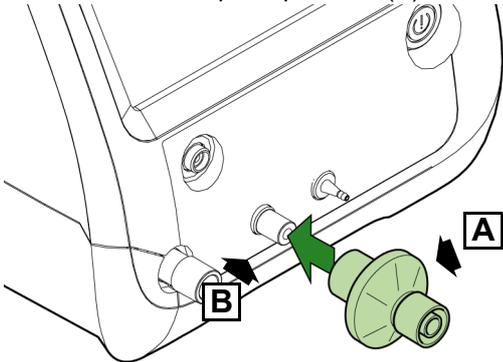

Fare riferimento al catalogo dei prodotti di consumo o al sito Web SLE per i pezzi di ricambio.

12.5.2 Camera di umidificazione

Assicurarsi che la camera sia montata in modo sicuro sull'umidificatore e riempita con il livello corretto di acqua sterile.

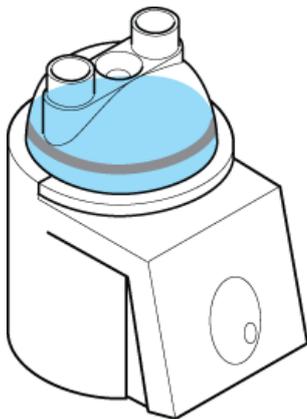


Nota: fare riferimento al manuale utente dell'umidificatore per avvertenze, avvisi e istruzioni operative.

Fare riferimento alle istruzioni del circuito paziente per l'uso, le avvertenze, gli avvisi e le istruzioni operative.

- 1 Rimuovere il circuito paziente dalla custodia protettiva.


Nota: il circuito BC6188 non è fornito di camera di umidificazione (G).

- 2 Collegare l'estremità femmina da 15 mm (C) della linea di alimentazione del gas fresco (D) al filtro batterico montato sulla porta del ventilatore contrassegnata come "Gas fresco al paziente" (E).

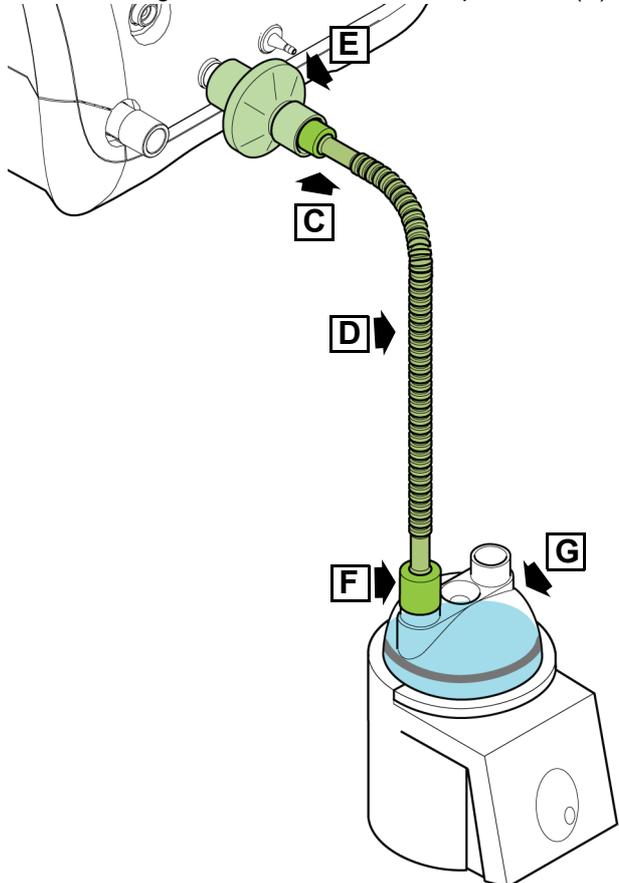


- 3 Collegare l'estremità libera (F) della linea di alimentazione del gas fresco (D) a una delle porte della camera di umidificazione (G).

- 4 Scollegare la sezione inspiratoria (H) dal circuito nella porta della sonda di temperatura e la linea prossimale delle vie respiratorie (I) dal collettore endotracheale svitando il connettore luer.

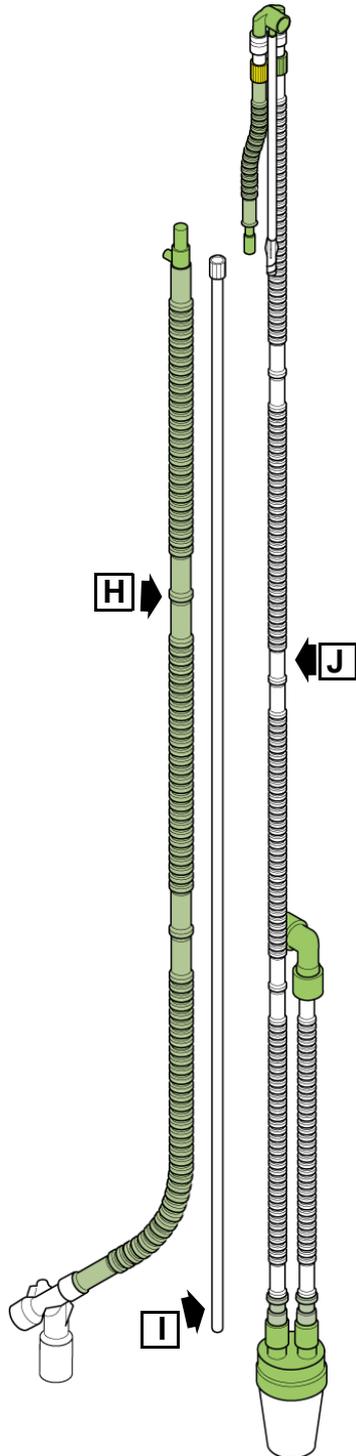


- 5 Rimettere la parte rimanente del circuito (J) di nuovo nella confezione originale.

- 6 Collegare la sezione riscaldata (H) alla porta libera della camera di umidificazione (G).

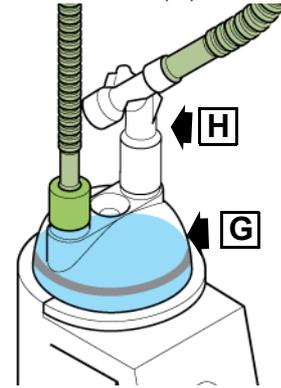


- 7 Collegare la linea prossimale delle vie respiratorie (K) al filtro batterico montato sulla porta prossimale vie respiratorie (L) contrassegnata "Linea prossimale delle vie respiratorie".

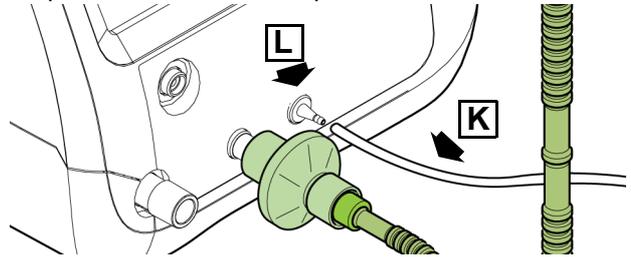


12.5.3 Montaggio delle sonde di temperatura


- 8 Collegare le sonde di temperatura dell'umidificatore alle porte (M e N).

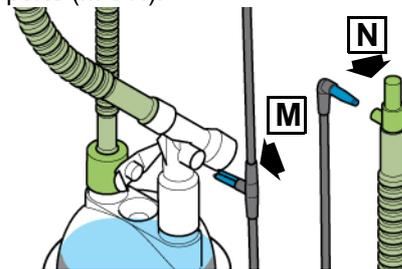


- 9 Assicurarsi che il fermo (O) sia posizionato sulla sonda di temperatura per garantire l'orientamento corretto.

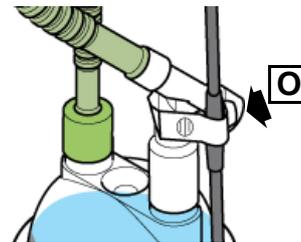

- 10 Collegare il cavo del riscaldatore umidificatore (O) alla porta sulla sezione inspiratoria riscaldata (H).

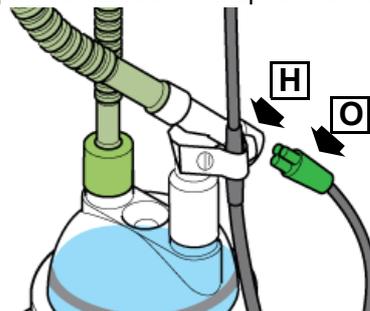


- 11 Collegare il cavo del riscaldatore (O) e le sonde di temperatura (P) all'umidificatore.

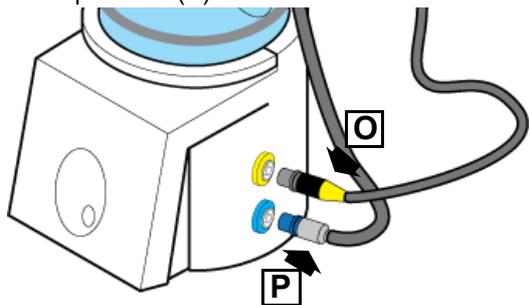


Nota: l'applicazione delle cannule/maschera non è descritta in questo manuale. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il generatore nCPAP.

12.5.4 Montaggio di un generatore nCPAP a singolo lume.

- 12 Rimuovere il generatore nCPAP (Q) dalla confezione.
- 13 Collegare il generatore alla sezione (H) inspiratoria del circuito paziente.

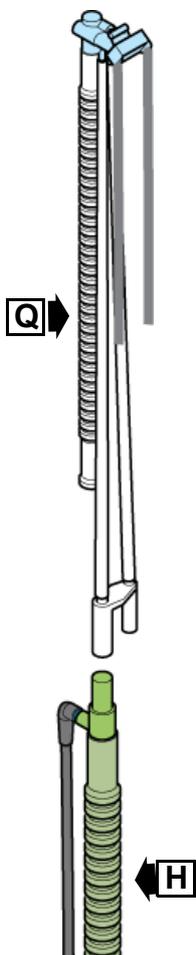

- 14 Collegare la linea prossimale delle vie respiratorie (I) alla porta della linea di monitoraggio della pressione (R) sul generatore nCPAP.




12.6 Modifica dei circuiti BC6188 o BC6188/DHW per Alti flussi - Singolo lume non invasiva.

Nota: il sensore di flusso e il cavo del sensore di flusso non sono necessari per questa impostazione.

12.6.1 Filtri batterici

Avviso: è necessario l'uso di filtri batterici tra la porta del gas fresco e la linea di alimentazione dell'umidificatore e il blocco di esalazione ed il ramo espiratorio del circuito.


- 1 Montare il filtro batterico monouso (A) sulla porta di scarico dalla porta paziente (B).

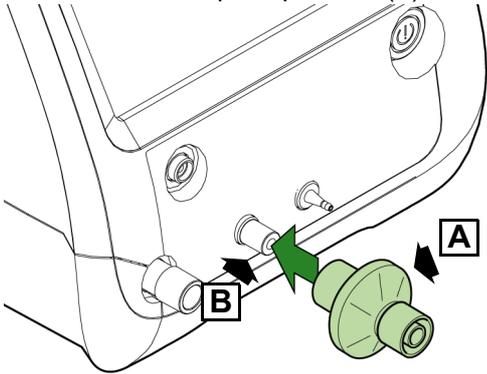

Fare riferimento al catalogo dei prodotti di consumo o al sito Web SLE per i pezzi di ricambio.

12.6.2 Camera di umidificazione

Assicurarsi che la camera sia montata in modo sicuro sull'umidificatore e riempita con il livello corretto di acqua sterile.

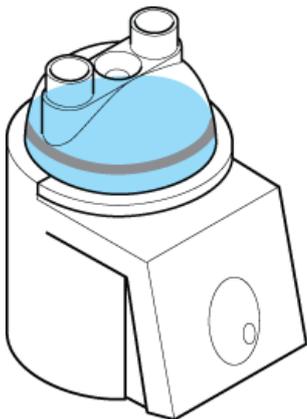


Nota: fare riferimento al manuale utente dell'umidificatore per avvertenze, avvisi e istruzioni operative.

Fare riferimento alle istruzioni del circuito paziente per l'uso, le avvertenze, gli avvisi e le istruzioni operative.

- 1 Rimuovere il circuito paziente dalla custodia protettiva.


Nota: il circuito BC6188 non è fornito di camera di umidificazione (G).

- 2 Collegare l'estremità femmina da 15 mm (C) della linea di alimentazione del gas fresco (D) al filtro batterico montato sulla porta del ventilatore contrassegnata come "Gas fresco al paziente" (E).

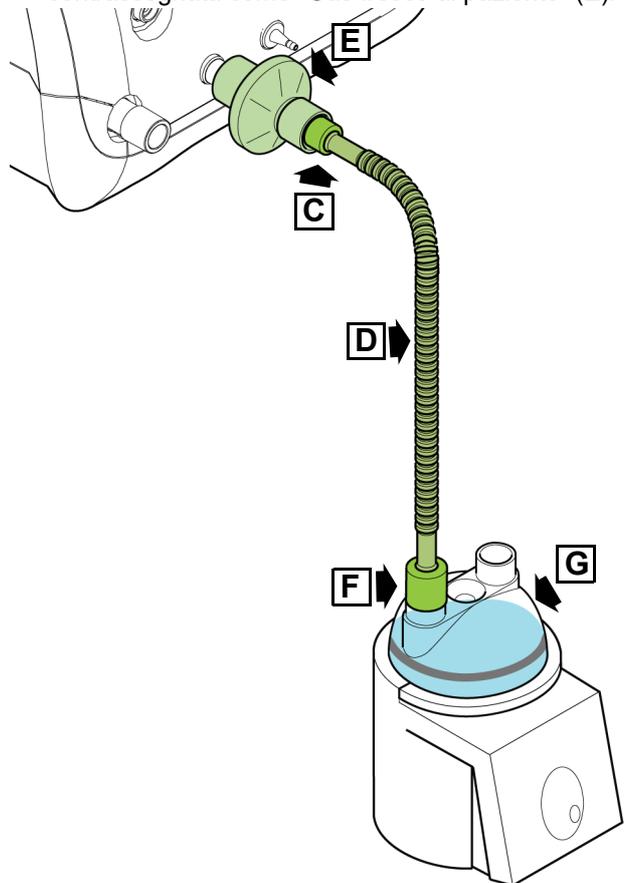


- 3 Collegare l'estremità libera (F) della linea di alimentazione del gas fresco (D) a una delle porte della camera di umidificazione (G).

- 4 Scollegare la sezione inspiratoria (H) dal circuito nella porta della sonda di temperatura.

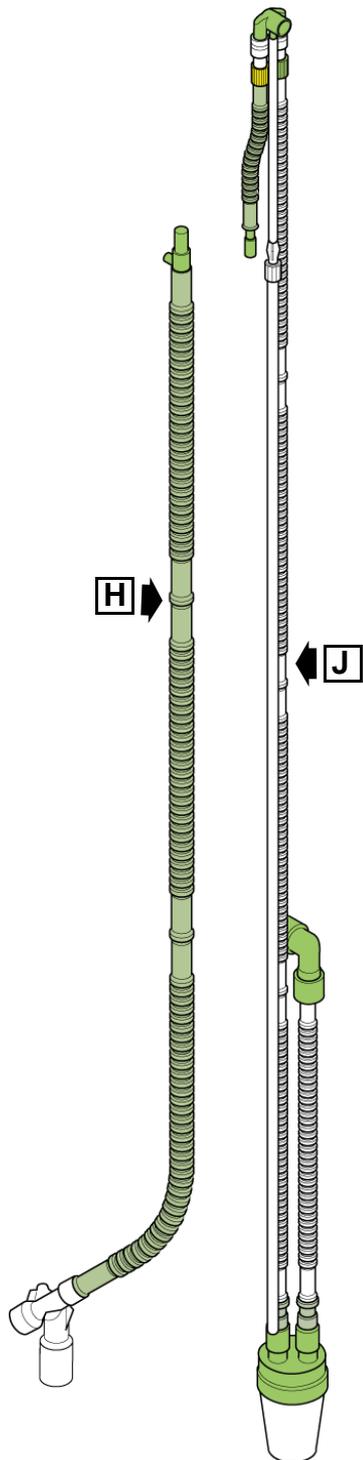


- 5 Rimettere la parte rimanente del circuito (J) di nuovo nella confezione originale.

- 6 Collegare la sezione riscaldata (H) alla porta libera della camera di umidificazione (G).

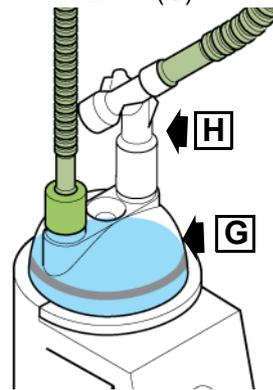


12.6.3 Montaggio delle sonde di temperatura


- 7 Collegare le sonde di temperatura dell'umidificatore alle porte (K e L).

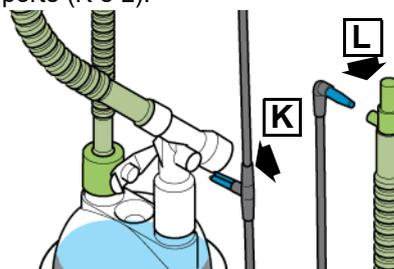


- 8 Assicurarsi che il fermo (M) sia posizionato sulla sonda di temperatura per garantire l'orientamento corretto.



- 9 Collegare il cavo del riscaldatore umidificatore (N) alla porta sulla sezione inspiratoria riscaldata (H).

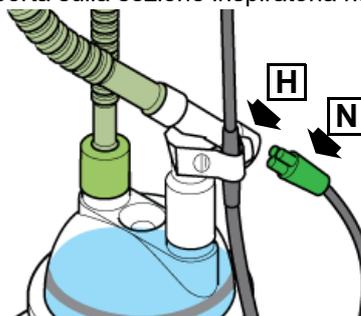

- 10 Collegare il cavo del riscaldatore (O) e le sonde di temperatura (P) all'umidificatore.

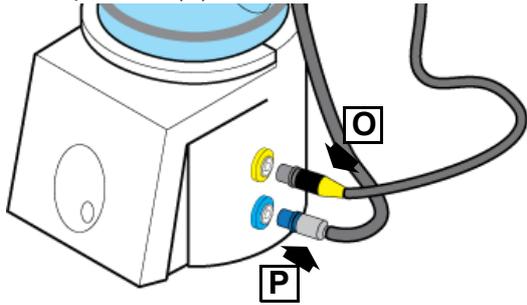


Attenzione: selezionare la cannula nasale della misura corretta, il diametro esterno della cannula nasale deve essere di circa la metà del diametro delle narici del neonato.

12.6.4 Montaggio di una cannula nasale per terapia con ossigeno.

Nota: l'utente dovrà utilizzare l'adattatore del circuito paziente N4318 (R) per terapia O2 per collegare la cannula al circuito paziente.

- 11 Rimuoverlo (Q) dalla confezione.
12 Collegare la cannula alla sezione inspiratoria (H) del circuito paziente utilizzando l'adattatore (R).

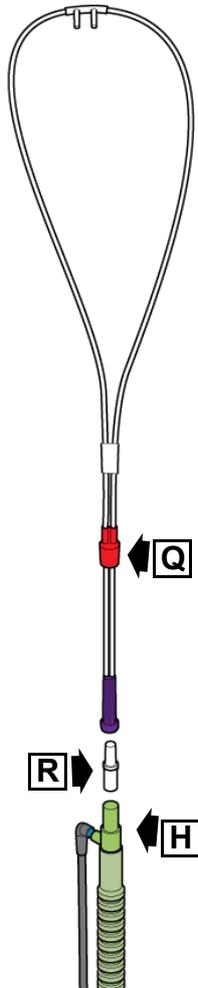

Nota: l'applicazione della cannula non è descritta in questo manuale. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con la cannula.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Ventilazione - Invasiva

“CPAP” a pagina 66



“CMV” a pagina 68



“PTV” a pagina 70



“PSV” a pagina 72



“SIMV” a pagina 74



“HFOV” a pagina 76



“HFOV+CMV” a pagina 78



13. Ventilazione - Invasiva

13.1 CPAP



Tipo di modalità: invasiva. Prima e dopo il collegamento, è responsabilità dell'utente regolare e monitorare i parametri di ventilazione.

<p>Parametri addizionali Attivi per 120 secondi con la modalità selezionata.</p>	<p>Supporto Apnea Tenere premuto il controllo per 2 secondi per passare da On a Off. Premere per confermare. (Predefinito 40 BPM se On).</p>	<p>Fronte di salita Altera la forma dell'onda di pressione.</p>		<p>Sensibilità del trigger Il funzionamento del controllo Sensibilità del trigger è modificato quando non ci sono sensori di flusso connessi. L'unità di sensibilità passa da l/min a percentuale (%). L'impostazione predefinita viene modificata da 0,6 l/min a 50%.</p>	
<p>Parametri addizionali</p>	<p>FR di backup Off 1 BPM 150</p>	<p>Fronte di salita 0.04 0.0 Secondi 3.0</p>		<p>Sens trigger 0.6 0.2 l/min 20.0</p>	
<p>Manuale Respiro</p>	<p>Ti (T insp) 0.40 0.1 Secondi 3.0</p>		<p>CPAP 4.0 0.0 mbar 35.0</p>	<p>PIP 15 0 mbar 65</p>	
<p>Respiro manuale</p>	<p>Ti (T insp) Tempo inspiratorio Il tempo inspiratorio in secondi.</p>		<p>CPAP Pressione positiva continua delle vie aeree in mbar.</p>	<p>PIP Massima pressione inspiratoria in mbar. Per respiri manuali e di backup.</p>	<p>O2 Concentrazione di ossigeno fornita al paziente.</p>
<p>Funzione alternativa Pausa.</p>	<p>Controlli interattivi A. Il controllo Ti non può essere aumentato oltre la frequenza di Supporto Apnea. B. Il controllo di Supporto Apnea non può essere incrementato oltre il Ti consentito. C. Il fronte di salita non può essere incrementato oltre la Ti impostata.</p>		<p>Controlli interattivi Il controllo CPAP non può essere aumentato oltre la PIP impostata. La PIP non può essere ridotta al di sotto della CPAP impostata.</p>		<p>Funzione alternativa Aumento O2 Aspirazione O2</p>  <p>+</p>  <p>Auto O2</p>

Nota. I valori in alto sono mostrati in base alle impostazioni predefinite di fabbrica.

CPAP soglie di allarme predefinite	Vte Soglie minime e massime impostate. (Soglie invisibili) Nome allarme Alto: Volume corrente oltre la soglia superiore Nome allarme Basso: Volume corrente al di sotto la soglia inferiore.	Vmin Soglie minime e massime impostate. (Soglie invisibili) Nome allarme Alto: Volume minuto oltre la soglia superiore Nome allarme Basso: Volume minuto al di sotto della soglia inferiore.	RR Soglia massima impostata. (Soglie invisibili) Nome allarme: BPM troppo alta.	Apnea Limite tempo massimo impostato per Apnea. Può essere impostato su Off (Vedere avvertenza in basso) (Soglie invisibili) Nome allarme: Periodo tra le azioni ventilatorie oltre i limiti di apnea.	 O2% Soglia massima impostata. (Soglie invisibili) Nome allarme: O2 oltre il limite impostato.	Perdita Imposta la soglia di perdita percentuale massima. (Soglie invisibili) Nome allarme: Elevata perdita al paziente.
	Vte (ml) <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 5px;">↑↓</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">30,0</div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">7,0</div> <div style="margin-top: 5px;">↑↓</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">00,0</div> </div>	Vmin (l) <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">18,00</div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">0,25</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">00,0</div> </div>	RR (BPM) <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">100</div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">0</div> </div>	O2 (%) <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">60</div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">21</div> </div>	Perdita (%) <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">35</div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">0</div> </div>	
			Apnea (secondi) <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">15</div> </div>			
	PIP (mbar) <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 5px;">↑↓</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">20</div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">15,0</div> <div style="margin-top: 5px;">↑↓</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">11</div> </div>	CPAP (mbar) <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">7,0</div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">4,0</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">1</div> </div>	etCO2 (mmHg) <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">50</div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">--</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">20</div> </div>	SpO2 (%) <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">99</div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">--</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">88</div> </div>	PR (min) <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">180</div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">--</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;">100</div> </div>	
Avvertenza: ventilazione con allarme di apnea "OFF" Quando l'allarme di apnea è impostato su "OFF", l'utente deve usare un metodo alternativo per la rilevazione degli episodi di apnea.	PIP Soglie minime e massime impostate. Nome allarme Alto: PIP troppo alta (Soglia visibile) Nome allarme Basso: PIP troppo bassa (Soglia invisibile).	CPAP Soglie minime e massime impostate. Nome allarme Alto: PEEP troppo alta (Soglia invisibile) Nome allarme Basso: Pressione sotto la soglia bassa (Soglia visibile).	 etCO2 Imposta le soglie etCO2 minime e massime. Attive solo con il modulo etCO2 collegato.	 SpO2 Imposta le soglie SpO2 minime e massime. Attive solo con il modulo SpO2 collegato.	 PR Imposta le soglie di pulsazioni minime e massime. Attive solo quando il modulo SpO2 è collegato.	

13.2 CMV



Tipo di modalità: invasiva.

Prima e dopo il collegamento, è responsabilità dell'utente regolare e monitorare i parametri di ventilazione.

<p>Parametri addizionali Attivi per 120 secondi con la modalità selezionata.</p>							
		<p>Fronte di salita Altera la forma dell'onda di pressione.</p>					
<p>Parametri addizionali</p>			<p>Fronte di salita 0.04 0.0 Secondi 3.0</p>				
<p>Manuale Respiro</p>	<p>RR 30 1 BPM 150</p>	<p>Ti (T insp) 0.40 0.1 Secondi 3.0</p>	<p>PEEP 4.0 0.0 mbar 35.0</p>	<p>PIP 15 0 mbar 65</p>	<p>VTV Off 2.0 ml 300.0</p>	<p>O2 21 21 % 100</p>	
<p>Respiro manuale</p>	<p>RR Frequenza respiratoria in respiri al minuto.</p>	<p>Ti (T insp) Tempo inspiratorio Il tempo inspiratorio in secondi.</p>	<p>PEEP Pressione positiva di fine espirazione in mbar.</p>	<p>PIP Massima pressione inspiratoria in mbar. Per respiri manuali e di backup.</p>	<p>VTV Tenere premuto il controllo per 2 secondi per passare da On a Off. Premere per confermare.</p>	<p>O2 Concentrazione di ossigeno fornita al paziente.</p>	
<p>Funzione alternativa Pausa.</p>	<p>Controlli interattivi A. Il controllo Ti non può essere aumentato oltre la frequenza di Supporto Apnea. B. Il controllo di Supporto Apnea non può essere incrementato oltre il Ti consentito. C. Il fronte di salita non può essere incrementato oltre la Ti impostata.</p>		<p>PIP MAX Quando è attiva la VTV il controllo diventa PIP MAX. Da utilizzare per impostare la PIP massima consentita.</p>			<p>Funzione alternativa Aumento O2 Aspirazione O2</p>	
			<p>Controlli interattivi Il controllo PEEP non può essere aumentato oltre la PIP impostata. La PIP non può essere ridotta al di sotto della PEEP impostata.</p>			 +  Auto O2	

Nota. I valori in alto sono mostrati in base alle impostazioni predefinite di fabbrica.

**CMV
soglie
di allarme
predefinite**

Vte
Soglie minime
e massime
impostate.
(Soglie invisibili)
Nome allarme Alto:
Volume corrente
oltre la soglia
superiore
Nome allarme
Basso:
Volume corrente al
di sotto della soglia
inferiore.

Vmin
Soglie minime
e massime
impostate.
(Soglie invisibili)
Nome allarme Alto:
Volume minuto
oltre la soglia
superiore
Nome allarme
Basso:
Volume minuto al di
sotto della soglia
inferiore.



O2%
Soglia massima
impostata.
(Soglie invisibili)
Nome allarme:
O2 oltre il limite
impostato.

Perdita
Imposta la soglia di
perdita percentuale
massima.
(Soglie invisibili)
Nome allarme:
Elevata perdita al
paziente.

	Vte (ml)	Vmin (l)	O2 (%)	Perdita (%)
	30,0	18,00	60	35
	7,0	0,25	21	0
	00,0	00,0		

	PIP (mbar)	PEEP (mbar)	etCO2 (mmHg)	SpO2 (%)	PR (min)
	20	7,0	50	99	180
	15,0	4,0	--	--	--
	11	1	20	88	100

PIP
Soglie minime
e massime
impostate.
Nome allarme Alto:
PIP troppo alta
(Soglia visibile)
Nome allarme
Basso:
PIP troppo bassa
(Soglia invisibile).

PEEP
Soglie minime
e massime
impostate.
Nome allarme Alto:
PEEP troppo alta
(Soglia invisibile)
Nome allarme
Basso:
Pressione sotto
la soglia bassa
(Soglia visibile).



etCO2
Imposta le soglie
etCO2 minime
e massime.
Attive solo con
il modulo etCO2
collegato.



SpO2
Imposta le soglie
SpO2 minime
e massime. Attive
solo con il modulo
SpO2 collegato.



PR
Imposta le soglie
di pulsazioni
minime e massime.
Attive solo quando
il modulo SpO2
è collegato.

13.3 PTV



Tipo di modalità: invasiva.

Prima e dopo il collegamento, è responsabilità dell'utente regolare e monitorare i parametri di ventilazione.

<p>Parametri addizionali Attivi per 120 secondi con la modalità selezionata.</p>							
		<p>Fronte di salita Altera la forma dell'onda di pressione.</p>					<p>Sensibilità del trigger Il funzionamento del controllo Sensibilità del trigger è modificato quando non ci sono sensori di flusso connessi. L'unità di sensibilità passa da l/min a percentuale (%). L'impostazione predefinita viene modificata da 0,6 l/min a 50%.</p>
<p>Parametri addizionali</p>	<p>Fronte di salita 0.04 0.0 Secondi 3.0</p>		<p>Sens trigger 0.6 0.2 l/min 20.0</p>				
<p>Manuale Respiro</p>	<p>RR 30 1 BPM 150</p>	<p>Ti (T insp) 0.40 0.1 Secondi 3.0</p>	<p>PEEP 4.0 0.0 mbar 35.0</p>	<p>PIP 15 0 mbar 65</p>	<p>VTV Off 2.0 ml 300.0</p>	<p>O2 21 21 % 100</p>	
<p>Respiro manuale</p>	<p>RR Frequenza respiratoria in respiri al minuto.</p>	<p>Ti (T insp) Tempo inspiratorio Il tempo inspiratorio in secondi.</p>	<p>PEEP Pressione positiva espiratoria finale in mbar.</p>	<p>PIP Massima pressione inspiratoria in mbar. Per respiri manuali e di backup.</p>	<p>VTV Tenere premuto il controllo per 2 secondi per passare da On a Off. Premere per confermare.</p>	<p>O2 Concentrazione di ossigeno fornita al paziente.</p>	
<p>Funzione alternativa Pausa.</p>	<p>Controlli interattivi A. Il controllo Ti non può essere aumentato oltre la frequenza di Supporto Apnea. B. Il controllo di Supporto Apnea non può essere incrementato oltre il Ti consentito. C. Il fronte di salita non può essere incrementato oltre la Ti impostata.</p>		<p>Controlli interattivi Il controllo PEEP non può essere aumentato oltre la PIP impostata. La PIP non può essere ridotta al di sotto della PEEP impostata.</p>		<p>PIP MAX Quando è attiva la VTV il controllo diventa PIP MAX. Da utilizzare per impostare la PIP massima consentita.</p>	<p>Funzione alternativa Aumento O2 Aspirazione O2</p>  <p>+</p>  <p>Auto O2</p>	

Nota. I valori in alto sono mostrati in base alle impostazioni predefinite di fabbrica.

PTV soglie di allarme predefinite	Vte	Vmin	RR	 O2% Soglia massima impostata. (Soglie invisibili) Nome allarme: O2 oltre il limite impostato.	Perdita Imposta la soglia di perdita percentuale massima. (Soglie invisibili) Nome allarme: Elevata perdita al paziente.
	Soglie minime e massime impostate. (Soglie invisibili) Nome allarme Alto: Volume corrente oltre la soglia superiore Nome allarme Basso: Volume corrente al di sotto la soglia inferiore.	Soglie minime e massime impostate. (Soglie invisibili) Nome allarme Alto: Volume minuto oltre la soglia superiore Nome allarme Basso: Volume minuto al di sotto della soglia inferiore.	Apnea Limite tempo massimo impostato per Apnea. Impostato su Off come predefinito (Vedere avvertenza in basso) (Soglie invisibili) Nome allarme: Periodo tra le azioni ventilatorie oltre i limiti di apnea.		
	Vte (ml)	Vmin (l)	RR (BPM)	O2 (%)	Perdita (%)
	30,0	18,00	100	60	35
	7,0	0,25	0	21	0
	00,0	00,0			
			Apnea (secondi)		
			OFF		
	PIP (mbar)	PEEP (mbar)	etCO2 (mmHg)	SpO2 (%)	PR (min)
	20	7,0	50	99	180
	15,0	4,0	--	--	--
	11	1	20	88	100
Avvertenza: ventilazione con allarme di apnea "OFF" Avvertenza: quando l'allarme di apnea è impostato su "OFF", l'utente deve usare un metodo alternativo per la rilevazione degli episodi di apnea	PIP	PEEP	 etCO2	 SpO2	 PR
	Soglie minime e massime impostate. Nome allarme Alto: PIP troppo alta (Soglia visibile) Nome allarme Basso: PIP troppo bassa (Soglia invisibile).	Soglie minime e massime impostate. Nome allarme Alto: PEEP troppo alta (Soglia invisibile) Nome allarme Basso: Pressione sotto la soglia bassa (Soglia visibile).	Imposta le soglie etCO2 minime e massime. Attive solo con il modulo etCO2 collegato.	Imposta le soglie SpO2 minime e massime. Attive solo con il modulo SpO2 collegato.	Imposta le soglie di pulsazioni minime e massime. Attive solo quando il modulo SpO2 è collegato.

13.4 PSV



Tipo di modalità: invasiva.

Prima e dopo il collegamento, è responsabilità dell'utente regolare e monitorare i parametri di ventilazione.

<p>Parametri addizionali Attivi per 120 secondi con la modalità selezionata.</p>		<p>Fronte di salita Altera la forma dell'onda di pressione.</p>		<p>Sensibilità del trigger Il funzionamento del controllo Sensibilità del trigger è modificato quando non ci sono sensori di flusso connessi. L'unità di sensibilità passa da l/min a percentuale (%). L'impostazione predefinita viene modificata da 0,6 l/min a 50%.</p>	<p>Sensibilità fine flusso Imposta la sensibilità di fine flusso per il respiro paziente.</p>	
<p>Parametri addizionali</p>		<p>Fronte di salita 0.04 0.0 3.0 Secondi</p>		<p>Sens trigger 0.6 0.2 20.0 l/min</p>	<p>Sens trigger 5 5 % 50</p>	
<p>Manuale Respiro</p>	<p>RR 30 1 150 BPM</p>	<p>Ti Max 0.40 0.1 3.0 Secondi</p>	<p>PEEP 4.0 0.0 35.0 mbar</p>	<p>PIP 15 0 65 mbar</p>	<p>VTV Off 2.0 300.0 ml</p>	<p>O2 21 21 % 100</p>
<p>Respiro manuale</p>	<p>RR Frequenza respiratoria in respiri al minuto.</p>	<p>Ti Max Tempo inspiratorio Il tempo inspiratorio in secondi.</p>	<p>PEEP Pressione positiva espiratoria finale in mbar.</p>	<p>PIP Massima pressione inspiratoria in mbar. Per respiri manuali e di backup.</p>	<p>VTV Tenere premuto il controllo per 2 secondi per passare da On a Off. Premere per confermare.</p>	<p>O2 Concentrazione di ossigeno fornita al paziente.</p>
<p>Funzione alternativa Pausa.</p>	<p>Controlli interattivi A. Il controllo Ti non può essere aumentato oltre la frequenza di Supporto Apnea. B. Il controllo di Supporto Apnea non può essere incrementato oltre il Ti consentito. C. Il fronte di salita non può essere incrementato oltre la Ti impostata.</p>		<p>Controlli interattivi Il controllo PEEP non può essere aumentato oltre la PIP impostata. La PIP non può essere ridotta al di sotto della PEEP impostata.</p>	<p>PIP MAX Quando è attiva la VTV il controllo diventa PIP MAX. Da utilizzare per impostare la PIP massima consentita.</p>	<p>VTV prefissata Quando è attiva la VTV il controllo diventa VTV prefissata. Utilizzarla per impostare il volume prefissato.</p>	<p>Funzione alternativa Aumento O2 Aspirazione O2</p>  <p>+</p>  <p>Auto O2</p>

Nota. I valori in alto sono mostrati in base alle impostazioni predefinite di fabbrica.

PSV soglie di allarme predefinite	Vte Soglie minime e massime impostate. (Soglie invisibili) Nome allarme Alto: Volume corrente oltre la soglia superiore Nome allarme Basso: Volume corrente al di sotto della soglia inferiore.	Vmin Soglie minime e massime impostate. (Soglie invisibili) Nome allarme Alto: Volume minuto oltre la soglia superiore Nome allarme Basso: Volume minuto al di sotto della soglia inferiore.	RR Soglia massima impostata. (Soglie invisibili) Nome allarme: BPM troppo alta	Apnea Limite tempo massimo impostato per Apnea. Impostato su Off come predefinito (Vedere avvertenza in basso) (Soglie invisibili) Nome allarme: Periodo tra le azioni ventilatorie oltre i limiti di apnea.	O2% Soglia massima impostata. (Soglie invisibili) Nome allarme: O2 oltre il limite impostato.	Perdita Imposta la soglia di perdita percentuale massima. (Soglie invisibili) Nome allarme: Elevata perdita al paziente.
	Vte (ml)	Vmin (l)	RR (BPM)	O2 (%)	Perdita (%)	
	30,0	18,00	100	60	35	
	7,0	0,25	0	21	0	
	00,0	00,0				
			Apnea (secondi)			
			OFF			
	PIP (mbar)	PEEP (mbar)	etCO2 (mmHg)	SpO2 (%)	PR (min)	
	20	7,0	50	99	180	
	15,0	4,0	--	--	--	
	11	1	20	88	100	
Avvertenza: ventilazione con allarme di apnea "OFF" Avvertenza: quando l'allarme di apnea è impostato su "OFF", l'utente deve usare un metodo alternativo per la rilevazione degli episodi di apnea	PIP Soglie minime e massime impostate. Nome allarme Alto: PIP troppo alta (Soglia visibile) Nome allarme Basso: PIP troppo bassa (Soglia invisibile).	PEEP Soglie minime e massime impostate. Nome allarme Alto: PEEP troppo alta (Soglia invisibile) Nome allarme Basso: Pressione sotto la soglia bassa (Soglia visibile).	 etCO2 Imposta le soglie etCO2 minime e massime. Attive solo con il modulo etCO2 collegato.	 SpO2 Imposta le soglie SpO2 minime e massime. Attive solo con il modulo SpO2 collegato.	 PR Imposta le soglie di pulsazioni minime e massime. Attive solo quando il modulo SpO2 è collegato.	

13.5 SIMV



Tipo di modalità: invasiva.

Prima e dopo il collegamento, è responsabilità dell'utente regolare e monitorare i parametri di ventilazione.

<p>Parametri addizionali Attivi per 120 secondi con la modalità selezionata.</p>		<p>Fronte di salita Altera la forma dell'onda di pressione.</p>	<p>Supporto pressorio Tenere premuto il controllo per 2 secondi per passare da On a Off. Premere per confermare. (Predefinito 8 mbar se On)</p>	<p>Sensibilità del trigger Il funzionamento del controllo Sensibilità del trigger è modificato quando non ci sono sensori di flusso connessi. L'unità di sensibilità passa da l/min a percentuale (%). L'impostazione predefinita viene modificata da 0,6 l/min a 50%.</p>	<p>Sensibilità fine flusso Imposta la sensibilità di fine flusso per il respiro paziente. Questo parametro è attivo solo quando il supporto pressorio è attivo.</p>	
<p>Parametri addizionali</p>		<p>Fronte di salita 0.04 0.0 Secondi 3.0</p>	<p>Supporto Press. Off 0 mbar 65</p>	<p>Sens trigger 0.6 0.2 l/min 20.0</p>	<p>Sens trigger 5 5 % 10</p>	
<p>Manuale Respiro</p>	<p>RR 30 1 BPM 150</p>	<p>Ti (T insp) 0.40 0.1 Secondi 3.0</p>	<p>PEEP 4.0 0.0 mbar 35.0</p>	<p>PIP 15 0 mbar 65</p>	<p>VTV Off 2.0 ml 300.0</p>	<p>O2 21 21 % 100</p>
<p>Respiro manuale</p>	<p>RR Frequenza respiratoria in respiri al minuto.</p>	<p>Ti (T insp) Tempo inspiratorio Il tempo inspiratorio in secondi.</p>	<p>PEEP Pressione positiva espiratoria finale in mbar</p>	<p>PIP Massima pressione inspiratoria in mbar. Per respiri manuali e di backup.</p>	<p>VTV Tenere premuto il controllo per 2 secondi per passare da On a Off. Premere per confermare.</p>	<p>O2 Concentrazione di ossigeno fornita al paziente.</p>
<p>Funzione alternativa Pausa inspiratoria</p>	<p>Controlli interattivi A. Il controllo Ti non può essere aumentato oltre la frequenza di Supporto Apnea. B. Il controllo di Supporto Apnea non può essere incrementato oltre il Ti consentito. C. Il fronte di salita non può essere incrementato oltre la Ti impostata</p>		<p>Controlli interattivi Il controllo PEEP non può essere aumentato oltre la PIP impostata. La PIP non può essere ridotta al di sotto della PEEP impostata.</p>	<p>PIP MAX Quando è attiva la VTV il controllo diventa PIP MAX. Da utilizzare per impostare la PIP massima consentita.</p>	<p>VTV prefissata Quando è attiva la VTV il controllo diventa VTV prefissata. Utilizzarla per impostare il volume prefissato.</p>	<p>Funzione alternativa Aumento O2 Aspirazione O2</p>  <p>+</p>  <p>Auto O2</p>

Nota. I valori in alto sono mostrati in base alle impostazioni predefinite di fabbrica.

SIMV soglie di allarme predefinite	Vte Soglie minime e massime impostate. (Soglie invisibili) Nome allarme Alto: Volume corrente oltre la soglia superiore Nome allarme Basso: Volume corrente al di sotto la soglia inferiore.	Vmin Soglie minime e massime impostate. (Soglie invisibili) Nome allarme Alto: Volume minuto oltre la soglia superiore Nome allarme Basso: Volume minuto al di sotto della soglia inferiore.	RR Soglia massima impostata. (Soglie invisibili) Nome allarme: BPM troppo alta	 O2% Soglia massima impostata. (Soglie invisibili) Nome allarme: O2 oltre il limite impostato.	Perdita Imposta la soglia di perdita percentuale massima. (Soglie invisibili) Nome allarme: Elevata perdita al paziente.
	<p>Vte (ml)</p> <p>↑ ↓</p> <p>30,0</p> <p>7,0</p> <p>00,0</p>	<p>Vmin (l)</p> <p>18,00</p> <p>0,25</p> <p>00,0</p>	<p>RR (BPM)</p> <p>100</p> <p>0</p>	<p>O2 (%)</p> <p>60</p> <p>21</p>	<p>Perdita (%)</p> <p>35</p> <p>0</p>
			<p>Apnea (secondi)</p> <p>OFF</p>		
	<p>PIP (mbar)</p> <p>↑ ↓</p> <p>20</p> <p>15,0</p> <p>11</p>	<p>PEEP (mbar)</p> <p>7,0</p> <p>4,0</p> <p>1</p>	<p>etCO2 (mmHg)</p> <p>50</p> <p>--</p> <p>20</p>	<p>SpO2 (%)</p> <p>99</p> <p>--</p> <p>88</p>	<p>PR (min)</p> <p>180</p> <p>--</p> <p>100</p>
<p>Avvertenza: ventilazione con allarme di apnea "OFF" Avvertenza: quando l'allarme di apnea è impostato su "OFF", l'utente deve usare un metodo alternativo per la rilevazione degli episodi di apnea</p>	<p>PIP Soglie minime e massime impostate. Nome allarme Alto: PIP troppo alta (Soglia visibile) Nome allarme Basso: PIP troppo bassa (Soglia invisibile).</p>	<p>PEEP Soglie minime e massime impostate. Nome allarme Alto: PEEP troppo alta (Soglia invisibile) Nome allarme Basso: Pressione sotto la soglia bassa (Soglia visibile).</p>	<p> etCO2 Imposta le soglie etCO2 minime e massime. Attive solo con il modulo etCO2 collegato.</p>	<p> SpO2 Imposta le soglie SpO2 minime e massime. Attive solo con il modulo SpO2 collegato.</p>	<p> PR Imposta le soglie di pulsazioni minime e massime. Attive solo quando il modulo SpO2 è collegato.</p>

13.6 HFOV



Tipo di modalità: invasiva. Prima e dopo il collegamento, è responsabilità dell'utente regolare e monitorare i parametri di ventilazione.

<p>Pausa di oscillazione Le oscillazioni possono essere messe in pausa per 60 secondi premendo il pulsante oscillazione in pausa. Tenere premuto il controllo per 1 secondo per passare da On a Off.</p> <p>Parametri aggiuntivi Attivi per 120 secondi con la modalità selezionata.</p>	<p>Controlli interattivi Il sigh FR non può essere aumentato oltre il limite stabilito dal tempo inspiratorio sigh impostato. Il tempo inspiratorio sigh non può essere aumentato oltre il limite impostato dal sigh FR impostato.</p> <p>Rr Respirone Tenere premuto il controllo per 2 secondi per passare da On a Off. Premere per confermare. (Predefinito 30 BPM se On). Imposta la frequenza respiratoria per i respiri sigh.</p>	<p>Per. Insp Resp Imposta il tempo inspiratorio per il respiro sigh.</p>		<p>Press. Resp. Imposta la pressione inspiratoria per il respiro sigh.</p>	<p>ΔP MAX Quando il comando VTV è ON il controllo diventa ΔP MAX. La pressione Delta massima consentita in mbar.</p>	
<p>Pausa Pausa</p> <p>Parametri aggiuntivi</p>	<p>Rr Respirone</p> 	<p>Per. Insp Resp</p> 		<p>Press. Resp.</p> 		
<p>Sigh</p>	<p>Frequenza</p> 	<p>I:E</p> 	<p>MAP</p> 	<p>DP</p> 	<p>VTV</p> 	<p>O2</p> 
<p>Per. Insp. Resp* Il controllo sigh avvierà una pausa al Per. Insp Resp impostato.</p> <p>Funzione alternativa Pausa Respirone.</p>	<p>Frequenza Frequenza HFO in Hertz (Hz).</p> <p>Controlli interattivi La Pausa Respirone utilizzerà la preferenza operatore di 5 o 10 secondi impostata per le preferenze utente.</p>	<p>I:E Rapporto tra inspirazione ed espirazione (1:1, 1:2 & 1:3)</p>	<p>MAP Pressione media vie respiratorie in mbar.</p>	<p>ΔP Pressione Delta in mbar.</p>	<p>VTV Tenere premuto il controllo per 2 secondi per passare da On a Off. Premere per confermare.</p>	<p>O2 Concentrazione di ossigeno fornita al paziente.</p>
<p>Attenzione*: con la RR Respirone impostata su Off Per. Insp resp può essere impostato ovunque tra 0,1 e 3 secondi per il respiro manuale. Quando il RR Respirone viene successivamente avviato, il Per. Insp Resp potrebbe essere incompatibile con il RR Respirone impostato. L'utente dovrà regolare il Per. Insp Resp o il RR Respirone di conseguenza.</p>			<p>Controlli interattivi MAP e Press. Resp. A. Il controllo MAP si avvierà automaticamente per aumentare la Press. Resp. quando supera il livello impostato di Press. Resp. e la Press. Resp. rintraccerà la MAP. B. Se la MAP viene diminuita la Press. Resp. rimarrà al nuovo livello. In questo caso la differenza tra MAP e Press. Resp. può essere superiore a 15 mbar. D. Il Press. Resp. può essere aumentato indipendentemente dalla MAP impostata, ma solo 15 mbar oltre la MAP impostata.</p>		<p>Vte finale Quando è attiva la VTV il controllo diventa VTV prefissata. Utilizzarla per impostare il volume prefissato.</p>	<p>Funzione alternativa Aumento O2 Aspirazione O2</p>  <p>+</p>  <p>Auto O₂</p>
<p>Nota. I valori in alto sono mostrati in base alle impostazioni predefinite di fabbrica.</p>	<p>Funzione alternativa con controlli interattivi Frequenza e VTV prefissata Tenendo premuto il controllo frequenza per 2 secondi si collegherà al controllo Vte obiettivo. Aumentando o diminuendo la frequenza HFO si regolerà automaticamente il controllo Vte prefissato.</p>					

**HFOV
soglie
di allarme
predefinite**

Vte
Soglie minime
e massime
impostate.
(Soglie invisibili)
Nome allarme Alto:
Volume corrente
oltre la soglia
superiore
Nome allarme
Basso:
Volume corrente
al di sotto la soglia
inferiore.

Vmin
Soglie minime
e massime
impostate.
(Soglie invisibili)
Nome allarme Alto:
Volume minuto
oltre la soglia
superiore
Nome allarme
Basso:
Volume minuto al
di sotto della soglia
inferiore.



O2%
Soglia massima
impostata.
(Soglie invisibili)
Nome allarme:
O2 oltre il limite
impostato.

Perdita
Imposta la soglia di
perdita percentuale
massima.
(Soglie invisibili)
Nome allarme:
Elevata perdita
al paziente

	Vte (ml)	Vmin (l)	O2 (%)	Perdita (%)
	30,0	18,00	60	35
	7,0	0,25	21	0
	00,0	00,0		
	17		99	180
	5,0	2,0	--	--
		-7	88	100

PAW alta
Soglie minime
e massime
impostate.
Nome allarme Alto:
PAW alta
(Soglia visibile).

Paw bassa
Soglie minime
e massime
impostate.
Nome allarme
Basso:
Pressione bassa
(Soglia visibile).



SpO2
Imposta le soglie
SpO2 minime
e massime. Attive
solo con il modulo
SpO2 collegato.



PR
Imposta le soglie di
pulsazioni minime
e massime. Attive
solo quando il
modulo SpO2
è collegato.

13.7 HFOV+CMV



Tipo di modalità: invasiva. Prima e dopo il collegamento, è responsabilità dell'utente regolare e monitorare i parametri di ventilazione.

Pausa di oscillazione

Le oscillazioni possono essere messe in pausa per 60 secondi premendo il pulsante oscillazione in pausa. Tenere premuto il controllo per 1 secondo per passare da On a Off.

Attività HFO

Consente la selezione di oscillazioni in fase inspiratoria ed espiratoria o solo in fase espiratoria.

Parametri addizionali

Attivi per 120 secondi con la modalità selezionata.

The diagram shows a control panel with several sections:


- Buttons:** "Pausa Pausa" and "Parametri addizionali".
- Activity HFO:** A section with a waveform icon and the label "Attività HFO".
- Parameter Controls (Gauges):**
 - RR:** Respiratory rate, 30 BPM (range 1-150).
 - Ti (T insp):** Inspiratory time, 0.40 seconds (range 0.1-3.0).
 - Frequenza:** HFO frequency, 10 Hz (range 3.0-20.0).
 - PEEP:** Positive end-expiratory pressure, 4.0 mbar (range 0.0-35.0).
 - PIP:** Maximum inspiratory pressure, 15 mbar (range 0-65).
 - ΔP:** Delta pressure, 4 mbar (range 4-180).
 - O2:** Oxygen concentration, 21% (range 21-100).
- Descriptions and Notes:**
 - RR:** Frequenza respiratoria in respiri al minuto.
 - Ti (T insp):** Tempo inspiratorio in secondi.
 - Frequenza:** Frequenza HFO in Hertz (Hz).
 - PEEP:** Pressione positiva espiratoria finale in mbar.
 - PIP:** Massima pressione inspiratoria in mbar. Per respiri manuali e di backup.
 - ΔP:** Pressione Delta in mbar.
 - O2:** Concentrazione di ossigeno fornita al paziente.
- Controlli interattivi (RR and Ti):**
 - A. Il controllo Ti non può essere aumentato oltre la frequenza di Supporto Apnea.
 - B. Il controllo di Supporto Apnea non può essere incrementato oltre il Ti consentito.
 - C. Il fronte di salita non può essere incrementato oltre la Ti impostata.
- Controlli interattivi (PEEP and PIP):**
 - Il controllo PEEP non può essere aumentato oltre la PIP impostata. La PIP non può essere ridotta al di sotto della PEEP impostata.
- Funzione alternativa:** Aumento O2, Aspirazione O2, Auto O2 (with SpO2 and OxyGene icons).

Nota. I valori in alto sono mostrati in base alle impostazioni predefinite di fabbrica.

HFOV+CMV
soglie
di allarme
predefinite



O2%
Soglia massima
impostata.
(Soglie invisibili)
Nome allarme:
O2 oltre il limite
impostato.

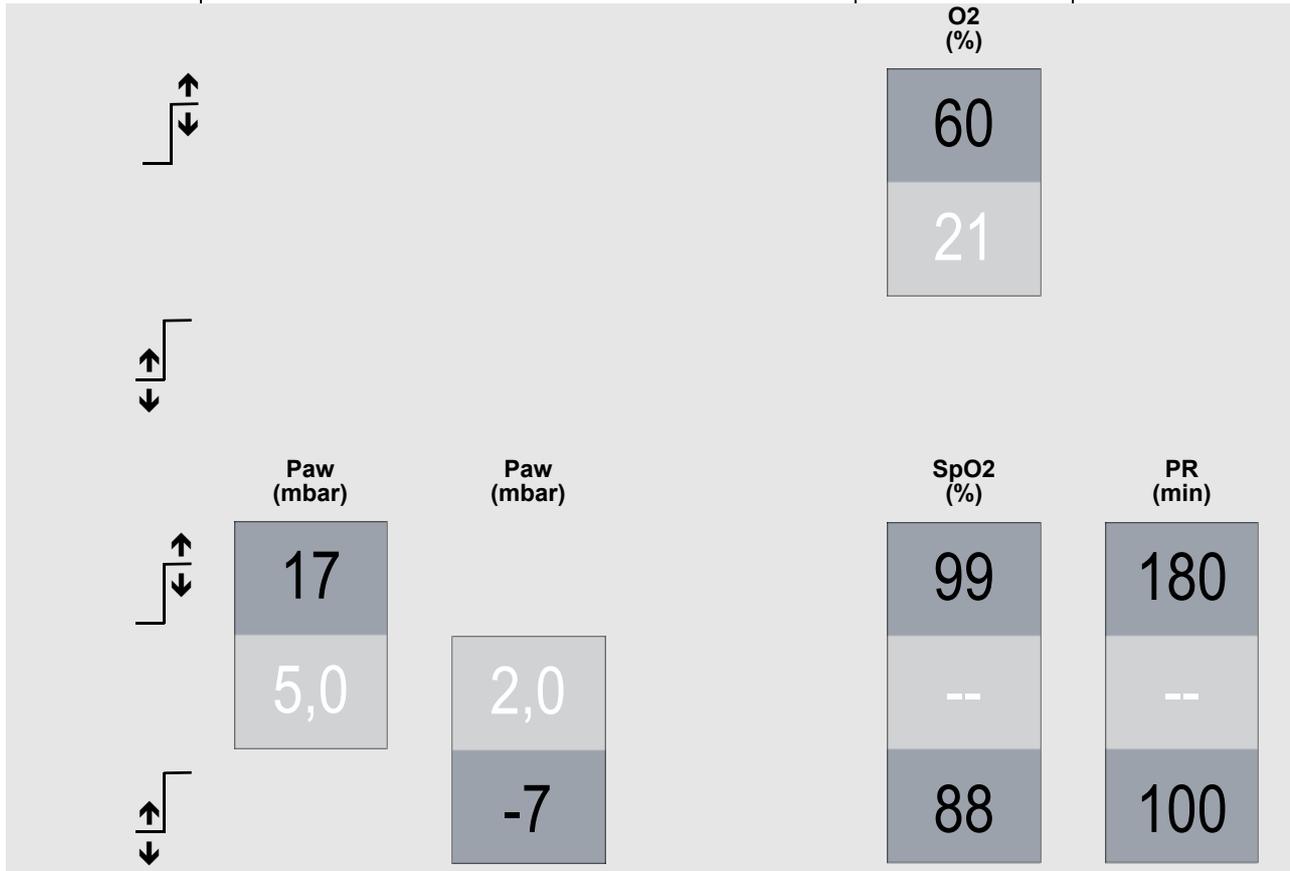

PAW alta
Soglie minime
e massime
impostate.
Nome allarme Alto:
PAW alta
(Soglia visibile).

Paw bassa
Soglie minime
e massime
impostate.
Nome allarme
Basso:
Pressione bassa
(Soglia visibile).



SpO2
Imposta le soglie
SpO2 minime
e massime. Attive
solo con il modulo
SpO2 collegato.



PR
Imposta le soglie
di pulsazioni
minime e massime.
Attive solo quando
il modulo SpO2
è collegato.

13.8 Avvertenze comuni

Avvertenza: non connettere il ventilatore al paziente durante la procedura di impostazione generale.

Avvertenza: non entrare in modalità "Attesa" quando è connesso un paziente. Non viene fornita alcuna ventilazione.

Avvertenza: l'utente dovrà assicurarsi che le soglie di allarme sono impostate ai livelli corretti in base alla condizione del paziente.

13.9 Avvisi comuni

Attenzione: le procedure di impostazione base descritte in questo capitolo consentono solo all'utente, ovvero il personale medico, di entrare in ogni modalità in modo sicuro.

È responsabilità dell'utente impostare i parametri di ventilazione sicuri. I parametri di ventilazioni illustrati in questo capitolo, sono utilizzati solo come per guidare l'utente. Se l'utente dovesse giudicarli non idonei per il paziente, dovrà selezionare quelli appropriati.

Il ventilatore potrebbe mostrare questi parametri come impostati dall'utente dalle preferenze utente.

I parametri illustrati in questo capitolo non dovranno mai ignorare la scelta da parte dell'utente delle impostazioni del ventilatore.

Attenzione: il sensore del flusso è un oggetto soggetto a manutenzione e potrebbe richiedere la pulizia durante l'uso.

13.9.1 Funzioni alternative comuni (ventilazione convenzionale)

Nota: le funzioni alternative sono selezionate solo mediante la funzione delle Preferenze operatore.

Vedere "Preferenze operatore" a pagina 132.

13.9.1.1 Respiro manuale o pausa inspiratoria

Se è stato impostato un tempo di pausa inspiratoria nelle preferenze utente, il pulsante Respiro manuale viene sostituito dal pulsante Pausa inspiratoria. Premendo il pulsante si avvia il respiro fino al tempo inspiratorio impostato. (Questo tempo massimo può essere di 5 o 10 secondi). Rilasciando il pulsante termina il respiro. La pausa inspiratoria utilizzerà la PIP impostata.

13.9.1.2 Incremento O₂ o aspirazione O₂

Se questa funzione è stata attivata, l'utente può scegliere se richiesto Incremento O₂ o Aspirazione O₂ nel controllo del parametro O₂.

13.9.2 Funzioni alternative comuni (ventilazione ad alta frequenza)

13.9.2.1 Sigh o Pausa respirone

Se è stato impostato un tempo di Pausa Respirone nelle preferenze operatore, il pulsante Pausa Respirone viene sostituito dal pulsante Pausa sigh. Premendo il pulsante si avvia il respiro Sigh fino al tempo inspiratorio impostato. (Questo tempo massimo può essere di 5 o 10 secondi). Rilasciando il pulsante termina il respiro. La pausa inspiratoria utilizzerà la Press. Resp.

13.9.2.2 Incremento O₂ o aspirazione O₂

Se questa funzione è stata attivata, l'utente può scegliere se richiesto Incremento O₂ o Aspirazione O₂ nel controllo del parametro O₂.

13.10 Ventilazione senza sensore di flusso

Se si utilizza il ventilatore senza sensore di flusso, le seguenti funzioni non saranno disponibili.

Controllo VTV

Soglie di allarme

Volume corrente (V_{te})alto e basso

Volume minuto (V_{min}).....alto e basso

Perdita (%)massima

Forme d'onda e loop

Flusso, Volume

Ventilazione - Non-invasiva

“Non-invasiva - Doppio lume”

“nCPAP D” a pagina 82



“NIPPV D” a pagina 84



“NIPPV Tr.” a pagina 86



“nHFOV” a pagina 88



“Non-invasiva - Singolo lume”

“nCPAP S” a pagina 90



“DuoPAP” a pagina 92



“cAlti Flussi” a pagina 94



14. Non-invasiva - Sezione doppia

14.1 nCPAP D

CORE
V2.0

Tipo di modalità: non-invasiva.

Prima e dopo il collegamento, è responsabilità dell'utente regolare e monitorare i parametri di ventilazione.

Circuito paziente doppio lume.

<p>Parametri addizionali Attivi per 120 secondi con la modalità selezionata.</p>	<p>Supporto Apnea Tenere premuto il controllo per 2 secondi per passare da On a Off. Premere per confermare. (Predefinito 40 BPM se On)</p>	<p>Fronte di salita Altera la forma dell'onda di pressione.</p>		<p>Sensibilità del trigger Impostare la sensibilità del trigger di respiri. La predefinita è al 50%.</p>		
<p>Parametri addizionali</p>	<p>FR di backup Off 1 BPM 150</p>	<p>Fronte di salita 0.04 0.0 Secondi 3.0</p>		<p>Sens trigger 50 1 % 100</p>		
<p>Manuale Respiro</p>	<p>Ti (T insp) 0.40 0.1 Secondi 3.0</p>		<p>CPAP 4.0 0.0 mbar 35.0</p>	<p>PIP 15 0 mbar 65</p>		<p>O2 21 21 % 100</p>
<p>Respiro manuale</p>	<p>Ti (T insp) Tempo inspiratorio Il tempo inspiratorio in secondi.</p>		<p>CPAP Pressione positiva continua delle vie respiratorie in mbar</p>	<p>PIP Massima pressione inspiratoria in mbar. Per respiri manuali e di backup.</p>		<p>O2 Concentrazione di ossigeno fornita al paziente.</p>
<p>Funzione alternativa Pausa inspiratoria</p>	<p>Controlli interattivi A. Il controllo Ti non può essere aumentato oltre la frequenza di Supporto Apnea. B. Il controllo di Supporto Apnea non può essere incrementato oltre il Ti consentito. C. Il fronte di salita non può essere incrementato oltre la Ti impostata</p>		<p>Controlli interattivi Il controllo CPAP non può essere aumentato oltre la PIP impostata. La PIP non può essere ridotta al di sotto della CPAP impostata.</p>			<p>Funzione alternativa Aumento O2 Aspirazione O2</p>  <p>+</p>  <p>Auto O2</p>

Nota. I valori in alto sono mostrati in base alle impostazioni predefinite di fabbrica.

<p>nCPAP D soglie di allarme predefinite</p>			<p>RR Soglia massima impostata. (Soglie invisibili) Nome allarme: BPM troppo alta</p>			
			<p>Apnea Limite tempo massimo impostato per Apnea. Può essere impostato su Off (Vedere avvertenza in basso) (Soglie invisibili) Nome allarme: Periodo tra le azioni ventilatorie oltre i limiti di apnea</p>	 <p>O2% Soglia massima impostata. (Soglie invisibili) Nome allarme: O2 oltre il limite impostato.</p>		
			<p>RR (BPM)</p>	<p>O2 (%)</p>		
			<p>100</p>	<p>60</p>		
			<p>0</p>	<p>21</p>		
			<p>Apnea (secondi)</p>			
			<p>15</p>			
		<p>PIP (mbar)</p>	<p>CPAP (mbar)</p>	<p>SpO2 (%)</p>	<p>PR (min)</p>	
		<p>20</p>	<p>7,0</p>	<p>99</p>	<p>180</p>	
		<p>15,0</p>	<p>4,0</p>	<p>--</p>	<p>--</p>	
		<p>11</p>	<p>1</p>	<p>88</p>	<p>100</p>	
<p>Avvertenza: ventilazione con allarme di apnea "OFF" Avvertenza: quando l'allarme di apnea è impostato su "OFF", l'utente deve usare un metodo alternativo per la rilevazione degli episodi di apnea</p>		<p>PIP Soglie minime e massime impostate. Nome allarme Alto: PIP troppo alta (Soglia visibile) Nome allarme Basso: PIP troppo bassa (Soglia invisibile)</p>	<p>CPAP Soglie minime e massime impostate. Nome allarme Alto: PEEP troppo alta (Soglia invisibile) Nome allarme Basso: Pressione sotto la soglia bassa (Soglia visibile)</p>	 <p>SpO2 Soglie SpO2 minime e massime impostate. Attive solo con il modulo SpO2 collegato.</p>	 <p>PR Soglie di pulsazioni minime e massime impostate. Attive solo quando il modulo SpO2 è collegato.</p>	

14.2 NIPPV D

CORE
V2.0

Tipo di modalità: non-invasiva.
Circuito paziente doppio lume.

Prima e dopo il collegamento, è responsabilità dell'utente regolare e monitorare i parametri di ventilazione.

<p>Parametri addizionali Attivi per 120 secondi con la modalità selezionata.</p>						<p>Fronte di salita Altera la forma dell'onda di pressione.</p>		
<p>Parametri addizionali</p>	<p>Fronte di salita 0.04 0.0 Secondi 3.0</p>							
<p>Manuale Respiro</p>	<p>RR 30 1 BPM 150</p>	<p>Ti (T insp) 0.40 0.1 Secondi 3.0</p>	<p>PEEP 4.0 0.0 mbar 35.0</p>	<p>PIP 15 0 mbar 65</p>	<p>O2 21 21 % 100</p>			
<p>Respiro manuale</p>	<p>RR Frequenza respiratoria in respiri al minuto.</p>	<p>Ti (T insp) Tempo inspiratorio Il tempo inspiratorio in secondi.</p>	<p>PEEP Pressione positiva espiratoria finale in mbar.</p>	<p>PIP Massima pressione inspiratoria in mbar. Per respiri manuali e di backup.</p>	<p>O2 Concentrazione di ossigeno fornita al paziente.</p>			
<p>Funzione alternativa Pausa inspiratoria</p>	<p>Controlli interattivi A. Il controllo Ti non può essere aumentato oltre la frequenza di Supporto Apnea. B. Il controllo di Supporto Apnea non può essere incrementato oltre il Ti consentito. C. Il fronte di salita non può essere incrementato oltre la Ti impostata</p> <p>Controlli interattivi Il controllo PEEP non può essere aumentato oltre la PIP impostata. La PIP non può essere ridotta al di sotto della PEEP impostata.</p> <p>Nota di allarme 1. L'allarme PIP bassa è disabilitato se la differenza tra la PIP e PEEP è impostata a 6mbar o meno. 2. Se la differenza tra PIP e PEEP supera gli 6 mbar si applica quanto segue a. Se RR supera 50 BPM o più l'allarme suona dopo 5 cicli del ventilatore. b. Se FF supera 50 BPM l'allarme suonerebbe dopo 2 cicli di ventilatori.</p>					<p>Funzione alternativa Aumento O2 Aspirazione O2</p> <p> +</p> <p> Auto O2</p>		

Nota. I valori in alto sono mostrati in base alle impostazioni predefinite di fabbrica.

**NIPPV Dop
soglie
di allarme
predefinite**



O2%
Soglia massima
impostata.
(Soglie invisibili)
Nome allarme:
O2 oltre il limite
impostato.

	PIP (mbar)	PEEP (mbar)	SpO2 (%)	PR (min)
	20	7,0	99	180
	15,0	4,0	--	--
	11	1	88	100
	<p>PIP Soglie minime e massime impostate. Nome allarme Alto: PIP troppo alta (Soglia visibile) Nome allarme Basso: PIP troppo bassa (Soglia invisibile)</p>	<p>PEEP Soglie minime e massime impostate. Nome allarme Alto: PEEP troppo alta (Soglia invisibile) Nome allarme Basso: Pressione sotto la soglia bassa (Soglia visibile)</p>	 <p>SpO2 Soglie SpO2 minime e massime impostate. Attive solo con il modulo SpO2 collegato.</p>	 <p>PR Soglie di pulsazioni minime e massime impostate. Attive solo quando il modulo SpO2 è collegato.</p>

14.3 NIPPV Tr.



Tipo di modalità: non-invasiva.
Circuito paziente doppio lume.

Prima e dopo il collegamento, è responsabilità dell'utente regolare e monitorare i parametri di ventilazione.

<p>Parametri addizionali Attivi per 120 secondi con la modalità selezionata.</p>						<p>Fronte di salita Altera la forma dell'onda di pressione.</p>						<p>Sensibilità del trigger Impostare la sensibilità del trigger di respiri. La predefinita è al 50%.</p>
<p>Parametri addizionali</p>						<p>Fronte di salita 0.04 0.0 3.0 Secondi</p>						<p>Sens trigger 50 1 % 100</p>
<p>Manuale Respiro</p>	<p>RR 30 1 BPM 150</p>	<p>Ti (T insp) 0.40 0.1 3.0 Secondi</p>	<p>PEEP 4.0 0.0 mbar 35.0</p>	<p>PIP 15 0 mbar 65</p>	<p>O2 21 21 % 100</p>							
<p>Respiro manuale</p>	<p>RR Frequenza respiratoria in respiri al minuto.</p>	<p>Ti (T insp) Tempo inspiratorio Il tempo inspiratorio in secondi.</p>	<p>PEEP Pressione positiva espiratoria finale in mbar</p>	<p>PIP Massima pressione inspiratoria in mbar. Per respiri manuali e di backup.</p>	<p>O2 Concentrazione di ossigeno fornita al paziente.</p>							
<p>Funzione alternativa Pausa inspiratoria</p>	<p>Controlli interattivi A. Il controllo Ti non può essere aumentato oltre la frequenza di Supporto Apnea. B. Il controllo di Supporto Apnea non può essere incrementato oltre il Ti consentito. C. Il fronte di salita non può essere incrementato oltre la Ti impostata</p>		<p>Controlli interattivi Il controllo PEEP non può essere aumentato oltre la PIP impostata. La PIP non può essere ridotta al di sotto della PEEP impostata. Nota di allarme 1. L'allarme PIP bassa è disabilitato se la differenza tra la PIP e PEEP è impostata a 6mbar o meno. 2. Se la differenza tra PIP e PEEP supera gli 6 mbar si applica quanto segue a. Se RR supera 50 BPM o più l'allarme suona dopo 5 cicli del ventilatore. b. Se FF supera 50 BPM l'allarme suonerebbe dopo 2 cicli di ventilatori.</p>		<p>Funzione alternativa Aumento O2 Aspirazione O2</p>  <p>+</p>  <p>Auto O2</p>							

Nota. I valori in alto sono mostrati in base alle impostazioni predefinite di fabbrica.


**NIPPV Tr.
soglie
di allarme
predefinite**

RR
Soglia massima
impostata.
(Soglie invisibili)
Nome allarme:
BPM troppo alta

Apnea
Limite tempo
massimo impostato
per Apnea.
Impostato su Off
come predefinito
(Vedere avvertenza
in basso) (Soglie
invisibili)
Nome allarme:
Periodo tra le
azioni ventilatorie
oltre i limiti di
apnea.



O2%
Soglia massima
impostata.
(Soglie invisibili)
Nome allarme:
O2 oltre il limite
impostato.

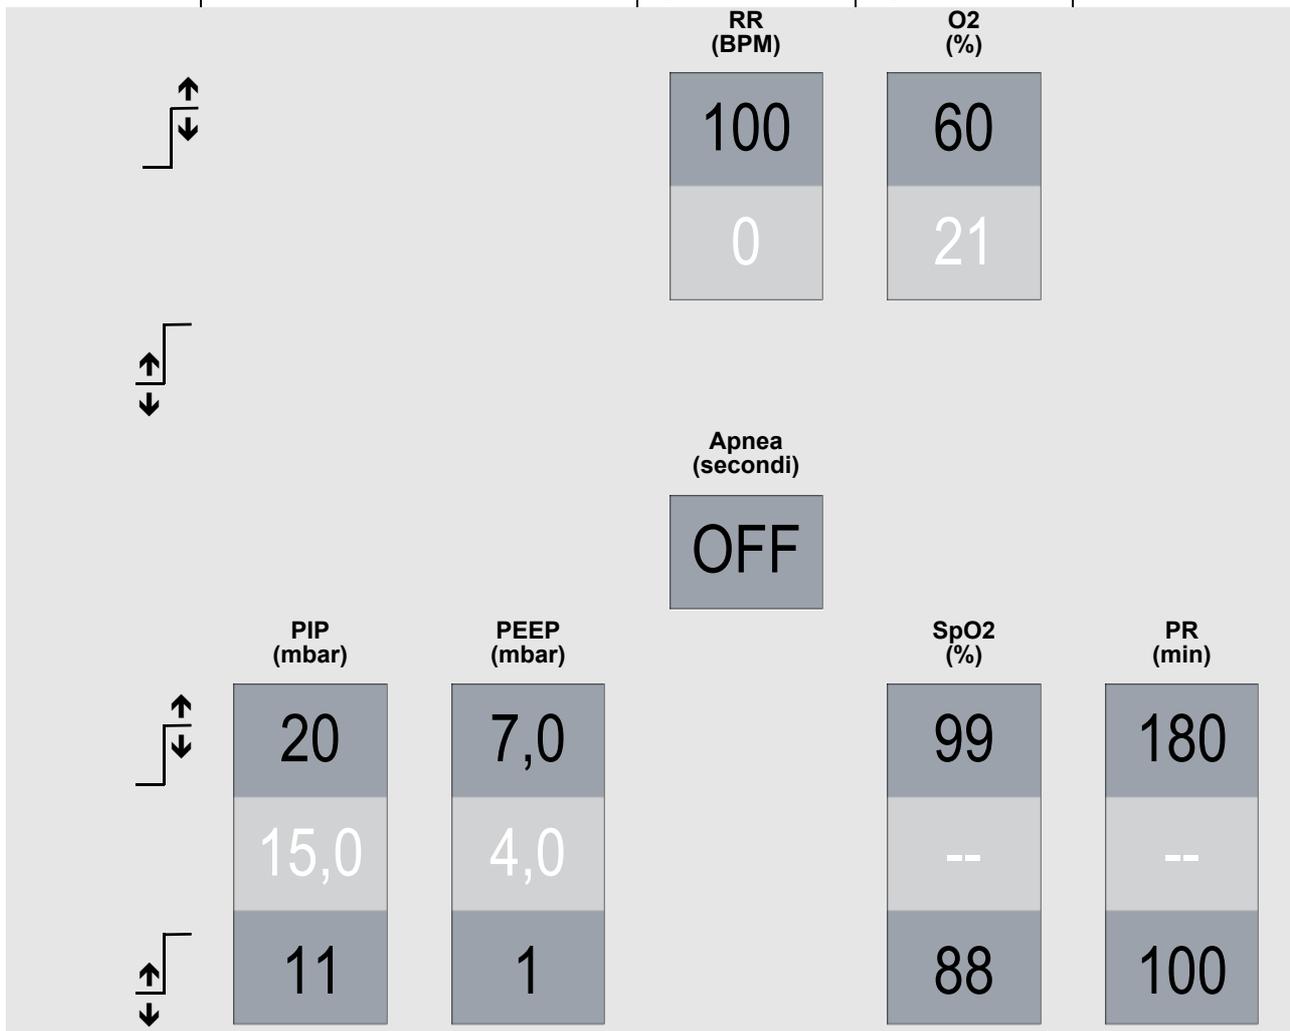

Avvertenza:
ventilazione
con allarme di
apnea "OFF"
Avvertenza:
quando
l'allarme di
apnea è
impostato su
"OFF", l'utente
deve usare un
metodo
alternativo per
la rilevazione
degli episodi di
apnea

PIP
Soglie minime
e massime
impostate.
Nome allarme Alto:
PIP troppo alta
(Soglia visibile)
Nome allarme
Basso:
PIP troppo bassa
(Soglia invisibile)

PEEP
Soglie minime
e massime
impostate.
Nome allarme Alto:
PEEP troppo alta
(Soglia invisibile)
Nome allarme
Basso:
Pressione sotto la
soglia bassa
(Soglia visibile)



SpO2
Soglie SpO2
minime e massime
impostate. Attive
solo con il modulo
SpO2 collegato.



PR
Soglie di pulsazioni
minime e massime
impostate. Attive
solo quando il
modulo SpO2 è
collegato.

14.4 nHFOV




Tipo di modalità: non-invasiva. Prima e dopo il collegamento, è responsabilità dell'utente regolare Circuito paziente doppio lume. e monitorare i parametri di ventilazione.

<p>Pausa di oscillazione Le oscillazioni possono essere messe in pausa per 60 secondi premendo il pulsante oscillazione in pausa. Tenere premuto il controllo per 1 secondo per passare da On a Off.</p>	<p>Controlli interattivi Il sigh FR non può essere aumentato oltre il limite stabilito dal tempo inspiratorio sigh impostato. Il tempo inspiratorio sigh non può essere aumentato oltre il limite impostato dal sigh FR impostato.</p>		<p>Press. Resp. Imposta la pressione inspiratoria per il respiro sigh.</p>	
<p>Parametri aggiuntivi Attivi per 120 secondi con la modalità selezionata.</p>	<p>Rr Respirone Tenere premuto il controllo per 2 secondi per passare da On a Off. Premere per confermare. (Predefinito 30 BPM se On). Imposta la frequenza respiratoria per i respiri sigh.</p>	<p>Per. Insp Resp Imposta il tempo inspiratorio per il respiro sigh.</p>		
<p>Pausa di oscillazione</p>	<p>Rr Respirone Off 1 BPM 150</p>	<p>Per. Insp Resp 0.40 0.1 3.0 Secondi</p>	<p>Press. Resp. 10 0 45 mbar</p>	
<p>Parametri aggiuntivi</p>	<p>Frequenza 10.0 3.0 20.0 Hz</p>	<p>I:E 1:1 1 Rapporto 3</p>	<p>MAP 5 0 45 mbar</p>	
<p>Sigh</p>	<p>Frequenza Frequenza HFO in Hertz (Hz)</p>	<p>I:E Rapporto tra inspirazione ed espirazione (1:1, 1:2 & 1:3)</p>	<p>MAP Pressione media vie respiratorie in mbar</p>	
<p>Per. Insp. Resp* Il controllo sigh avvierà una pausa al Per. Insp Resp impostato. Funzione alternativa Pausa Respirone</p>	<p>Controlli interattivi La Pausa Respirone utilizzerà la preferenza operatore di 5 o 10 secondi impostata per le preferenze utente.</p>		<p>ΔP Pressione Delta in mbar.</p>	
<p>Attenzione*: con la RR Respirone impostata su Off il Per. Insp Resp può essere impostato ovunque tra 0,1 e 3 secondi per il Sigh manuale. Quando il RR Respirone viene successivamente avviato, il Per. Insp Resp potrebbe essere incompatibile con il RR Respirone impostato. L'utente dovrà regolare il Per. Insp Resp o il RR Respirone di conseguenza.</p>				<p>O2 21 21 % 100</p>
<p>Nota. I valori in alto sono mostrati in base alle impostazioni predefinite di fabbrica.</p>				<p>O2 Concentrazione di ossigeno fornita al paziente.</p> <p>Funzione alternativa Aumento O2 Aspirazione O2</p>  <p>+</p>  <p>Auto O2</p>
<p>Controlli interattivi MAP e Press. Resp. A. Il controllo MAP si avvierà automaticamente per aumentare la Press. Resp. quando supera il livello impostato di Press. Resp. e la Press. Resp. rintraccerà la MAP. B. Se la MAP viene diminuita la Press. Resp. rimarrà al nuovo livello. In questo caso la differenza tra MAP e Press. Resp. può essere superiore a 15 mbar. C. La Press. Resp. non può essere ridotta al di sotto della MAP impostata. D. La Press. Resp. può essere aumentata indipendentemente dalla MAP impostata, ma solo 15 mbar oltre la MAP impostata.</p>				

nHFOV
soglie
di allarme
predefinite



O2%
Soglia massima
impostata.
(Soglie invisibili)
Nome allarme:
O2 oltre il limite
impostato.

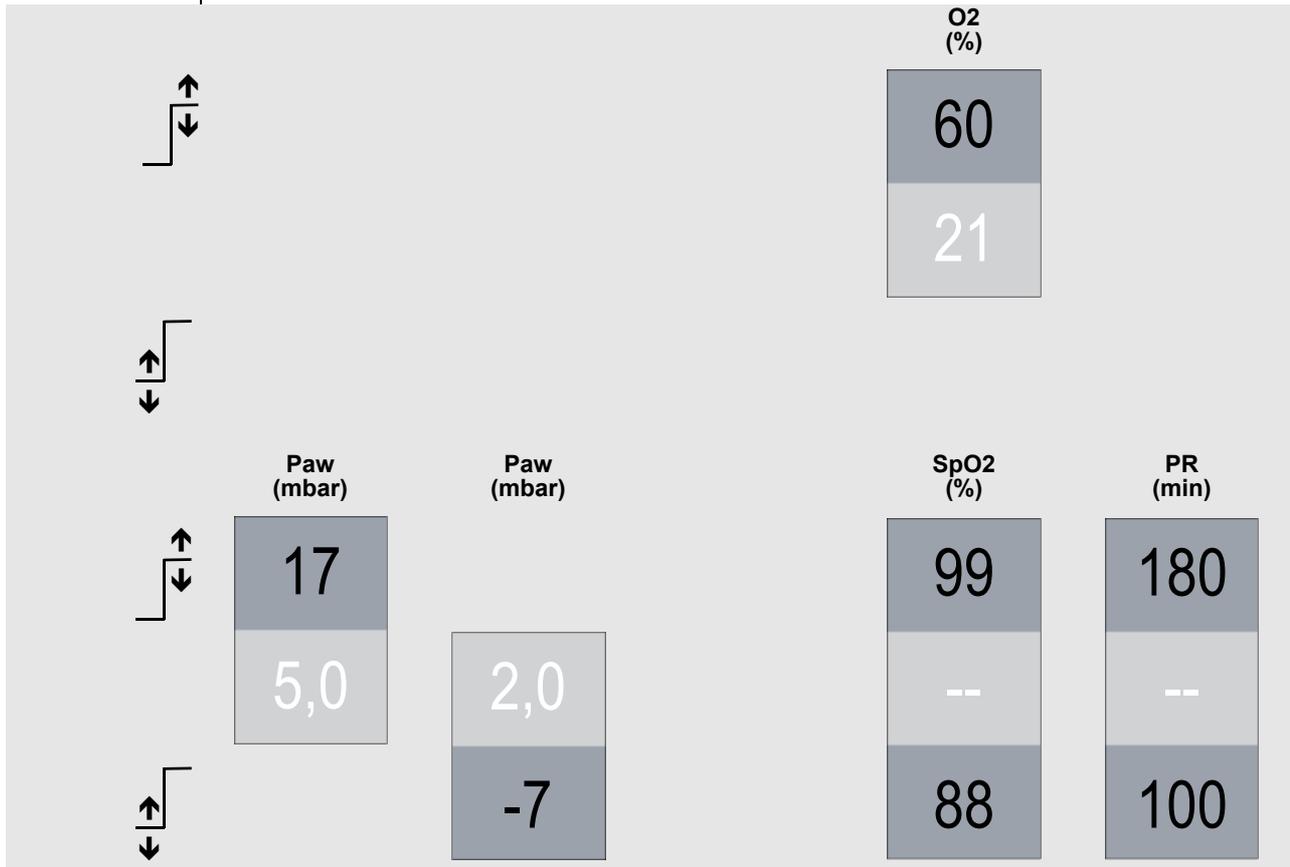

PAW alta
Soglie minime
e massime
impostate.
Nome allarme Alto:
PAW alta
(Soglia visibile)

Paw bassa
Soglie minime
e massime
impostate.
Nome allarme
Basso:
Pressione bassa
(Soglia visibile)



SpO2
Soglie SpO2
minime e massime
impostate. Attive
solo con il modulo
SpO2 collegato.



PR
Soglie di pulsazioni
minime e massime
impostate. Attive
solo quando il
modulo SpO2
è collegato.




15. Non-invasiva - Singolo lume

15.1 nCPAP S

Tipo modalità: non invasiva
Circuito paziente singolo lume.

Prima e dopo il collegamento, è responsabilità dell'utente regolare e monitorare i parametri di ventilazione.

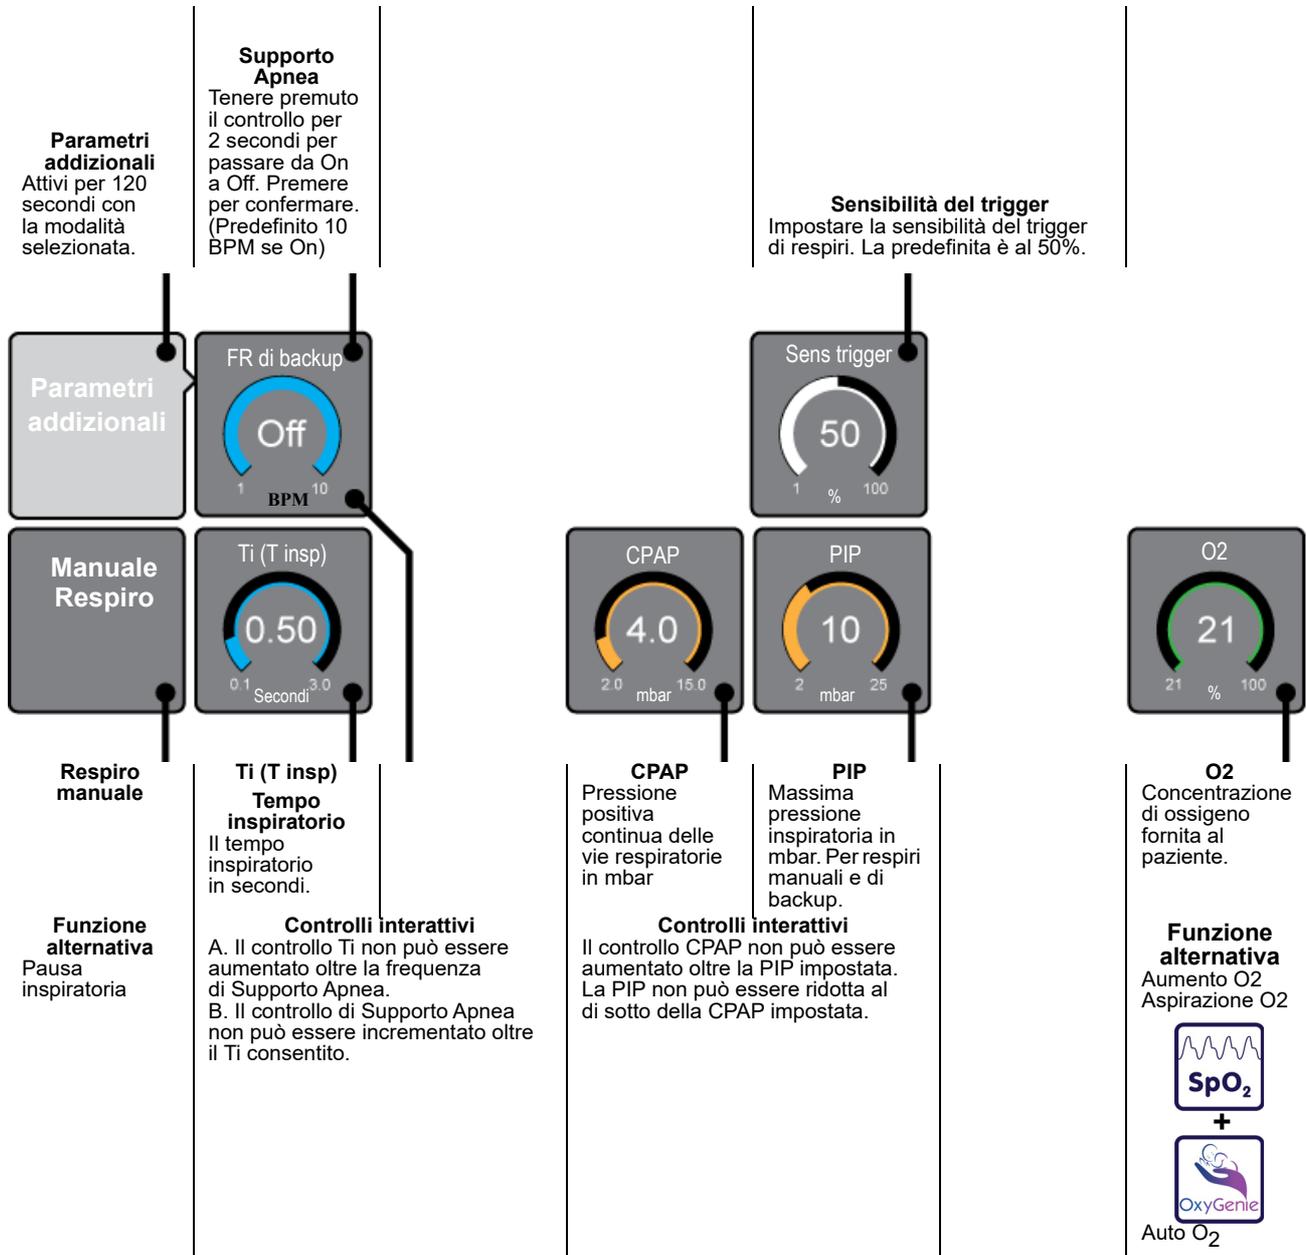

Avvertenza: quando si utilizzano cannule nasali piccole o extra piccole durante la CPAP, il ventilatore potrebbe non dare l'allarme se si verifica una disconnessione del paziente. Si raccomanda che i respiri di backup siano sempre accesi, in quanto in questo modo si ottengono respiri di riserva e si avverte l'utente di una condizione di PIP bassa se le cannule nasali si staccano. Solo il monitoraggio della SpO₂ o dell'ossigeno e dell'anidride carbonica transcutanei avviserà in modo affidabile l'equipe medica della disconnessione del paziente.

Nota. I valori in alto sono mostrati in base alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Nota: l'applicazione delle cannule/maschera non è descritta in questo manuale. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il generatore nCPAP.


<p>nCPAP Sin soglie di allarme predefinite</p>			<p>RR Soglia massima impostata. (Soglie invisibili) Nome allarme: BPM troppo alta</p>		
			<p>Apnea Limite tempo massimo impostato per Apnea. Può essere impostato su Off (Vedere avvertenza in basso) (Soglie invisibili) Nome allarme: Periodo tra le azioni ventilatorie oltre i limiti di apnea</p>	 O2% Soglia massima impostata. (Soglie invisibili) Nome allarme: O2 oltre il limite impostato.	
   	<p>PIP (mbar)</p> <p>15</p> <p>15,0</p> <p>8</p>	<p>CPAP (mbar)</p> <p>9</p> <p>4,0</p> <p>1</p>	<p>RR (BPM)</p> <p>100</p> <p>0</p> <p>Apnea (secondi)</p> <p>15</p>	<p>O2 (%)</p> <p>60</p> <p>21</p> <p>SpO2 (%)</p> <p>99</p> <p>--</p> <p>88</p>	<p>PR (min)</p> <p>180</p> <p>--</p> <p>100</p>
<p>Avvertenza: ventilazione con allarme di apnea "OFF" Avvertenza: quando l'allarme di apnea è impostato su "OFF", l'utente deve usare un metodo alternativo per la rilevazione degli episodi di apnea</p>	<p>PIP Soglie minime e massime impostate. Nome allarme Alto: PIP troppo alta (Soglia visibile) Nome allarme Basso: PIP troppo bassa (Soglia invisibile)</p>	<p>CPAP Soglie minime e massime impostate. Nome allarme Alto: PEEP troppo alta (Soglia invisibile) Nome allarme Basso: Pressione sotto la soglia bassa (Soglia visibile)</p>		 SpO2 Soglie SpO2 minime e massime impostate. Attive solo con il modulo SpO2 collegato.	 PR Soglie di pulsazioni minime e massime impostate. Attive solo quando il modulo SpO2 è collegato.

15.2 DuoPAP



Tipo di modalità: non-invasiva.
Circuito paziente singolo lume.

Prima e dopo il collegamento, è responsabilità dell'utente regolare e monitorare i parametri di ventilazione.

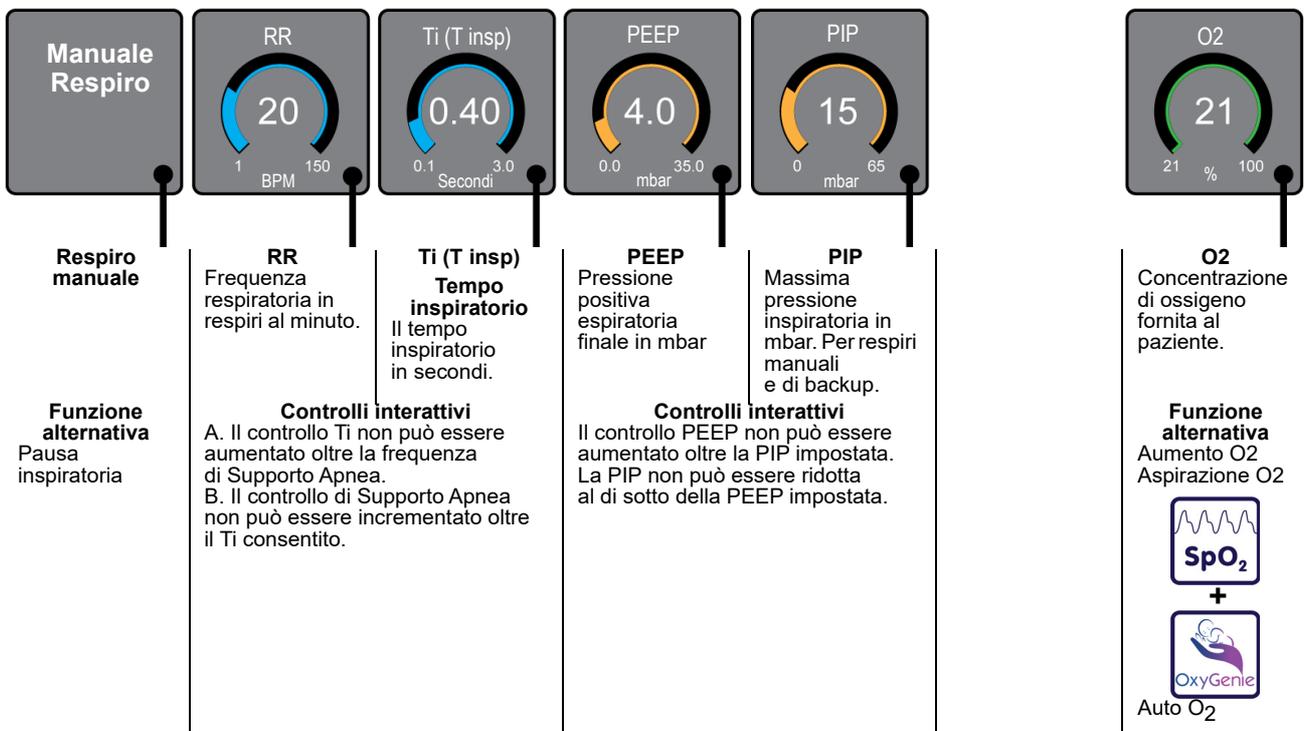


Nota. I valori in alto sono mostrati in base alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Nota: l'applicazione delle cannule/maschera non è descritta in questo manuale. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il generatore nCPAP.

DuoPAP
soglie
di allarme
predefinite



O2%
Soglia massima
impostata.
(Soglie invisibili)
Nome allarme:
O2 oltre il limite
impostato.

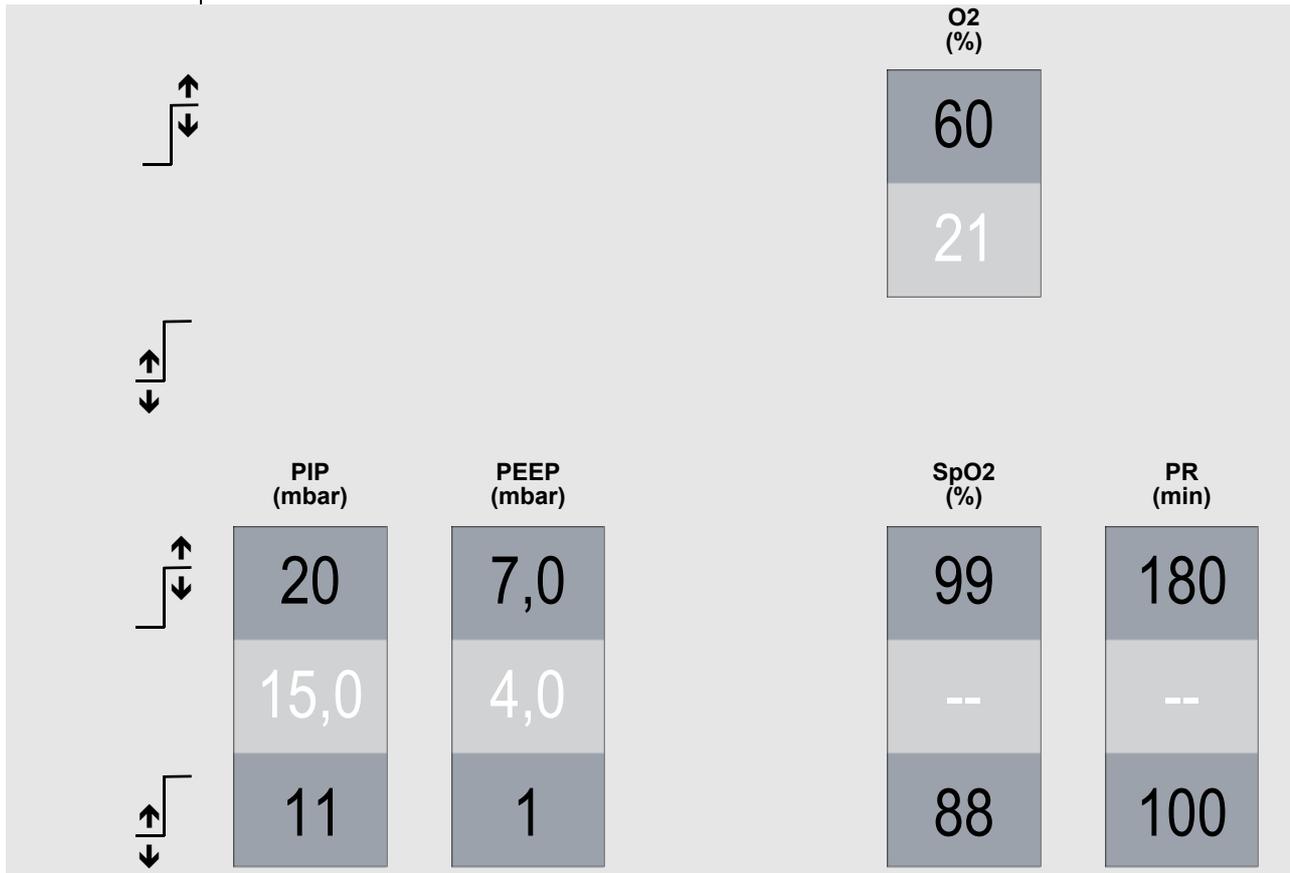

PIP
Soglie minime
e massime
impostate.
Nome allarme Alto:
PIP troppo alta
(Soglia visibile)
Nome allarme
Basso:
PIP troppo bassa
(Soglia invisibile)

PEEP
Soglie minime
e massime
impostate.
Nome allarme Alto:
PEEP troppo alta
(Soglia invisibile)
Nome allarme
Basso:
Pressione sotto
la soglia bassa
(Soglia visibile)



SpO2
Soglie SpO2
minime e massime
impostate. Attive
solo con il modulo
SpO2 collegato.




PR
Soglie di pulsazioni
minime e massime
impostate. Attive
solo quando il
modulo SpO2
è collegato.

15.3 cAlti Flussi



Tipo di modalità: non invasiva.
Circuito paziente a singolo lume.

Prima e dopo il collegamento, è responsabilità dell'utente regolare e monitorare i parametri di ventilazione.

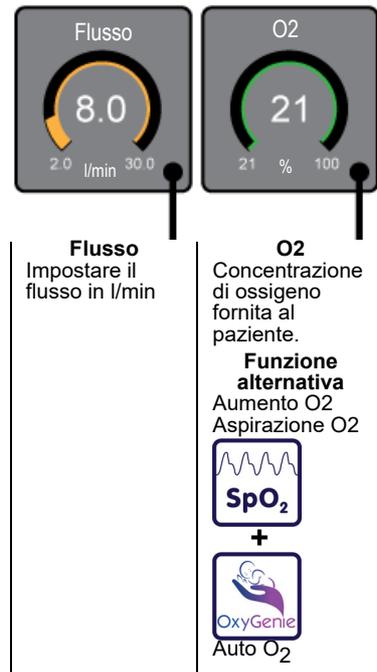

Nota. I valori in alto sono mostrati in base alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Nota: alti flussi non ha soglie di allarmi quando utilizzata senza il modulo SpO₂

Nota: la modalità Alti Flussi mostra l'andamento O₂ (%) per impostazione predefinita.

Nota: l'andamento O₂ (%) non mostrerà nessuna lettura durante la routine automatica di calibrazione dell'ossigeno.

**Alti Flussi
soglie
di allarme
predefinite**



O2%
Soglia massima
impostata.
(Soglie invisibili)
Nome allarme:
O2 oltre il limite
impostato.

	O2 (%)	
	60	
	21	
	SpO2 (%)	PR (min)
	99	180
	--	--
	88	100



SpO2
Soglie SpO2
minime e massime
impostate. Attive
solo con il modulo
SpO2 collegato.



PR
Soglie di pulsazioni
minime e massime
impostate. Attive
solo quando il
modulo SpO2
è collegato.

15.4 Avvertenze comuni

Avvertenza: non connettere il ventilatore al paziente durante la procedura di impostazione generale.

Avvertenza: non entrare in modalità "Attesa" quando è connesso un paziente. Non viene fornita alcuna ventilazione.

Avvertenza: l'utente dovrà assicurarsi che le soglie di allarme sono impostate ai livelli corretti in base alla condizione del paziente.

15.5 Avvisi comuni

Attenzione.Le procedure di impostazione base descritte in questo capitolo consentono solo all'utente, ovvero il personale medico, di entrare in ogni modalità in modo sicuro.

È responsabilità dell'utente impostare i parametri di ventilazione sicuri. I parametri di ventilazioni illustrati in questo capitolo, sono utilizzati solo come per guidare l'utente. Se l'utente dovesse giudicarli non idonei per il paziente, dovrà selezionare quelli appropriati.

Il ventilatore potrebbe mostrare questi parametri come impostati dall'utente dalle preferenze utente.

I parametri illustrati in questo capitolo non dovranno mai ignorare la scelta da parte dell'utente delle impostazioni del ventilatore.

15.6 Nota comune

Nota: tutte le modalità non invasive sono utilizzate senza sensore di flusso. Se il sensore di flusso è collegato, scollegarlo prima dell'impostazione.

Monitoraggio SpO₂ ed etCO₂

“Monitoraggio SpO₂ (Masimo SET)” a pagina 98



“Monitoraggio EtCO₂ (MicroPod™)” a pagina 104



16. Monitoraggio SpO₂ ed etCO₂

16.1 Monitoraggio SpO₂ (Masimo SET)



Il pulsossimetro viene azionato esclusivamente da, o sotto la supervisione di personale qualificato. Il manuale, gli accessori, le indicazioni per l'uso, tutte le informazioni precauzionali e le specifiche devono essere lette prima dell'uso.

16.1.1 Principio di funzionamento

Il pulsossimetro Masimo SET® è basato su tre principi:

1. Emoglobina e deossiemoglobina differiscono nell'assorbimento di luce rossa e infrarossa (spettrofotometria).
2. Il volume del sangue arterioso nel tessuto e la luce assorbita dalle variazioni del sangue durante le pulsazioni (pletismografia).
3. Lo shunting artero-venoso è altamente variabile e l'assorbanza fluttuante da parte del sangue venoso è la componente principale del rumore durante la pulsazione.

Il pulsossimetro Masimo SET oltre ad essere un tradizionale pulsossimetro determina la SpO₂ facendo passare luce rossa e infrarossa in un letto capillare e misurando le variazioni dell'assorbimento della luce durante il ciclo pulsatile. I diodi a emissione di luce rossa e infrarossa (LED) presenti nei sensori per ossimetria fungono da sorgenti luminose; un fotodiode funge da fotorilevatore.

La pulsossimetria tradizionale presuppone che tutte le pulsazioni presenti nel segnale di assorbanza della luce siano provocate da oscillazioni del volume di sangue arterioso. Questo presuppone che il flusso ematico nella regione del sensore passi interamente attraverso il letto capillare anziché attraverso eventuali shunt artero-venosi. La pulsossimetria tradizionale calcola il rapporto fra assorbanza pulsatile (CA) e assorbanza media (CC) in ciascuna delle due lunghezze d'onda, 660 nm e 905 nm:

$$S(660) = CA(660)/CC(660)$$

$$S(905) = CA(905)/CC(905)$$

L'ossimetro calcola poi il rapporto di questi due segnali di assorbanza con aggiunta di pulsazioni arteriose:

$$R = S(660)/S(905)$$

Tale valore R viene utilizzato per trovare la SpO₂ della saturazione in una tabella di consultazione incorporata nel software dell'ossimetro. I valori riportati nella tabella di consultazione si basano su studi ematici su soggetti umani con un CO-ossimetro da laboratorio condotti su volontari adulti sani in studi sull'ipossia indotta.

Il pulsossimetro Masimo SET presuppone che lo shunting artero-venoso sia altamente variabile e che l'assorbanza fluttuante da parte del sangue venoso sia la componente principale del rumore durante la pulsazione. Decompone S(660) e S(905) in un segnale arterioso oltre a una componente di rumore e calcola il rapporto dei segnali arteriosi senza il rumore:

$$S(660) = S1 + N1$$

$$S(905) = S2 + N2$$

$$R = S1/S2$$

Anche in questo caso, R corrisponde al rapporto di due segnali di assorbanza con aggiunta di pulsazioni arteriose e il suo valore viene utilizzato per trovare la SpO₂ della saturazione in un'equazione di derivazione empirica nel software dell'ossimetro. I valori dell'equazione di derivazione empirica si basano su studi ematici su soggetti umani con un COossimetro di laboratorio condotti su volontari adulti sani in studi sull'ipossia indotta.


Le equazioni sopra riportate vengono combinate fra loro e viene determinato un riferimento per il rumore (N')

$$N' = S(660) - S(905) \times R$$

In assenza di rumore N' = 0: quindi S(660) = S(905) x R vale a dire lo stesso rapporto del pulsossimetro tradizionale.

L'equazione per il riferimento del rumore si basa sul valore di R, il valore che viene cercato per determinare la SpO₂. Il software analizza i possibili valori di R che corrispondono a valori di SpO₂ compresi tra l'1% e il 100% e genera un valore N' per ciascuno di questi valori di R.


I segnali S(660) e S(905) vengono elaborati con ogni possibile riferimento di rumore N' attraverso un soppressore adattativo di correlazione (ACC) che produce una potenza di uscita per ogni possibile valore di R (cioè ogni possibile SpO₂ dall'1% al 100%). Il risultato è un grafico DST™ (Discrete Saturation Transform) della potenza di uscita relativa rispetto al possibile valore di SpO₂ come mostrato nella figura seguente, dove R corrisponde a SpO₂ = 97%:

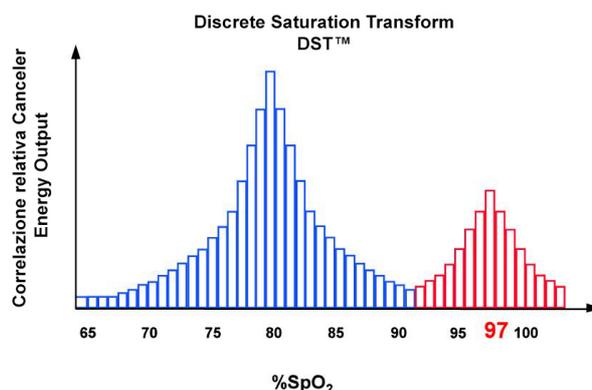

16.2 Collegamento Masimo SET®

16.2.1 Collegamento al ventilatore

Inserire il connettore a spina Medi del cavo dell'ossimetro nella presa SpO₂ sul retro del ventilatore. (presa rossa).

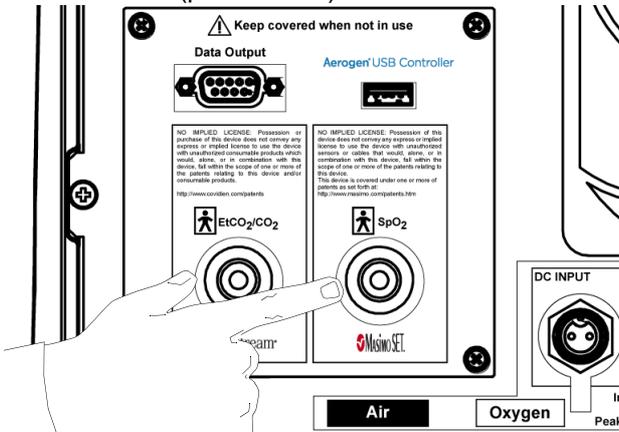

16.2.2 Disconnessione

Il cavo del sensore può essere scollegato in qualsiasi momento.

La funzione di monitoraggio può essere spenta prima o dopo la disconnessione nel pannello del sensore oppure l'utente può premere il pulsante "Continua senza SpO₂" nella barra dei messaggi di allarme.

16.2.3 Selezione dei sensori Masimo SET®

Il ventilatore è attualmente progettato per essere utilizzato con i seguenti 3 sensori.

Masimo NeoPt-3
SLE P/N°: LSP02/2321

Masimo Neo-3
SLE P/N°: LSP02/2320

Masimo Inf-3
SLE P/N°: LSP02/2319

Masimo Pdtx-3
Disponibile solo presso Masimo Corp.

Attenzione. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con i sensori per la selezione della grandezza e l'applicazione.

16.2.4 Siti di applicazione del sensore

Selezione del sito

Scegliere sempre un sito che è ben perfuso e che coprirà completamente la finestra di rilevamento del sensore. Il sito deve essere libero da detriti e asciutto prima del posizionamento del sensore.

Sensori NeoPt-3 Preterm

< 1 kg Il sito prescelto è il piede. In alternativa, può essere utilizzato sul palmo o il retro della mano.

Sensori Neo-3 neonatali/adulti

< 3 kg Il sito prescelto è il piede. In alternativa, può essere utilizzato sul palmo o il retro della mano.
> 40 kg Il sito prescelto è quello medio o l'anulare della mano non dominante.

Sensori infantili Inf-3

3-20 kg Il sito prescelto è l'alluce. In alternativa, è possibile usare il dito accanto all'alluce o al pollice.


Pdtx-3 Pediatrico

10-50 kg Il sito prescelto è quello medio o l'anulare della mano non dominante.


Attenzione: l'uso previsto del ventilatore è per i neonati prematuri con un peso superiore a 300 gr, neonati e bambini a termine, oltre che pazienti pediatriche fino a 30 kg in base alla condizione.

16.2.5 Collegamento di un sensore

Inserire fermamente il connettore del sensore a 9 pin nell'attacco della presa a 9 pin del cavo dell'ossimetro.

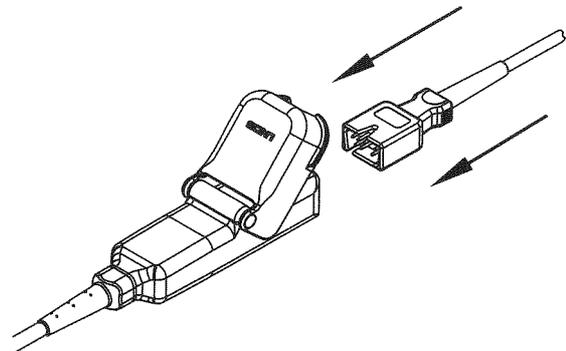

Ruotare il chiavistello libero sul connettore accoppiato fin quando non scatta in posizione.

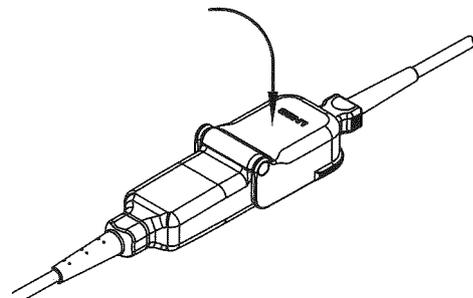


16.2.6 Disconnessione

Per scollegare il sensore, invertire i passaggi.

16.3 Configurazione

Selezionare il pannello strumenti, questo mostrerà la scheda del sensore, quindi selezionare il pulsante SpO₂.

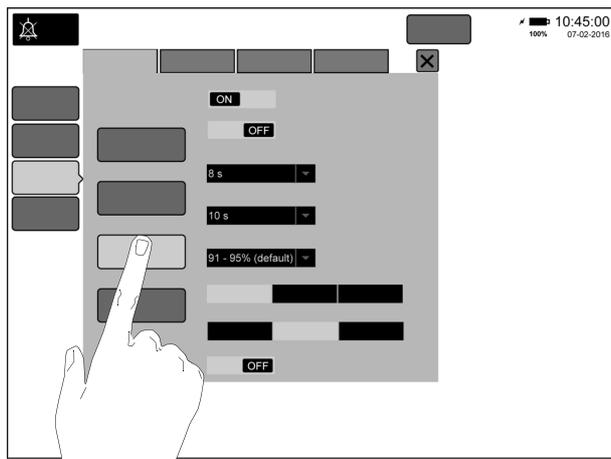

16.3.1 ON/OFF monitoraggio SpO₂

Questo pulsante consente di accendere o spegnere la funzione di monitoraggio SpO₂.

Nota: in questo modo non si spegne il sensore. Se OFF, il valore SpO₂ mostrato, l'andamento e gli allarmi associati sono disabilitati.

16.3.2 FastSat™

FastSat™ consente una risposta rapida e mostra le modifiche rapide in SpO₂ dando priorità ai dati più recenti.

Attenzione. FastSat™ non è consigliato per l'uso abituale dal momento che potrebbe esserci un incremento della frequenza di allarmi causata da modifiche SpO₂ rapide e transitorie.

16.3.3 Tempo medio

La funzione media selezionabile dall'utente consente al medico di selezionare il livello desiderato di visibilità in piccole variazioni nel valore misurato.

- *2-4 secondi
- 4-6 secondi
- 8 (predefinito) secondi
- 10 secondi
- 12 secondi
- 14 secondi
- 16 secondi.

*Il tempo medio è fissato a 2-4 secondi quando OxyGenie® è attivo.

16.3.4 Ritardo allarmi

- Impostazioni selezionabili dall'utente (secondi):
- 0
 - 5
 - 10 (predefinito)
 - 15

16.3.5 Auto O2: limiti di allarme intervallo stabilito SpO₂

Questa opzione consente all'utente di preselezionare uno dei quattro limiti di allarme alto e basso di intervalli stabiliti predefiniti per OxyGenie®.

- 90-94%
- 91-95% (Predefinito1)
- 92-96%
- 94-98%

Per il monitoraggio SpO₂ normale i limiti di allarme sono impostati al 99%² per alto e 88%² per il basso.

¹Il predefinito può essere impostato dall'utente in uno dei quattro intervalli mediante le preferenze operatore. Vedere "Scheda Parametri" a pagina 266.

²I valori alti e bassi predefiniti possono essere utilizzati mediante le preferenze impostate dall'operatore. Vedere "Scheda Allarmi" a pagina 267.

16.3.6 Sensibilità SpO₂

L'impostazione della modalità di sensibilità consente al medico di adattare la sensibilità della misurazione SpO₂ al livello del paziente della forza del segnale SpO₂ e qualità nel sito di misurazione.

Sensibilità normale è quella consigliata per i pazienti che devono fare un compromesso tra il flusso di sangue o la perfusione. È consigliabile per le aree terapeutiche in cui i pazienti sono sotto osservazione, come le unità di terapia intensiva (TI).

APOD (Adaptive Probe Off Detection) La sensibilità APOD è la modalità di sensibilità consigliata in cui esiste un'elevata probabilità di distacco del sensore. Si tratta inoltre della modalità consigliata per la terapia intensiva in cui i pazienti non sono continuamente monitorati. Questa modalità fornisce una protezione avanzata contro la frequenza pulsazioni errata e le letture di saturazione di ossigeno quando un sensore si stacca inavvertitamente da un paziente a causa di uno spostamento eccessivo.

Massima sensibilità (MAX) è consigliata per l'uso sui pazienti con segnali deboli (ad es. alto livello di rumore ambientale e/o pazienti con bassissima perfusione) e per l'uso durante le procedure o quando il contatto con medico e paziente è continuo come nelle impostazioni di maggiore acuita.

16.3.7 Desaturazione rapida

L'Allarme desaturazione rapida è un'impostazione selezionabile dall'utente per consentire al medico di dire al monitor di ignorare il ritardo di allarme sonoro quando il valore SpO₂ supera la soglia del limite di allarme da una % selezionabile dall'utente

Impostazioni selezionabili dall'utente:

5% (predefinita)

10%

Off

16.3.8 Indice perf.

Questo pulsante accenderà o spegnerà la funzione Indice perfusione nella finestra della forma d'onda. L'Indice perfusione è un valore che indica la forza del segnale di pulsazioni arteriose come la percentuale di segnale pulsatile a segnale non pulsatile.

16.4 Valori monitorati

SpO₂ in percentuale sarà visualizzato nella sezione inferiore del pannello valori monitorati. Cerchiato nell'illustrazione in alto.

PR (frequenza pulsazioni) è mostrato nella parte superiore destra della forma d'onda SpO₂.

PI (Indice perfusione) quando accesso comparirà accanto al valore PR.


16.5 Soglie di allarmi SpO₂

Quando il monitoraggio SpO₂ è attivo sulle due seguenti soglie di allarme alta e basa diventa attivo nel pannello Limiti di allarme.

SpO₂% e PR (/min).

16.6 Forma d'onda SpO₂ e opzioni di visualizzazione

Il ventilatore SLE6000 mostra la forma d'onda Pletis (Plethysmograph) e la forma d'onda dell'indicatore SIQ (Signal Identification and Quality).

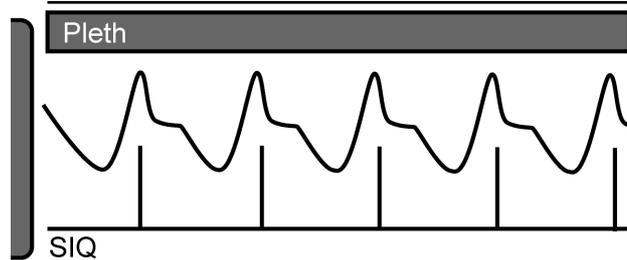


La forma d'onda Pletis viene mostrata in tempo reale.

Questa forma d'onda dell'indicatore SIQ mostra la certezza della misurazione acquisita e la sincronizzazione di ogni impulso rilevato relativo a Pletis. Il ventilatore mostra la forma d'onda dell'indicatore come linea verticale. Più alta è la linea migliore sarà la qualità del segnale, quando la qualità scende la lunghezza della linea si riduce. La qualità è inoltre indicata da un segnale di buona qualità colorato di blu e un segnale di scarsa qualità colorato di arancione.

La forma d'onda dell'indicatore SIQ non è normalizzata.

Viene visualizzata anche la PR frequenza pulsazioni e PI di indice di perfusione. La Frequenza pulsazioni è sempre visualizzata, ma l'Indice perfusione è visualizzato solo quando acceso dal pannello sensore SpO₂.

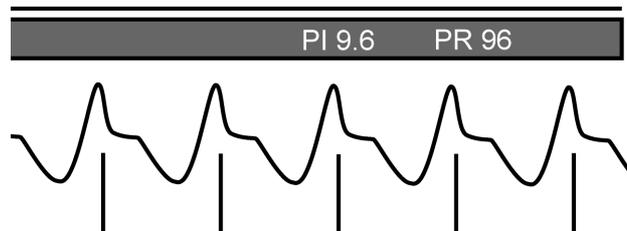


Per SpO₂ l'utente ha una scelta di due grafici.

Grafico 1: "Forme d'onda" che sono le tre forme d'onda di ventilazione standard Pressione, Flusso e Volume con l'aggiunta di SpO₂


Grafico 2: "SpO₂" che è una forma d'onda di ventilazione (Pressione, Flusso o Volume) più Pletis/ SIQ SpO₂ e O₂ impostata.

16.7 Opzione display forma d'onda standard

Dal pannello Grafico selezionare le Forme d'onda.

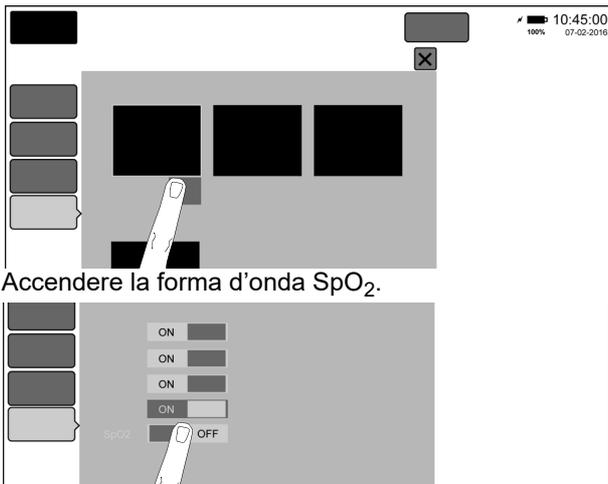

Si aggiungerà una quarta forma d'onda Pletis/SIQ sulla parte inferiore delle forme d'onda in modalità ventilazione.

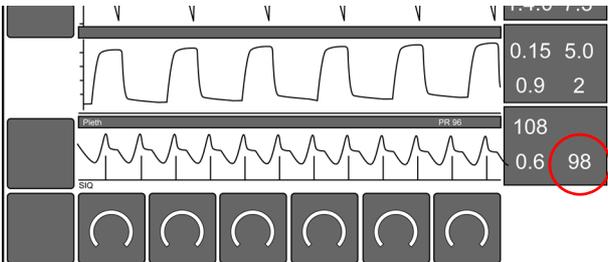


16.7.0.1 SpO₂ e visualizzazione forma d'onda doppia etCO₂

Se i sensori SpO₂ e etCO₂ sono collegati insieme ed entrambe le forme d'onda sono state selezionate per la visualizzazione, la forma d'onda inferiore sarà divisa in due. L'area sinistra per SpO₂ e l'area destra per etCO₂.

16.8 Opzione display forma d'onda SpO₂


Dal pannello Grafico selezionare SpO₂..

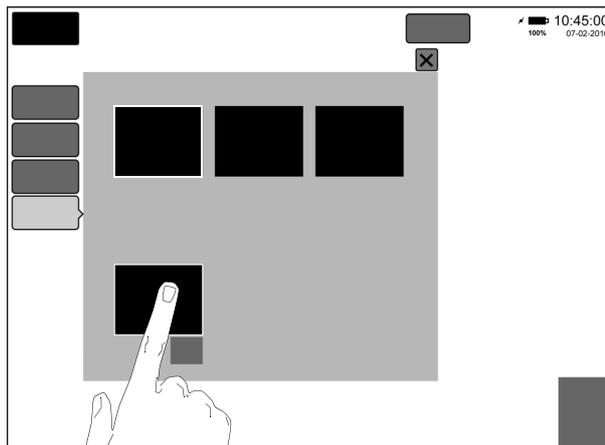

L'utente può direttamente confermare la selezione senza modificare le preferenze della forma d'onda SpO₂.



Se l'utente preme il pulsante "Modifica" il pannello "Livello di SpO₂" diventa attivo.

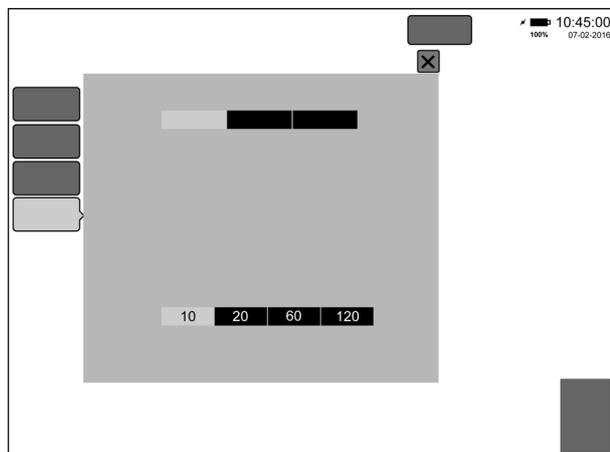


Il pannello "Livello di SpO₂" consente all'utente di selezionare quale forma d'onda del ventilatore viene mostrata nella parte superiore della schermata e la base di tempo per gli andamenti.

Le forme d'onda e gli andamenti predefiniti sono:

- Forma d'onda.... Pressione*
- Forma d'onda.... Pletis
- Andamento SpO₂
- Andamento O₂ impostata

*L'utente può scegliere di visualizzare Pressione, Flusso o Volume.

Premendo il pulsante conferma si attiva il grafico SpO₂.

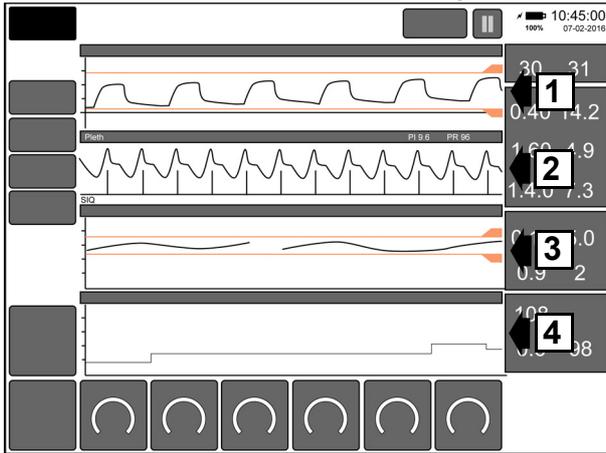


1. Forma d'onda Pressione/Flusso/Volume standard.

Mostra la forma d'onda selezionata dall'utente. La forma d'onda della pressione è la predefinita.

2. Forma d'onda Pletis/SIQ

Mostra la forma d'onda Pletis (traccia superiore) e l'indicatore di qualità del segnale (SIQ) (traccia inferiore).


3. Andamento SpO₂.

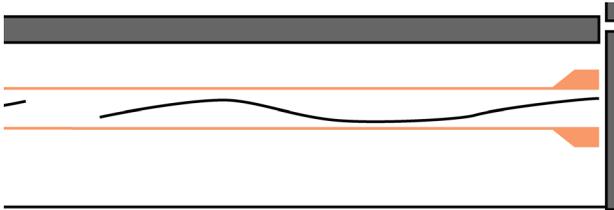

Mostra l'andamento SpO₂. L'andamento SpO₂ ha due soglie di allarme. Le soglie di allarme dell'andamento SpO₂ possono essere manualmente regolate mediante il pannello degli allarmi, i valori predefiniti sono superiori al 98% e inferiori all'88%. I limiti possono essere impostati in altri valori attraverso le preferenze operatore, vedere la sezione '41.1.3 Scheda Allarmi' a pagina 267.

Nota: possono comparire vuoti nell'andamento SpO₂ a causa della perdita di segnale.

4. Andamento O₂% impostato.

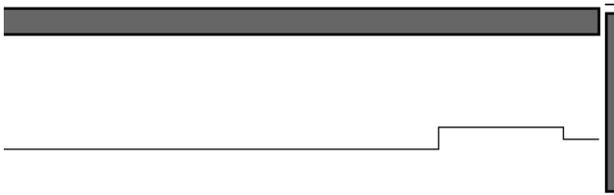

Mostra la O₂% impostata

16.8.1 Forma d'onda SpO₂ in Alti Flussi

Con il monitoraggio SpO₂ acceso l'utente può selezionare le tre forme d'onda dal pannello "SpO₂" Pletis, SpO₂ e O₂ impostata o due forme d'onda Pletis e O₂ selezionando il pannello "Andamenti".

16.9 Test del modulo SpO₂

Per verificare la funzionalità del modulo SpO₂ seguire le istruzioni nella sezione '39.1 Masimo SET[®]' a pagina 255.

16.10 Funzionamento durante l'interruzione di alimentazione elettrica (Mancanza di alimentazione elettrica)

Il funzionamento e il monitoraggio SpO₂ non sono influenzati quando l'alimentazione elettrica del ventilatore viene interrotta.

16.11 Monitoraggio EtCO₂ (MicroPod™)


16.11.1 Principio di funzionamento



Il modulo di capnografia è pensato per fornire ai fornitori di assistenza sanitaria professionalmente preparati una misurazione continua e non invasiva e il monitoraggio della concentrazione di anidride carbonica della frequenza respiratoria di respiri ispirati ed espirati. È pensato per l'uso con i pazienti neonatali, pediatrici e adulti in ospedali e strutture di tipo ospedaliero.

16.11.2 Collegamento al ventilatore

Inserire il connettore a spina Medi del cavo MicroPod™ nella presa etCO₂/CO₂ sulla parte posteriore del ventilatore.

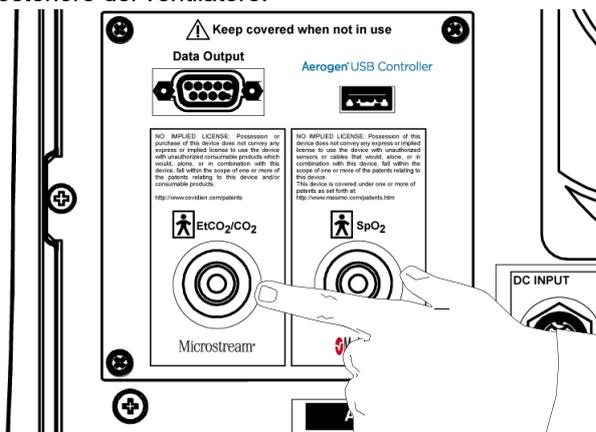

Questo cavo serve per la comunicazione dati e l'alimentazione, con il modulo che riceve la potenza dal monitor attraverso questo collegamento. Non è necessaria una fonte di alimentazione separata.

Un LED sul MicroPod™ indicherà il funzionamento, come segue:

- Durante l'avvio del LED lampeggerà lentamente
- Durante il normale funzionamento il LED rimarrà sempre acceso
- Durante un errore di comunicazione, malfunzionamento o disconnessione del MicroPod™, il LED sarà spento.

16.11.3 Tempo di inizializzazione

Il tempo prima delle misurazioni CO₂ è disponibile dal MicroPod™ al ventilatore include il tempo di accensione e il tempo di inizializzazione. Il tempo di inizializzazione include l'inizializzazione del modulo e i test automatici.

Tempo di accensione: massimo 10 sec

Tempo di inizializzazione: in genere 30 secondi, massimo 180 secondi.

16.11.4 Disconnessione

Il modulo sensore può essere scollegato in qualsiasi momento. La funzione di monitoraggio può essere spenta prima o dopo lo scollegamento del pannello del sensore o l'utente può premere il pulsante "Continua senza etCO₂" nella barra dei messaggi di allarme.

Nota: quando si scollega la linea di campionatura dal dispositivo, tenere lo sportello del connettore di ingresso CO₂ aperto durante la rimozione della linea di campionatura, per evitare di agganciare la linea di campionatura sullo sportello del connettore.

16.11.5 Montaggio del modulo




Nota: il MicroPod™ deve essere montato con il connettore CO₂ rivolto verso l'alto o sul lato per evitare l'ingresso dell'acqua nella porta di scarico quando il MicroPod™ non è in funzione.


16.11.6 Collegamento di una linea del filtro™

Una volta completata la configurazione, è possibile collegare un paziente a MicroPod™ per il

1. Aprire l'otturatore del connettore di ingresso CO₂ e collegare la linea di campionatura appropriata. Avvitare il connettore della linea di campionatura nel monitor in senso orario fino a quando non gira più. monitoraggio CO₂, come segue:

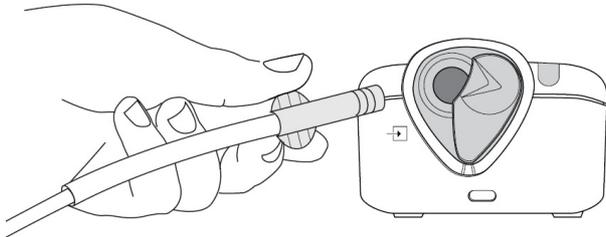


2. Collegare il connettore della linea di campionatura al circuito paziente come mostrato in basso. Quando la linea di campionatura è collegata, il MicroPod™ inizierà immediatamente la ricerca per i respiri, ma non indicherà una condizione di Nessun respiro prima che si presentino respiri validi.

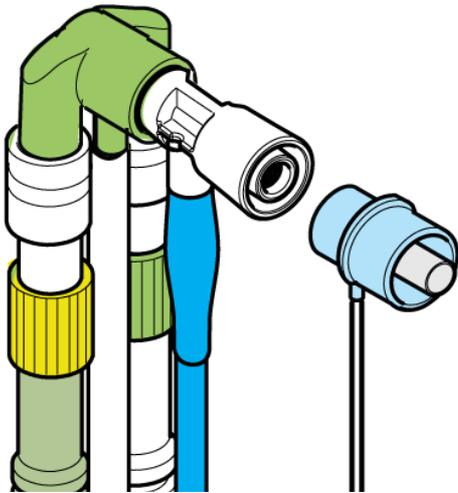

3. I dati CO₂ saranno forniti al monitor host per la visualizzazione. Il monitor host potrebbe inoltre mostrare i dati IPI, se configurato per farlo.
4. Tutti i messaggi e gli allarmi MicroPod™ sono controllati e mostrati sul monitor host.

16.12 Configurazione

Selezionare il pannello Strumenti, questo mostrerà la scheda sensore e quindi selezionare il pulsante etCO₂.

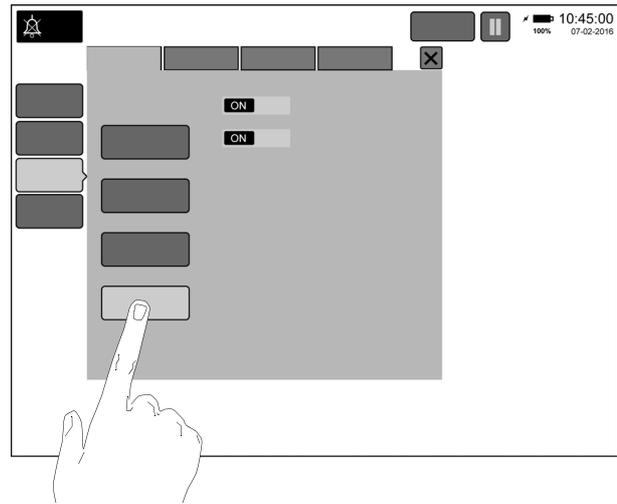

16.12.1 Monitoraggio EtCO₂

Questo pulsante serve ad accendere e spegnere la funzione di monitoraggio etCO₂.

Nota: questo non spegne il sensore. Se OFF il valore etCO₂ mostrato, l'andamento e gli allarmi associati sono disabilitati.

16.12.2 Controllo pompa

Questo accenderà e spegnerà la pompa MicroPod™.

16.12.3 Tempo di allarme per assenza di respiro

Questo imposterà il trigger di tempo per l'allarme "Nessun respiro etCO₂". L'intervallo è di 10-60 secondi. Quello predefinito è di 20 secondi

16.12.4 Informazioni sul dispositivo


Il pannello mostra anche le informazioni sul dispositivo.

Versione software di MicroPod™.
Versione hardware di MicroPod™.
Numero di serie del dispositivo.
Data ultima calibrazione.
Data prossima calibrazione.
Prossima manutenzione.

Nota: consultare il manuale di manutenzione SLE6000 per informazioni sull'assistenza e istruzioni di calibrazione.

16.13 Forme d'onda

Dal pannello Grafico selezionare le Forme d'onda.

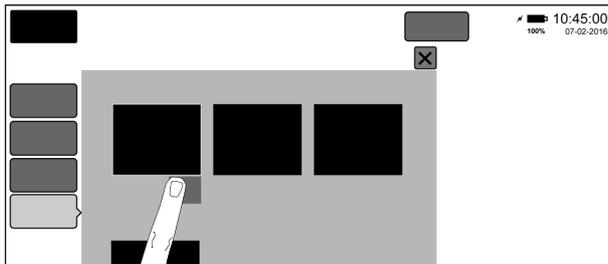


Accendere la forma d'onda etCO₂.



Premere il pulsante conferma.

Questo aggiungerà una quarta forma d'onda etCO₂ alla parte bassa delle forme d'onda in modalità ventilazione.

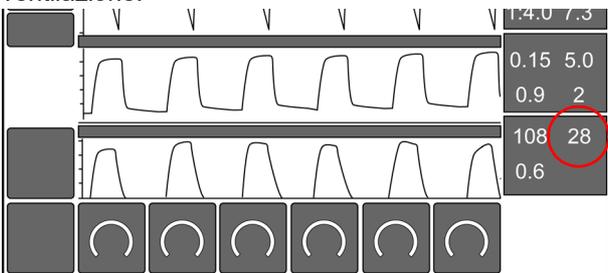

16.13.0.1 Visualizzazione forma d'onda doppia EtCO₂ e SpO₂

Se i sensori etCO₂ e SpO₂ sono collegati insieme ed entrambe le forme d'onda sono state selezionate per la visualizzazione, la forma d'onda inferiore sarà divisa in due. L'area sinistra per SpO₂ e l'area destra per etCO₂.

16.14 Valori monitorati

etCO₂ nelle unità selezionate sarà visualizzato nella sezione inferiore del pannello valori monitorati. Cerchiato nell'illustrazione in alto.

16.15 Soglie di allarmi EtCO₂

Quando il monitoraggio etCO₂ è attivo la seguente soglia di allarme diventa attiva nei Limiti di allarme.

etCO₂

16.16 Compensazione della misurazione del flusso quando si utilizza il monitoraggio etCO₂ del flusso laterale.

Il sensore di flusso paziente compenserà il flusso campione laterale regolando le misurazioni di flusso paziente quando la pompa di monitoraggio etCO₂ è accesa e etCO₂ viene rilevato. Se la pompa di monitoraggio è spenta o etCO₂ non viene rilevato non viene effettuata la compensazione della misurazione di flusso.

16.17 Test del modulo EtCO₂

Per verificare la funzionalità del modulo etCO₂ seguire le istruzioni nella sezione '39.2 MicroPod™' a pagina 256.

16.18 Note operative relative al monitoraggio etCO₂ utilizzando MicroPod™

Nota: durante l'erogazione di farmaci con aerosol o l'aspirazione per pazienti intubati, per evitare la formazione di umidità e l'occlusione della linea di campionatura, rimuovere il connettore luer della linea di campionatura dal modulo.

Nota: sostituire la linea di campionatura in base al protocollo ospedaliero o quando viene rilevato un blocco dalla schermata del monitor host. Le secrezioni eccessive del paziente o la formazione di liquidi nel tubo delle vie respiratorie potrebbe occludere la linea di campionatura o richiedere una sostituzione più frequente.

Nota: quando si collega una linea di campionatura al modulo, avvitare il connettore della linea di campionatura in senso orario nella porta CO₂ del modulo fino a quando è possibile, per garantire che sia ben collegato al modulo. Questo garantirà che non ci sono perdite di gas durante la misurazione nel punto di collegamento e che la precisione della misurazione non viene compromessa.

Nota: quando compare il messaggio \xd2 Sostituire la linea filtro etCO2\xd3 sullo schermo, a indicare che la Linea filtro™ che è collegata al modulo è bloccata, la pompa CO2 del modulo smetterà di alimentare il respiro del paziente nel modulo per il test. Seguire le istruzioni che compaiono nella sezione Risoluzione dei problemi di questo manuale: Per prima cosa scollegare e quindi ricollegare la Linea del filtro™. Se il messaggio è ancora presente, scollegare e sostituire la linea del filtro™. Una volta collegata una linea filtro™ funzionante al modulo, la pompa riprenderà automaticamente il funzionamento.

Nota: in seguito al collegamento della linea di campionatura CO2 al monitor e al paziente, controllare che i valori CO2 compaiano sul display del monitor host.

Nota: le linee di campionatura con l'H nei loro nomi host includono un componente di riduzione dell'umidità (Nafion® o il suo equivalente) per l'uso in ambienti con una maggiore umidità in cui è necessario l'uso prolungato della campionatura CO2.

Nota: tutti i report sulla biocompatibilità per le linee di campionatura sono conservati nel sistema Oridion (Covidien Jerusalem) AGILE PLM, doc n. DR0025 e saranno disponibili su richiesta.

16.19 Funzionamento durante l'interruzione di alimentazione elettrica (Mancanza di alimentazione elettrica)

Il funzionamento e il monitoraggio etCO₂ non sono influenzati quando l'alimentazione di rete viene interrotta.

16.20 Pulizia della custodia MicroPod™

Il seguente elenco di materiali è stato testato e approvato per essere utilizzato per la pulizia della custodia MicroPod™: acqua e saponi, diluizione di ammoniaca <3%, etanolo 70%, isopropanolo 70% e spray . La pulizia deve essere effettuata strofinando il MicroPod™ con un panno inumidito da questi materiali.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

OxyGenie®



17. OxyGenie®

Avvertenza: l'uso di OxyGenie® è controindicato sui pazienti la cui SpO₂ prefissata è fuori dai seguenti intervalli stabiliti. 90-94%, 91-95%, 92-96%, 94-98%.

Attenzione: prima di avviare (o riavviare) OxyGenie, controllare (e regolare se necessario) che l'impostazione O₂ sia appropriata per la condizione clinica corrente dei pazienti. Questa impostazione O₂ iniziale ottimizza la risposta iniziale e il tempo di risposta iniziale dell'algoritmo.

17.1 Introduzione

Il sistema OxyGenie® è pensato per controllare la fornitura di ossigeno inspirato, per mantenere la SpO₂ del paziente nell'intervallo predefinito di SpO₂, durante la ventilazione meccanica, nCPAP, supporto respiratorio non invasivo e Terapia di ossigeno ad alto flusso gestita nei pazienti neonatali, infantili e pediatrici.

L'algoritmo OxyGenie® è un controller (PID) proporzionale-integrale-derivativo a circuito chiuso. Una volta al secondo questo algoritmo utilizza la SpO₂ del paziente (misurata utilizzando i sensori Masimo SET) per calcolare l'impostazione O₂ appropriata per mantenere la SpO₂ nell'intervallo stabilito.

OxyGenie® calcola il quantitativo medio di ossigeno richiesto per mantenere il paziente nell'intervallo stabilito. Questo è calcolato utilizzando i dati di 1 ora e questo valore è chiamato $\times 2$ O₂ di riferimento $\times 3$.

Nota: il valore "O₂ di riferimento" è una media della richiesta di ossigeno del paziente nell'ultima ora.

OxyGenie® non imposterà l'O₂ oltre il 40% sopra o sotto lo O₂ di riferimento, per evitare grosse fluttuazioni nell'ossigeno fornito. Il valore O₂ di riferimento utilizzato per la funzione in alto è fissato al 60%

in modo che OxyGenie® può ridurre lo O₂ al 21% quando richiesto.



Il monitoraggio SpO₂ si ottiene mediante i sensori Masimo SET. Gli allarmi SpO₂ alti e bassi sono automaticamente impostati all'1% sopra il limite superiore dell'intervallo stabilito e l'1% sotto il limite inferiore dell'intervallo stabilito. Questi limiti sono regolabili dall'utente.

Vedere SLE uSpO₂ Cavo del pulsossimetro (Masimo SET) IFU per i dettagli delle condizioni che possono influenzare la precisione delle letture SpO₂.

Attenzione: Deve essere effettuato il monitoraggio paziente indipendente dal ventilatore aggiuntivo (analizzatore gas del sangue per monitoraggio vitale lato letto).

Avvertenza: non utilizzare OxyGenie® se la differenza tra SpO₂ e SaO₂ è superiore al 5%.

OxyGenie® può essere utilizzato in qualsiasi modalità di ventilazione.

17.1.1 Modalità di funzionamento OxyGenie®

17.1.1.1 Modalità auto


OxyGenie® calcola la richiesta di ossigeno dei pazienti dai valori SpO₂ correnti e precedenti ogni secondo e regola di conseguenza l'impostazione del miscelatore di ossigeno.

Quando OxyGenie® è in modalità "Auto" la casella dell'indicazione di stato e il controllo O₂ mostra "Auto". Quando OxyGenie® è attivo il pulsante del controllo O₂ mostra il valore istantaneo O₂ inviato al miscelatore. Lo O₂ monitorato mostrerà lo O₂ misurato dalla cella di ossigeno. Una leggera differenza in questi valori è normale

17.1.1.2 Modalità alternativa:

OxyGenie® entrerà in "modalità alternativa" se non viene ricevuto nessun segnale SpO₂ valido. Questo può verificarsi se il sensore SpO₂ si stacca dal paziente o non fa un buon contatto con la pelle o se la SIQ bassa viene segnalata dal sistema Masimo

Quando OxyGenie® è in modalità "Alternativa" la casella dell'indicazione di stato mostra "in attesa segnale" e il controllo "O₂" mostra " - - - "

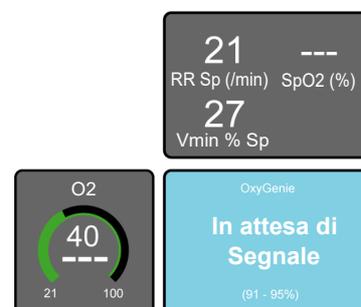

17.1.1.3 Override manuale

In qualsiasi momento quando OxyGenie® viene acceso l'utente può effettuare regolazioni manuali alla O₂ impostata, la O₂ manualmente impostata sarà fornita per 30 secondi

Quando OxyGenie® è in modalità "override manuale" la casella di indicazione di stato mostra "override manuale" e il "O₂" Controllo mostra "- - -"

17.1.1.4 Modalità inattiva

Quando OxyGenie® non è attivo la casella dell'indicazione di stato non sarà visibile.

17.2 OxyGenie® Modalità alternativa

Il funzionamento della modalità alternativa è come segue.

I primi 60 secondi di segnale SpO₂ non valido:

OxyGenie® fornirà l'ultima impostazione O₂.

Dopo 60 secondi di nessun segnale SpO₂ valido

Se l'ultima lettura SpO₂ valida era nell'intervallo stabilito OxyGenie® continuerà a fornire l'ultimo valore O₂ impostato.

Se l'ultima lettura SpO₂ valida era oltre l'intervallo stabilito OxyGenie® ridurrà lentamente l'ossigeno fornito rispetto al valore O₂ di riferimento.

Se l'ultima lettura SpO₂ valida era sotto l'intervallo stabilito OxyGenie® aumenterà lentamente l'ossigeno fornito rispetto al valore O₂ di riferimento

Dopo il ripristino del segnale SpO₂

Non appena il segnale SpO₂ viene ricevuto OxyGenie® calcolerà e imposterà la richiesta di ossigeno sulla base del valore SpO₂.

Durante la "modalità alternativa" il "O₂" pulsante di controllo mostrerà "---" al posto di "Auto" e l'indicazione di stato OxyGenie® mostrerà in "attesa di segnale"

Gli allarmi SpO₂ e i messaggi di eccezione compariranno nella barra degli allarmi.

17.2.1 Verifica della risposta OxyGenie®

La risposta di OxyGenie® alle modifiche in SpO₂ può essere visualizzata nell'O₂ impostata e il pulsante di controllo O₂ e anche nell'andamento O₂.


17.2.2 Attivazione di OxyGenie®

Nota: OxyGenie® è disponibile solo quando il sensore SpO₂ è collegato e il monitoraggio SpO₂ è attivo.


Per attivare OxyGenie® tenere premuto il controllo del parametro "O₂" per 3 secondi.



Premere il pulsante OxyGenie®.



Premendo il pulsante conferma OxyGenie® diventerà attivo.



Questo è indicato dalla casella del messaggio di indicazione di stato accanto al controllo del parametro O₂.



La concentrazione di O₂ sarà automaticamente controllata per mantenere l'intervallo SpO₂ stabilito.

17.2.3 Disattivazione di OxyGenie®

Per disattivare OxyGenie® tenere premuto il controllo del parametro O₂ per 3 secondi.



Premere quindi il pulsante OxyGenie®.



Premendo il pulsante di conferma OxyGenie® diventerà inattivo.



Il controllo del parametro O₂ ritorna normale.



17.2.4 Attivazione override manuale

Attenzione: l'override manuale non può essere annullato una volta avviato.

Per modificare la concentrazione di O₂ manualmente toccare il controllo "O2".



La casella del messaggio sarà sostituita dai pulsanti più/meno. Il test "Auto" sarà sostituito da tre trattini.



Regolare la O₂% alla percentuale richiesta.



Premendo il pulsante di conferma per 30 secondi si avvierà l'override manuale.



La casella del messaggio diventerà blu e verrà mostrato il testo "Override manuale" con i restanti secondi mostrati sotto.

17.2.5 Modifica dell'intervallo stabilito SpO₂


L'intervallo stabilito di SpO₂ può essere modificato dall'utente in qualsiasi momento. Per modificare l'intervallo stabilito, l'utente deve navigare in "Strumenti" > "Sensori" quindi selezionare il pulsante "SpO₂". Gli intervalli stabiliti SpO₂ possono essere selezionati dal relativo elenco a discesa. Premendo conferma l'intervallo stabilito cambierà in quello selezionato.

17.2.6 Tempo medio

Il tempo medio è fissato a 2-4 secondi quando OxyGenie® è attivo.

17.3 Opzione display forma d'onda SpO₂ e OxyGenie®

Premendo il pulsante conferma si attiva il grafico SpO₂.

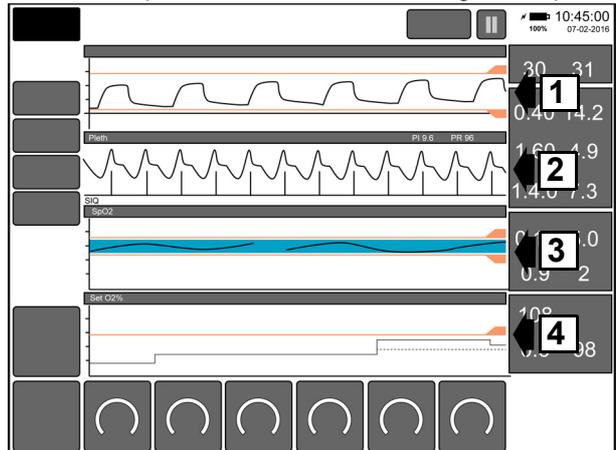


1. Forma d'onda Pressione/Flusso/Volume standard.

Mostra la forma d'onda selezionata dall'utente. La forma d'onda della pressione è la predefinita.

2. Forma d'onda Pletis/SIQ

Mostra la forma d'onda Pletis (traccia superiore) e l'indicatore di qualità del segnale (SIQ) (traccia inferiore).


3. Andamento SpO₂.

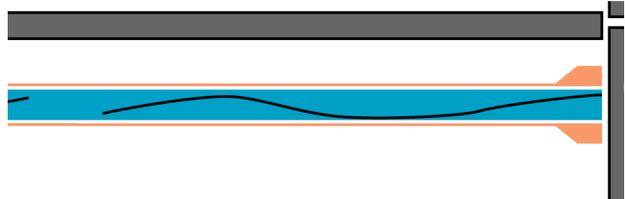

Mostra l'andamento SpO₂ e l'intervallo stabilito SpO₂ indicato dalla barra blu. L'intervallo stabilito è fiancheggiato da due soglie di allarme che sono automaticamente impostate $\pm 1\%$ su ciascun lato dell'intervallo stabilito selezionato. Le soglie di allarmi di andamento SpO₂ possono essere manualmente regolate dal pannello degli allarmi.

Nota: possono comparire vuoti nell'andamento SpO₂ a causa della perdita di segnale.

4. Andamento O₂% impostato.

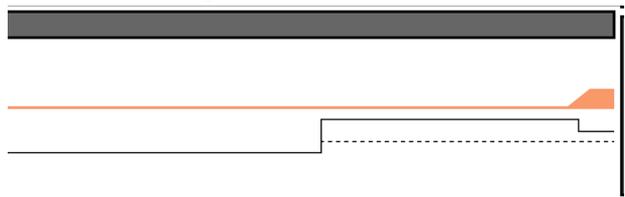

Mostra la O₂% impostata e il riferimento O₂% indicato dalla linea tratteggiata. Attiva è anche la soglia di allarme O₂% alta.

17.4 OxyGenie® e Aumento O₂

Nota. Aumento O₂ è disabilitato quando OxyGenie® è attivo.

Per utilizzare l'aumento O₂ disabilitare per prima cosa OxyGenie®. Per maggiori informazioni sull'aumento O₂ Vedere "Aumento O₂" a pagina 119.

17.5 OxyGenie® e aspirazione O₂

Nota. L'aspirazione O₂ è disabilitata quando OxyGenie® è attiva.

Per utilizzare l'aspirazione O₂ disabilitare per prima cosa OxyGenie®. Per maggiori informazioni sull'aspirazione O₂ Vedere "Aspirazione O₂" a pagina 118.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Funzioni operative



18. Funzioni operative

18.1 Informazioni generali

18.1.1 Modalità Attesa

Avvertenza: non entrare in modalità "Attesa" quando è connesso un paziente. Non viene fornita alcuna ventilazione.

18.1.2 Allarme apnea impostato su "Off"

In qualsiasi modalità in cui l'utente può impostare l'allarme di Apnea su "Off", i respiri di backup sono disabilitati persino con "On", a meno che apnea non viene riavviato.

Avvertenza: quando l'allarme di apnea è impostato su "OFF", l'utente deve usare un metodo alternativo per la rilevazione degli episodi di apnea, sia in caso di ventilazione invasiva sia in caso di ventilazione non invasiva.

18.1.3 Fonte di alimentazione di riserva

Il ventilatore funzionerà generalmente per oltre 3 ore con la carica della batteria al 100%, sia in modalità convenzionale che HFOV. La durata effettiva della scarica dipenderà dalla condizione della batteria e dalle impostazioni di ventilazione applicate. Fare riferimento all'avviso per un funzionamento sicuro.

Il funzionamento del ventilatore non cambia con la fonte di alimentazione di riserva.

Il funzionamento del ventilatore non cambia durante la carica della fonte di alimentazione di riserva.

Non è necessario che il ventilatore sia acceso per fare in modo che le batterie si ricarichino. Durante l'uso, il ventilatore mantiene le batterie completamente cariche.

In caso di guasto dell'alimentazione elettrica, suona l'allarme "Mancanza di alimentazione elettrica" e viene mostrato nel pannello degli allarmi. Questo allarme ha bassa priorità.

L'utente può sospendere l'allarme "Mancanza di alimentazione elettrica di rete" premendo il pulsante Reset quando si presenta l'allarme "Mancanza di alimentazione elettrica di rete".

Avvertenza: in una condizione di "Mancanza di alimentazione elettrica di rete" e se l'utente cancella l'allarme "Mancanza di alimentazione elettrica di rete", il successivo allarme relativo all'alimentazione che verrà triggerato sarà l'allarme di media priorità "Batteria scarica". Questo significa che l'alimentazione interna ha raggiunto una capacità del 25%. L'utente dovrà sottoporre il paziente a una forma di ventilazione alternativa a questo punto se non è possibile ripristinare l'alimentazione. Se l'utente cancella l'allarme di media priorità "Mancanza di alimentazione elettrica di rete", il successivo allarme relativo all'alimentazione che sarà triggerato sarà un allarme di alta priorità "Batteria scarica". Questo significa che l'alimentazione interna ha una durata di meno di 10 minuti.

Una volta esaurita tutta l'alimentazione a batterie, suonerà l'allarme di mancanza completa di alimentazione e smetterà di ventilare il paziente.

Avvertenza. Il ventilatore può essere usato con una batteria completamente scarica, ma si deve ricordare che in caso di mancanza dell'alimentazione di rete, smetterà di ventilare il paziente.

Avvertenza. Non conservare le batterie completamente scariche. Ricaricare le batterie prima possibile per preservarne la durata utile. Se il ventilatore deve essere conservato a magazzino, verificare che le batterie siano completamente cariche.

18.1.4 Memoria parametri

L'utente deve essere a conoscenza del fatto che il ventilatore ricorderà le impostazioni del parametro utente passando da una modalità a un'altra. Anche se l'impostazione viene ricordata nel passaggio tra le modalità, il titolo del parametro potrebbe cambiare. Un esempio è il parametro CPAP che in modalità CPAP diventa PEEP in modalità CMV.

18.1.5 Rapporto I:E variabile HFO (Disponibile solo con le opzioni HFOV e NHFOV)

Il rapporto I:E consente all'utente di incrementare la fase espiratoria in rapporto a quella inspiratoria dal rapporto 1:2 o 1:3 indicato.

Avvertenza: le modifiche inappropriate nel rapporto I:E potrebbero comportare una riduzione del volume per ciascun ciclo HFO e il successivo volume minuto fornito al paziente. Potrebbe essere necessario un monitoraggio secondario di TcPO₂.

18.1.6 Respiri di supporto pressorio non forniti come impostato

Ci sono numerose situazioni in cui il ventilatore potrebbe avere difficoltà a raggiungere la pressione impostata sui respiri di supporto.

Scenario 1

Se il livello di supporto impostato è 5mbar o inferiore alla PEEP con un breve tempo Ti.

Scenario 2

Se il polmone del paziente è grande o viene utilizzato un circuito con foro grande. Se il polmone/circuito paziente ha una grossa compliance potrebbe avere una grossa costante di tempo, quindi indipendentemente da quale pressione il ventilatore emette, potrebbe impiegare più tempo del Ti fornito per arrivare a tale pressione.

18.1.7 Sensibilità del trigger

Con un sensore di flusso montato.

La sensibilità del trigger di respiri deve essere impostata in tutte le modalità interattive del paziente (predefinita 0,6 ml).

Se si imposta la sensibilità del trigger di respiri al suo livello più sensibile (0,2 ml) il ventilatore può interpretare il rumore di fondo nel circuito paziente come respirazione del paziente, con conseguente auto-trigger.

Quando è usato con un sensore di flusso, il ventilatore monitora il flusso di gas per rilevare il respiro del paziente.

Quando è usato senza un sensore di flusso, il ventilatore monitora la variazione di pressione per rilevare il respiro del paziente.

Senza sensore di flusso montato.

La sensibilità del trigger di respiri deve essere impostata in tutte le modalità interattive del paziente. Predefinita 50%.

Se si imposta la soglia di rilevazione del respiro sul suo livello più sensibile (100%) il ventilatore può interpretare il rumore di fondo nel circuito paziente come respirazione del paziente, con conseguente auto-trigger.

Quando è usato con un sensore di flusso, il ventilatore monitora il flusso di gas per rilevare il respiro del paziente.

Quando è usato senza un sensore di flusso, il ventilatore monitora la variazione di pressione per rilevare il respiro del paziente.

18.1.8 Ventilazione a volume prefissato, Vte (VTV)

18.1.8.1 Ti (T insp)

Quando VTE è impostato su ON in CPAP, CMV, PTV, PSV e SIMV, se il volume inspiratorio supera il limite di sicurezza, il respiro viene interrotto, per impedire una sovradistensione polmonare. Questo comporta un T insp misurato più basso di quello impostato. Il tempo inspiratorio effettivo viene visualizzato nel pannello della meccanica polmonare e nel pannello delle misurazioni come T insp misurato.

18.1.8.2 Risoluzione Vte obiettivo

Il controllo del parametro volume corrente ha tre diverse risoluzioni.

Da 2 ml a 10 ml il parametro aumenta con progressioni da 0,2 ml (risoluzione fine).

Da 10 ml a 100 ml il parametro aumenta con progressioni da 1 ml (risoluzione standard).

Da 100 ml a 300ml il parametro ha incrementi da 5 ml (bassa risoluzione).

18.1.9 T insp max in PSV

In modalità PSV, il parametro del tempo inspiratorio è indicato con Tempo inspiratorio massimo. Ciò è dovuto al fatto che il controllo della sensibilità di fine flusso (blocco del supporto a %) può porre fine al respiro prima del raggiungimento del tempo inspiratorio impostato.

18.1.10 Aspirazione (aspirazione chiusa).

I cateteri di aspirazione chiusi possono essere utilizzati in tutte le modalità invasive. Non sono richieste impostazioni speciali per l'uso di un catetere di aspirazione chiuso.

18.1.11 VTV e HFOV

Il controllo volume si deve ottenere con la regolazione automatica del delta P, in modo simile alla PIP essendo automaticamente controllata in modalità convenzionale per mantenere un volume espiratorio fisso.

Ci sono differenze significative (tra HFOV + VTV e la VTV convenzionale) dal momento che il volume si aggiorna più rapidamente rispetto alla modalità di respiro convenzionale.

In modalità respiro convenzionale con VTV, la decisione di regolare la pressione viene presa ogni qual volta il volume espiratorio viene ricevuto dal monitor. Questo è generalmente una volta per respiro standard. Nei volumi espiratori HFOV viene aggiornato una volta per ciclo. I volumi espiratori sono soggetti a grosse variazioni su base ciclica e sono ricevuti 20 volte al secondo. Invece di effettuare una regolazione su ogni ciclo, saranno eseguite sul volume espiratorio medio.

Come con la ventilazione convenzionale il messaggio di controllo Delta P "ΔP" diventerà "ΔP Max".

18.1.11.1 Risoluzione Vte obiettivo

Il controllo del parametro volume corrente ha due diverse risoluzioni.

Da 2 ml a 10 ml il parametro aumenta con progressioni da 0,2 ml (risoluzione fine).

Da 10 ml a 50ml il parametro aumenta con progressioni da 1 ml (risoluzione standard).

18.2 Tipi di compensazione di perdita

18.2.1 VTV e perdita al paziente

Il ventilatore proverà a raggiungere la VTV impostata all'interno dei seguenti limitatori di Max PIP o perdita del 50%.

oppure

Il ventilatore incrementerà la PIP massima per ottenere il volume stabilito e compensare automaticamente la perdita fino al 50%.

18.2.2 Modalità NIV e perdita paziente

Il ventilatore incrementerà il flusso di gas fresco in risposta alla perdita paziente fino a un massimo di 15 l/min per mantenere la pressione CPAP/PEEP impostata dall'utente.

18.2.3 Compensazione perdita automatica modalità PSV

La presenza di una grossa perdita nel circuito respiratorio potrebbe impedire che il flusso venga interrotto in modalità PSV. Se il flusso della perdita è superiore al livello di sensibilità di fine flusso selezionato, il flusso non viene interrotto in quanto non raggiunge mai il livello di fine flusso. È stato introdotto un nuovo algoritmo che compensa la perdita e rende possibile la regolazione del livello di fine flusso in base all'entità della perdita. Se il livello di fine flusso è superiore al flusso di perdita, questo viene interrotto al livello selezionato. Un algoritmo compensa i flussi di perdita fino a 5 l/min o 50% del flusso di picco a seconda di quale si presenta prima. È inoltre attivo se il volume di perdita è compreso tra il 10% e 50%.

18.3 Aspirazione O2

Nota: l'aspirazione di O2 è disponibile solo se attivata in preferenze operatore. Vedere "Preferenze operatore" a pagina 266.

Attenzione. l'aspirazione O2 è disabilitata quando Auto O2 è on. Vedere "OxyGenie® e aspirazione O2" a pagina 113.

La funzione aspirazione O2 consente all'utente di incrementare la % fornita di ossigeno prima, durante e dopo la procedura di aspirazione per un tempo stabilito.

Per attivare l'aspirazione O2, tenere premuto il controllo del parametro O2 per 3 secondi e poi premere il tasto di conferma.



Viene visualizzato il messaggio "Aspirazione O2 in Attesa" oltre il controllo del parametro O2 (il controllo è rinominato "aspirazione O2"). Il più/meno e il pulsante di conferma diventano attivi.



L'utente, se necessario, può regolare l'aumento percentuale rispetto al set in questo punto.

Il colore della barra 'curva' del controllo del parametro % O2 rimane lo stesso per la parte che rappresenta l'impostazione % O2 originale, ma cambia in rosso per la parte che rappresenta l'incremento O2. L'esempio mostra la percentuale impostata del 30% con un incremento predefinito del 5%.



Nota: l'aumento predefinito di O2 può essere preimpostato tra l'1 e il 10% oltre l'impostazione attuale o il 100%. L'impostazione predefinita di fabbrica è del 5%. Vedere "Preferenze operatore" a pagina 266.

L'utente può incrementare o ridurre la % O2, ma non può essere ridotta sotto il valore impostato originale.

L'utente preme il pulsante conferma. Questa azione avvia la procedura di Aspirazione O2.

Viene mostrato il messaggio "Pre aspirazione O2 in corso" sopra il controllo del parametro "Aspirazione O2" per un conto alla rovescia di 3 minuti.

Il ventilatore attende la disconnessione nei seguenti 3 minuti.

Se l'utente non disconnette il paziente durante la finestra di 3 minuti, l'incremento finisce automaticamente.

Quando l'utente disconnette il paziente. Il ventilatore mostrerà il messaggio "Aspirazione O2 in corso" e inizierà il conto alla rovescia per 2 minuti. Viene automaticamente avviato l'allarme silenziato.

Durante questo tempo, il ventilatore attende la riconnessione. Se l'utente non riconnette il paziente prima della scadenza del tempo, questo farà suonare l'allarme del ventilatore. La procedura si arresta a questo punto.

Quando l'utente riconnette il paziente prima della fine della finestra di aspirazione di 2 minuti, il ventilatore avvia un nuovo conto alla rovescia di 2 minuti, alla % O2 elevata. Viene mostrato il messaggio "Post aspirazione O2 in corso".

La procedura terminerà alla fine del conto alla rovescia di 2 minuti.

Se l'utente tiene premuto il controllo del parametro Aspirazione O2 in qualsiasi momento compare un nuovo controllo sul pannello del messaggio. Se l'utente preme questo controllo conferma che l'azione della procedura viene annullata. La % O2 ritorna al valore originale e si cancella il messaggio.




18.4 Aumento O2

Nota: l'aumento di O2 è disponibile solo se disponibile in preferenze operatore. Vedere "Preferenze operatore" a pagina 266.

Attenzione. Aumento O2 è disabilitato quando Auto O2 è on. Vedere "OxyGenie® e Aumento O2" a pagina 113.

La funzione Incremento O2 consente all'utente di incrementare la % di ossigeno a un incremento preimpostato o impostato dall'utente per un massimo di due minuti.

Per attivare l'Aumento O2, tenere premuto il controllo del parametro O2 per 3 secondi e poi premere il tasto di conferma.



Viene visualizzato il messaggio "Incremento O2 in standby" oltre il controllo del parametro O2 (il controllo è rinominato "Incremento O2").



Il più/meno e il pulsante di conferma diventano attivi.

Nota: l'aumento predefinito di O2 (Aumento) può essere preimpostato tra l'1 e il 10% oltre l'impostazione attuale o il 100%. L'impostazione predefinita di fabbrica è del 5%. Vedere "Preferenze operatore" a pagina 266.

Il colore della barra 'curva' del controllo del parametro % O2 rimane lo stesso per la parte che rappresenta l'impostazione % O2 originale, ma cambia in rosso per la parte che rappresenta l'incremento O2. L'esempio mostra la percentuale impostata del 30% con un incremento predefinito del 5%.



L'utente può incrementare o ridurre la % O2, ma non può essere ridotta sotto il valore impostato originale.

L'utente preme il pulsante conferma. Questa azione avvia la procedura di aumento O2

Il timer del conto alla rovescia è impostato per 2 minuti. Dopo 2 minuti la procedura si interrompe.

Se l'utente tiene premuto il controllo del parametro Aumento O2 compare un nuovo controllo sul pannello del messaggio. L'utente preme questo controllo e conferma che l'azione della procedura viene annullata.

La % O2 ritorna al valore originale e il messaggio si cancella.




18.5 Soglie di allarme

Il ventilatore per ogni modalità ha impostazioni di pressione relative alle soglie di allarme che sono impostate dall'utente o automaticamente dal ventilatore in base ai parametri impostati dall'utente.

L'unica modalità che non ha soglie di allarme relative alla pressione è Alti flussi.

18.5.1 Soglie di allarme per modalità convenzionali (invasiva e non invasiva - doppio lume).

Lo schema in basso mostra le soglie di allarme della pressione per le modalità convenzionali (invasiva e non invasiva).

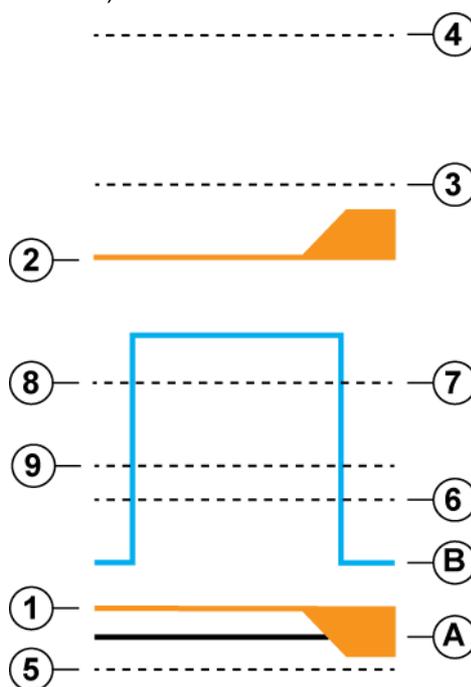

A. Linea di pressione zero

B. Forme d'onda

Soglie di allarme

1. Pressione bassa (controllo allarme PEEP bassa) impostazione automatica e regolabile dall'utente.
2. PIP alta (controllo allarme PIP alta). Impostazione automatica e regolabile dall'utente.
3. Soglia di allarme alta pressione superata (+5 mbar oltre la PIP). Impostazione automatica.
4. Soglia di allarme alta pressione superata (+20 mbar oltre la PIP) Impostazione automatica.
5. Ambiente inferiore (-2 mbar sotto la pressione zero). Impostazione automatica.
6. PEEP alta (controllo allarme PEEP elevata). Impostazione automatica e regolabile dall'utente.
7. PIP bassa (controllo allarme PIP bassa). Impostazione automatica e regolabile dall'utente.
8. Errore di ciclo. Impostazione automatica.
9. Prolungata pressione positiva. (+5 mbar oltre CPAP/PEEP per più di 4 secondi). Impostazione automatica.

18.5.2 Le soglie di allarme per le modalità oscillatorie (invasiva e non invasiva - doppio lume).

18.5.2.1 HFOV e NHFOV

I diagrammi A e B mostrano le soglie di allarme di pressione (modalità invasiva e non invasiva).

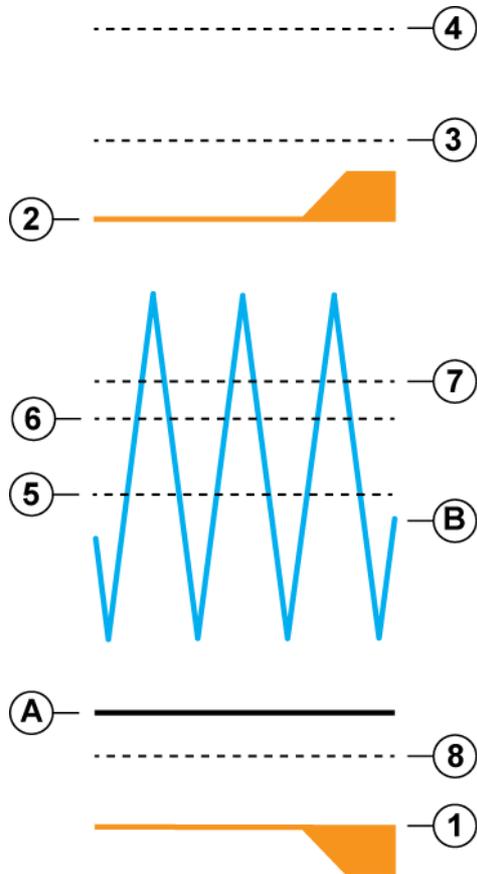


Diagramma A

A. Linea di pressione zero

B. Forme d'onda

Soglie di allarme

1. Pressione bassa (controllo allarme Paw bassa) impostazione automatica e regolabile dall'utente.
2. Alta pressione (controllo allarme Paw alta) impostazione automatica e regolabile dall'utente.
3. Soglia di allarme alta pressione superata (+5 mbar oltre la PIP). Impostazione automatica.
4. Soglia di allarme alta pressione superata (+20 mbar oltre la PIP) Impostazione automatica.
5. Caduta inattesa in P media. (-5 mbar sotto la P media). Impostazione automatica.
6. Aumento inatteso nella P. media (+5 mbar oltre la P media). Impostazione automatica.
7. Prolungata pressione positiva. (+10 mbar oltre la P media per più di 4 secondi). Impostazione automatica.
8. Ambiente inferiore (Pressione media -2 mbar sotto la pressione zero). Impostazione automatica.


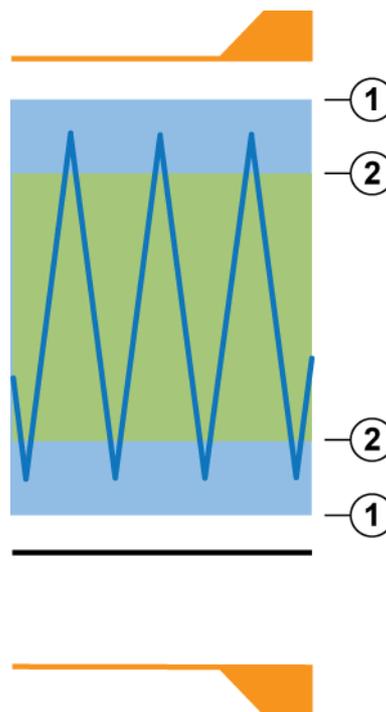


Diagramma B

1. Aumento inatteso in delta P. (+5 mbar oltre delta P). Impostazione automatica.
2. Caduta inattesa in delta P. (-5 mbar sotto il delta P). Impostazione automatica.

18.5.2.2 HFOV+CMV (invasiva - doppio lume)

Il diagramma in basso mostra le soglie di allarme di pressione (modalità invasiva).

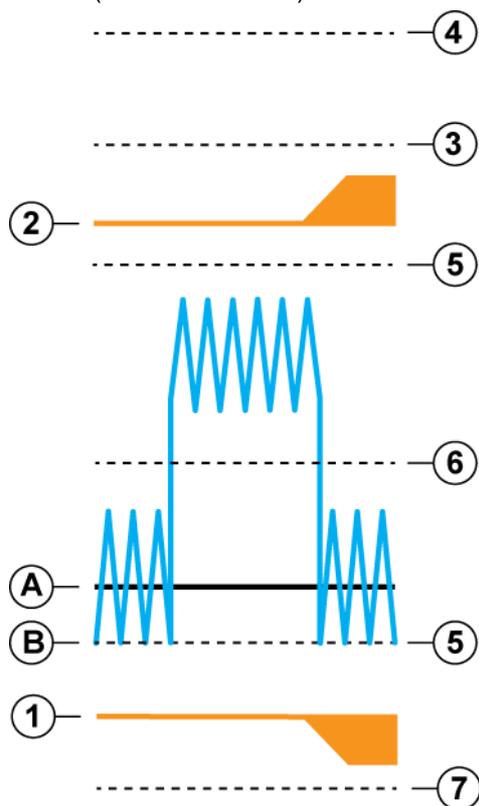

A. Linea di pressione zero


B. Forme d'onda

Soglie di allarme

1. Pressione bassa (controllo allarme Paw bassa) impostazione automatica e regolabile dall'utente.
2. Alta pressione (controllo allarme Paw alta) impostazione automatica e regolabile dall'utente.
3. Soglia di allarme alta pressione superata (+5 mbar oltre la PIP). Impostazione automatica.
4. Soglia di allarme alta pressione superata (+20 mbar oltre la PIP) Impostazione automatica.
5. Rilevata variazione di pressione. (Vedere "Messaggio di allarme: rilevata variazione di pressione." a pagina 203.) Impostazione automatica.
6. Prolungata pressione positiva. (+10 mbar oltre la P media per più di 4 secondi). Impostazione automatica.
7. Ambiente inferiore (Pressione media -2 mbar sotto la pressione zero). Impostazione automatica.

18.5.3 Soglie di allarme per modalità convenzionali (non invasiva - singolo lume).

Lo schema in basso mostra le soglie di allarme della pressione per le modalità convenzionali (non invasiva).

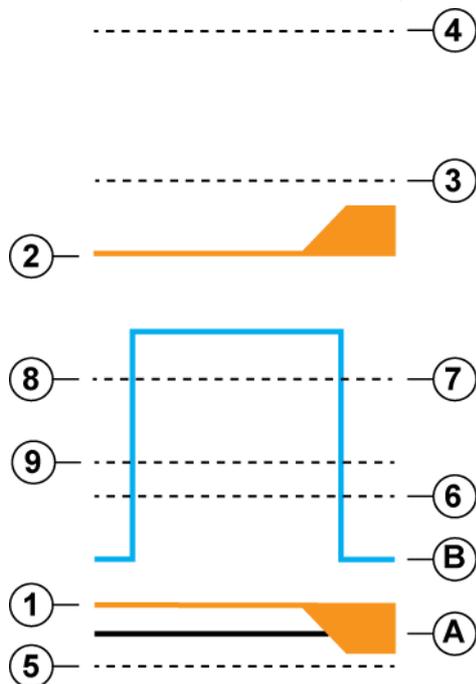

A. Linea di pressione zero

B. Forme d'onda

Soglie di allarme

1. Pressione bassa (controllo allarme PEEP bassa) impostazione automatica e regolabile dall'utente.
2. PIP alta (controllo allarme PIP alta). Impostazione automatica e regolabile dall'utente.
3. Soglia di allarme alta pressione superata (+5 mbar oltre la PIP). Impostazione automatica.
4. Soglia di allarme alta pressione superata (+20 mbar oltre la PIP) Impostazione automatica.
5. Ambiente inferiore (-2 mbar sotto la pressione zero). Impostazione automatica.
6. PEEP alta (controllo allarme PEEP elevata). Impostazione automatica e regolabile dall'utente.
7. PIP bassa (controllo allarme PIP bassa). Impostazione automatica e regolabile dall'utente.
8. Errore di ciclo. Impostazione automatica.
9. Prolungata pressione positiva. (+5 mbar oltre CPAP/PEEP per più di 4 secondi). Impostazione automatica.

18.5.4 Funzionamento dell'allarme di soglia di alta pressione.

Se la soglia di allarme PIP alta impostata dall'utente viene superata di 5 mbar o 20 mbar il ventilatore esegue le seguenti azioni.

Superamento della soglia PIP alta di 5 mbar

Se la soglia di allarme PIP alta è superata di oltre 5 mbar, il ventilatore interrompe tutte le alimentazioni di gas per 3 secondi. Mantiene la pressione media e arresta la ventilazione e ciò avviene per tutte le modalità di ventilazione. Il ventilatore ripristina l'alimentazione di gas dopo 3 secondi e riavvia quindi la ventilazione dopo altri 5 secondi dal ripristino del gas. L'allarme "Soglia di alta pressione superata" suona finché la condizione non viene cancellata. Se il ventilatore incontra le stesse condizioni dopo il riavvio della ventilazione, viene ripetuto il ciclo.

Superamento della soglia di 20 mbar impostata dal ventilatore

Se la soglia di allarme PIP alta è superata di oltre 20 mbar, il ventilatore interrompe tutte le alimentazioni di gas per 6 secondi. Non mantiene la pressione media e arresta la ventilazione e ciò avviene per tutte le modalità di ventilazione. Il ventilatore ripristina l'alimentazione di gas dopo 6 secondi e riavvia quindi la ventilazione dopo altri 2 secondi dal ripristino del gas. L'allarme "Soglia di alta pressione superata" suona finché la condizione non viene cancellata. Se il ventilatore incontra le stesse condizioni dopo il riavvio della ventilazione, viene ripetuto il ciclo.

18.5.5 Funzionamento dell'allarme di soglia di bassa pressione

Nota: l'utente deve ricordare che, nella ventilazione convenzionale, l'auto-track della soglia di allarme bassa può scendere solo fino a 1 mbar. Se l'utente desidera impostare l'allarme su un valore inferiore a 1 mbar deve farlo manualmente. Se la soglia di allarme viene impostata manualmente su un valore inferiore a 1 mbar e si effettua la regolazione di un parametro correlato alla pressione, la soglia di allarme bassa viene riportata a 1 mbar o alla soglia stabilita dalla pressione CPAP. L'utente deve quindi procedere nuovamente alla regolazione manuale della soglia di allarme sul valore desiderato.


Avvertenza: se l'utente imposta la soglia di allarme basso su un valore inferiore a 1 mbar, il ventilatore non sarà in grado di rilevare una disconnessione del circuito paziente del seguente tipo: disconnessione della sezione inspiratoria, compreso il limitatore colorato, dal collettore endotracheale. (In questo caso l'allarme basso non viene attivato in quanto è impostato su un valore minore o uguale a 0 mbar, e anche l'allarme di perdita non si attiva in quanto il limitatore è ancora sulla sezione inspiratoria.

Il ventilatore non rileva istantaneamente anche una disconnessione del tubo endotracheale dal sensore di flusso, se l'allarme basso è impostato su un valore minore o uguale a 0 mbar. Il ventilatore attiva dopo 20 secondi l'allarme "Breath Not Detected" (Respiro non rilevato).

18.6 Circuiti paziente, umidificazione e terapia con ossido nitrico

18.6.1 Ventilazione invasiva e camere di umidificazione ad alimentazione automatica

Quando si utilizza il ventilatore nella ventilazione invasiva con camere di umidificazione ad alimentazione automatica, la sacca dell'acqua deve essere montata a un'altezza superiore alla Delta P massima o alla Max PIP impiegata.

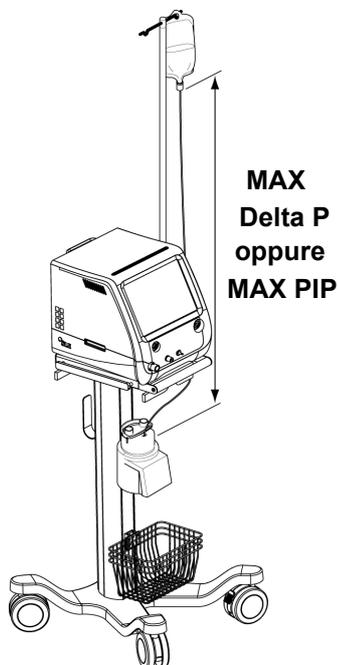

Nota: assicurarsi che la linea di alimentazione della camera di umidificazione ad alimentazione automatica sia primerizzata dall'acqua motrice attraverso la linea di alimentazione nella camera.

Nota: per modalità non invasive montare la sacca il più in alto possibile. Se la sacca si gonfia a causa di pressioni CPAP più elevate, rilasciare la pressione a intervalli regolari.

Per calcolare l'altezza approssimativa della sacca dell'acqua, usare la formula di conversione seguente:

1 mbar = 1 cm, aggiungere quindi 25 cm all'altezza calcolata per ottenere l'altezza finale della sacca.

Il montaggio della sacca a un'altezza inferiore, potrebbe consentire al ventilatore di pressurizzarla, impedendo così il riempimento della camera con l'acqua. Inoltre, la sacca a sua volta pressurizza la camera, la qual cosa può causare l'attivazione degli allarmi di pressione alta o prolungata.

18.6.2 Ventilazione non invasiva e camere di umidificazione ad alimentazione automatica

Quando si utilizza il ventilatore nella ventilazione non invasiva con le camere di umidificazione ad alimentazione automatica la sacca dell'acqua deve essere montata il più alta possibile. Se la sacca si gonfia a causa di pressioni CPAP più alte, rilasciare regolarmente la pressione dalla sacca.

18.6.3 Terapia con ossido nitrico

Quando il ventilatore viene usato insieme a un sistema di erogazione di ossido nitrico per inalazione, richiede due filtri per evitare lo scarico di ossido nitrico (N. parte SLE N4110, connessi in parallelo con il gruppo tubo di scarico doppio, N. parte SLE N4110/10) montati sul blocco di esalazione (rimuovere il silenziatore). Tutte queste parti sono fornite in un kit completo (N. parte SLE N4110/20). Il flusso del gas di scarico supera la capacità di un solo filtro per evitare lo scarico di ossido nitrico.

Gruppo tubo di scarico doppio N. parte SLE: N4110/10



Blocco di esalazione

Filtro per evitare lo scarico di ossido nitrico
N. parte SLE: N4110

Attenzione: dopo aver usato il ventilatore con un dispositivo per terapia con ossido nitrico, risciacquare il blocco di esalazione con acqua prima delle operazioni di pulizia, disinfezione o sterilizzazione in autoclave. Ciò serve a rimuovere eventuali depositi di ossido nitrico, che, durante la sterilizzazione in autoclave con vapore, potrebbero reagire con l'acqua portando alla formazione di acido nitroso o di acido nitrico.

Avvertenza: l'uso del ventilatore con un solo filtro N4110 per evitare lo scarico (montato direttamente sulla porta di scarico) determina la formazione di una contropressione e un leggero rialzo delle letture di pressione.

18.6.4 Erogazione di farmaci per aerosol

18.6.4.1 Erogazione di farmaci per aerosol con Aerogen®

Avviso: utilizzare solo il controller USB Aerogen® con SLE6000.

Avvertenza: utilizzare solo dispositivi per l'erogazione di farmaci per aerosol ultrasonica con SLE6000.

Un nebulizzatore pneumatico provocherà un aumento di pressione nel tratto inspiratorio del circuito, causando un allarme "Blocco gas".

Avvertenza: non utilizzare il sensore di flussodurante l'erogazione di farmaci per aerosol.

Quando si utilizza il ventilatore con areosol, questo deve essere utilizzato come dispositivo a pressione limitata time cycled rimuovendo il sensore di flusso.

La rimozione del sensore di flusso dal collettore endotracheale quando è ancora collegato al ventilatore non è consigliabile, in quanto attiva l'allarme "Respiro non rilevato" e può coprire altre condizioni di allarme che potrebbero insorgere.

Attenzione: leggere e studiare tutte le istruzioni fornite con il controller USB Aerogen®.

- 1 Effettuare un test funzionale del nebulizzatore Aerogen® prima dell'uso, come descritto nelle Istruzioni per l'uso di Aerogen®.
- 2 Collegare il nebulizzatore Aerogen® Solo o Aerogen® Pro premendo bene il boccaglio a T.
- 3 Collegare il controller USB Aerogen® al nebulizzatore.
- 4 Inserire il nebulizzatore e il boccaglio a T nel circuito di respirazione.
- 5 Il controller USB Aerogen® per l'uso con Aerogen® Solo è dotato della porta per controller Aerogen® situata sul retro del ventilatore.



Nota: il controller USB Aerogen® può essere azionato solo da una porta USB su qualsiasi dispositivo medico elettrico approvato in base a IEC/EN 60601-1 o adattatore CA/CC del controller USB Aerogen.

- 6 Aprire il tappo sul nebulizzatore e utilizzare un'ampolla o una siringa pre-riempita per aggiungere il farmaco al nebulizzatore, quindi chiudere il tappo.

Nota: per evitare danni ad Aerogen® Solo, non utilizzare siringhe con ago.

- 7 Per funzionare in modalità 30 Minuti, premere una volta il pulsante On/Off.
- 8 Per funzionare in modalità 6 Ore, premere il pulsante On/Off dalla modalità off per >3 secondi.
- 9 Verificare che sia selezionata la modalità di funzionamento corretta.
- 10 Verificare che l'aerosol sia visibile.
- 11 Quando la nebulizzazione è completa, staccare Aerogen® Solo e il controller USB dal circuito.
- 12 Calibrare e sostituire il sensore di flusso se necessario.

18.7 Uso del ventilatore SLE6000 con i compressori ad aria medici SLE500E e SLE500S

Attenzione: quando si utilizza il ventilatore SLE6000 insieme ai compressori ad aria medici SLE500E o SLE500S l'utente deve sapere che le prestazioni HFO sono limitate.

Il flusso massimo dei compressori ad aria medici SLE500E o SLE500S è 60 l/min mentre il ventilatore SLE6000 richiede 85 l/min. Questa disparità sarà evidente solo in modalità HFO dove le pressioni Delta P superiori a 150 mbar rendono la MAP (mean airway pressure) instabile.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Descrizione dell'interfaccia utente

“Modalità Attesa” a pagina 128

“Modalità di ventilazione” a pagina 140




19. Descrizione dell'interfaccia utente

Nella presente sezione vengono descritte tutte le funzioni dell'interfaccia utente. Il capitolo è diviso in due sezioni, la prima modalità Attesa e la seconda modalità Ventilazione. La modalità Attesa descrive la funzione dell'interfaccia utente mentre in modalità Attesa e in modalità Ventilazione con le differenze in modalità ventilatoria.

19.1 Modalità Attesa

Subito dopo l'accensione del ventilatore, la prima schermata presentata all'utente sarà "Attesa".

Avvertenza. In modalità "Attesa". Il ventilatore non fornisce il supporto paziente e tutti gli allarmi paziente sono inattivi. Il pannello informazioni presenta l'affermazione "Attesa: paziente non ventilato".

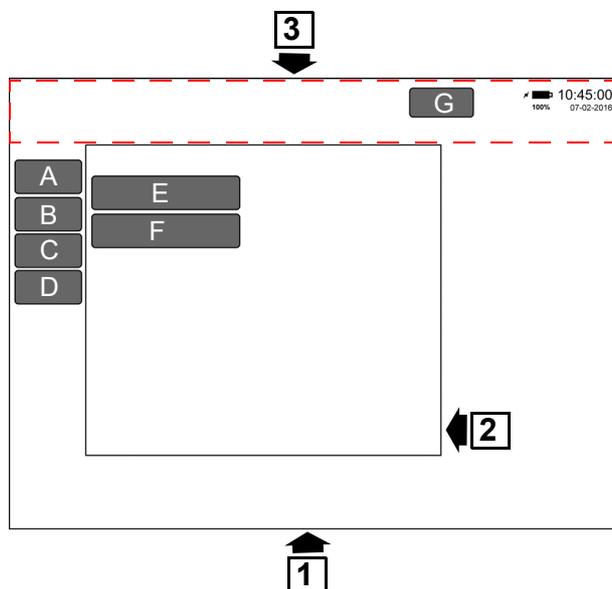

- 1 Interfaccia utente
2. Pannello informazioni
3. Barra delle informazioni
- A. Pulsante Modalità (Pulsante Controllo)
- B. Pulsante Allarmi (Pulsante Controllo)
- C. Pulsante Strumenti (Pulsante Controllo)
- D. Pulsante Grafici (Pulsante Controllo)
- E. Pulsante Avvia/riprendi ventilazione
- F. Pulsante Calibrazione e utenze
- G. Pulsante Multifunzione

19.1.1 Interfaccia utente (1)

Il display attivo è noto come interfaccia utente. A parte i pulsanti ON/OFF tutti gli altri controlli sono nell'interfaccia utente. Tutti i comandi sono touch e richiedono un singolo tocco per funzionare.

19.1.2 Pannello informazioni (2)

Il pannello informazioni mostrerà le informazioni e tutte le funzioni ventilatorie associate.

19.1.3 Barra informazioni (3)

La barra informazioni è un'area riservata presente sulla parte superiore dell'interfaccia utente che mostra i messaggi di allarme, ora e data e le spie di alimentazione. Contiene inoltre il comando per la pausa audio dell'allarme da 120 secondi e un pulsante multifunzione.

19.1.4 Pulsante generico/funzioni pannello

19.1.4.1 Funzioni pannello

Premendo lo stesso pulsante di controllo che ha aperto il pannello, questo chiuderà il pannello premendolo di nuovo.

Premendo un altro pulsante controllo si chiuderà il pannello corrente e si aprirà il pannello associato dell'ultimo pulsante premuto. Non verranno apportate modifiche al menu originale.

Premendo il pulsante 'X' nell'angolo in alto a destra del menu se richiesto, si chiuderà il menu. Nessuna modifica sarà salvata.



19.1.4.2 Scadenza parametro

Se il ventilatore è in modalità ventilazione e l'utente non interagisce con il controllo per 15 secondi, il controllo sarà deselezionato e non verranno apportate modifiche.

19.1.4.3 Scadenza pannello

Se l'utente non interagisce con il menu per 120 secondi, la finestra si chiuderà automaticamente e nessuna modifica sarà salvata.

19.1.4.4 Stati Pulsante

Tutti pulsanti hanno due stati, Disponibile e Selezionato. Un pulsante selezionato è Bianco. Un pulsante disponibile è grigio scuro.



19.1.4.5 Pulsante Modalità (A)

Questo pulsante seleziona i pannelli secondari della modalità, Invasiva, Non Invasiva e Attesa.

19.1.4.6 Pulsante Avvia/Riprendi ventilazione (E)

Il pulsante modalità consente all'utente di selezionare una modalità di ventilazione.

19.1.4.7 Allarmi (B)

Questo pulsante non è funzionante in modalità attesa. Quando premuto, visualizzerà il pannello secondario degli allarmi con i valori predefiniti o di fabbrica impostati dall'utente.

19.1.4.8 Pulsante Strumenti (C)

Questo pulsante seleziona i seguenti pannelli secondari: Sensori (vedere "Scheda Sensori (senza sensori esterni)" a pagina 131)

Luminosità (vedere "Scheda Luminosità" a pagina 131)

Sistema (vedere "Scheda Sistema" a pagina 132)

Dati (vedere "Scheda Dati" a pagina 133)

19.1.4.9 Pulsante Calibrazione e Strumenti (F)

Questo ha la stessa funzione del pulsante Strumenti (C).

19.1.4.10 Pulsante Grafici (D)

Questo pulsante seleziona il pannello secondario grafico. In modalità attesa è possibile selezionare solo gli andamenti. (vedere "Scheda Grafici" a pagina 135)

19.1.4.11 Pulsante Multifunzione (G)

Questo pulsante ha le seguenti funzioni:


Blocca/Sblocca schermata. (Vedere sezione 19.2.13 a pagina 144).

Ripristino allarme e riconoscimento allarme. (Vedere sezione 19.1.6 a pagina 129)

Nota: il pulsante multifunzione cambia anche la forma quando attivato per la condizione di allarme Continuare senza misura di flusso.

19.1.5 Pulsante Modalità e Avvia/Riprendi ventilazione

Toccando il pulsante (A o B) si attivano le schede di selezione della modalità.




Il pannello Modalità presenta tre schede disponibili: Invasiva, Non invasiva e Attesa.

Nota: la scheda standby è disponibile, ma non funzionante in modalità attesa.

Nota: la modalità che verrà evidenziata varierà a seconda se il ventilatore è impostato in preferenze impostate dall'utente, impostazioni di fabbrica o l'ultima modalità selezionata.


Selezionare la modalità richiesta dall'area (1) e quindi premere il pulsante "Conferma" (C) per selezionare.

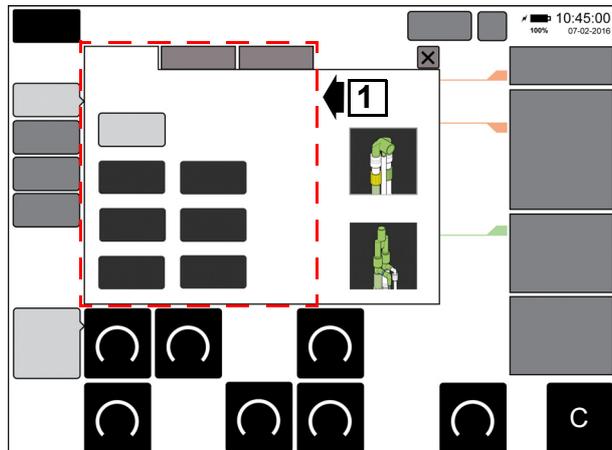


Vedere sezione 19.2 a pagina 140 per le descrizioni relative alla modalità.

19.1.6 Pulsante Allarme

Toccando il pulsante "Allarme" (D) si attivano le schede Allarme.




Il pannello Allarme ha tre schede disponibili: Limiti (E), Registro (F) e Volume (G).

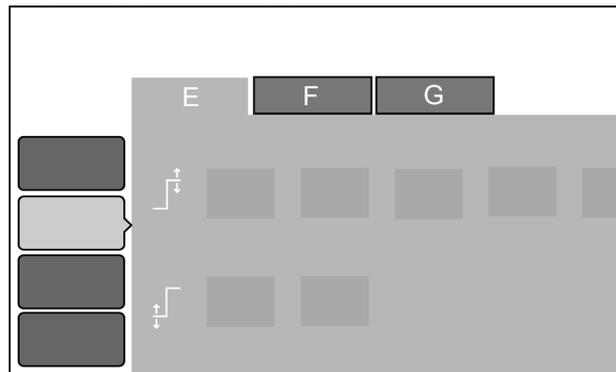

La scheda predefinita è Limiti (E)

19.1.6.1 Scheda Limiti


La scheda Limiti mostra tutte le soglie di allarme disponibili.

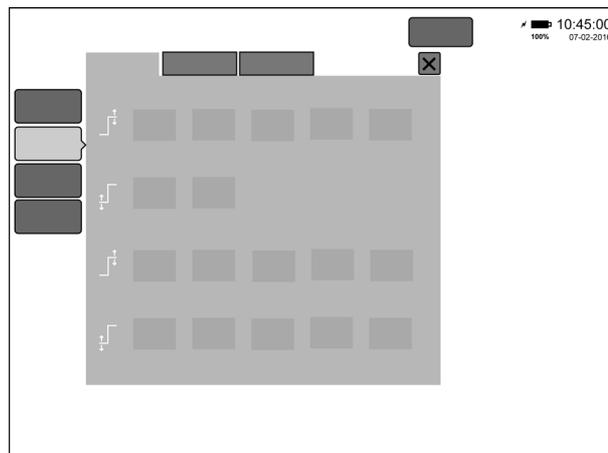

Nota: la scheda Limiti non è funzionante in modalità attesa.

19.1.6.2 Scheda Registro

La scheda Registro mostra gli ultimi 1000 eventi di allarme.

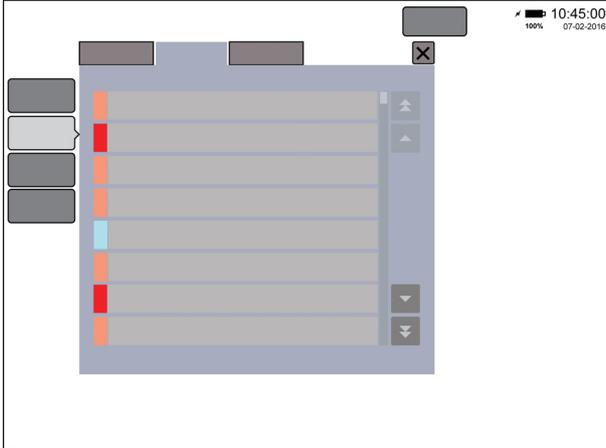

La scheda mostra le seguenti informazioni per ciascun evento di allarme.

Priorità - Indicata dal colore. Rosso-Alta, Giallo-Media, Blu-Bassa.

Ora - hh/mm

Data - GG/MM/AAAA o MM/GG/AAAA

Durata in ore, minuti e secondi

Valori - non funzionali in questa versione del software.

Limite - impostazione di allarme


Non ric - Indicatore per il riconoscimento utente dell'allarme al momento dell'attivazione

Il registro allarmi può essere visualizzata utilizzando le frecce di scorrimento sul lato destro del registro. La freccia singola indica lo scorrimento lento, la freccia doppia lo scorrimento veloce. Quando all'inizio o alla fine dell'elenco l'utente sarà in grado di selezionare solo le frecce che scorrono nei messaggi di allarme.



19.1.6.3 Scheda Volume

La scheda Tono consente all'utente di regolare il volume del segnalatore acustico. L'impostazione predefinita è al 60%.

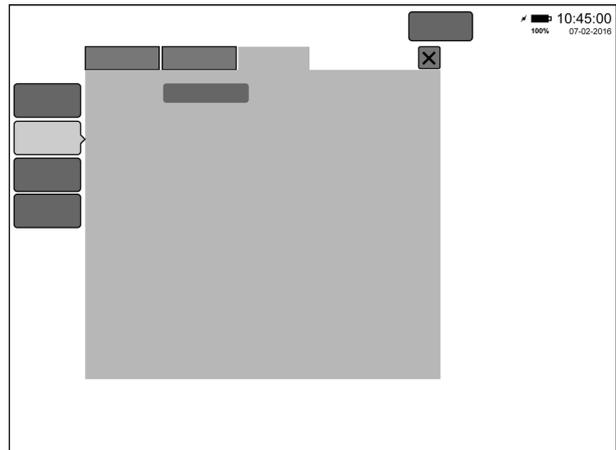


Il controllo è limitato a incrementi del 20%.

Impostazioni minima 20% massima 100%.


Nota: l'impostazione utente viene ripristinata al 60% all'accensione.

19.1.7 Pulsante Strumenti & Calibrazione & Strumenti

Toccando il pulsante "Strumenti" (H) o il pulsante "Calibrazione e Strumenti" (J) si attiva la scheda Utenza.

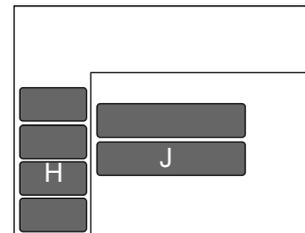


Il pannello Utenza ha quattro schede disponibili: Sensori (K), Luminosità (L), Sistema (M) e Dati (N).

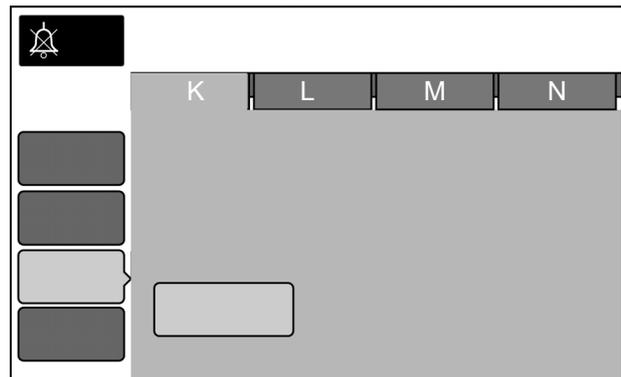

19.1.7.1 Scheda Sensori (senza sensori esterni)

La scheda Sensore consente all'utente di calibrare il sensore di flusso o di effettuare la calibrazione O2 a un punto.

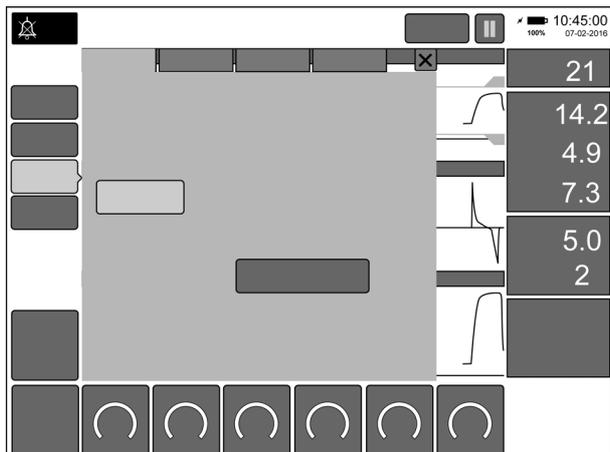


Nota: quando il sensore di flusso è collegato, il pulsante di calibrazione del sensore di flusso è selezionato per impostazione predefinita. Quando si utilizza il ventilatore senza il sensore di flusso, solo la calibrazione O2 a un punto è selezionata per impostazione predefinita.

Nota: l'ultima calibrazione di data e ora sarà visualizzata sul pulsante.


19.1.7.2 Scheda Sensori (con sensori esterni)

La scheda Sensore consente all'utente di calibrare il sensore di flusso o di effettuare la calibrazione O2 a un punto.

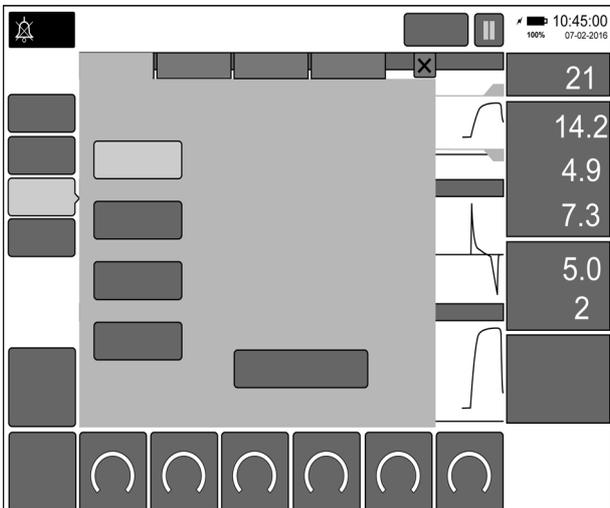

19.1.7.3 Scheda Luminosità

La scheda Luminosità consente all'utente di selezionare la modalità Giorno o Notte e di impostare la luminosità dello schermo per queste modalità.

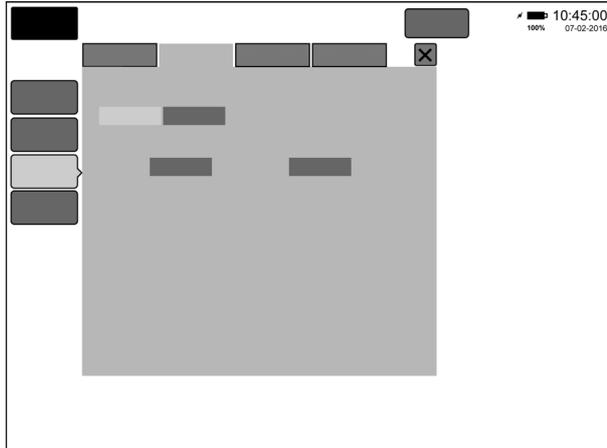

L'utente ha modificato l'impostazione della percentuale di luminosità impostata per ogni modalità come dichiarato in basso.

Modalità giorno: l'impostazione predefinita al 70% (Campo dal 30% al 100%)

Modalità notte: l'impostazione predefinita al 30% (Campo dal 20% al 60%).


Nota: la modalità giorno può essere ridotta del 10% al di sopra dell'impostazione della modalità notte. La modalità notte può essere incrementata del 10% al di sotto dell'impostazione modalità giorno.

Nota: la modalità Notte viene automaticamente annullata all'attivazione dell'allarme.

19.1.7.4 Scheda Sistema

La scheda Sistema consente all'utente di selezionare dalle seguenti funzioni relative al sistema:

- Imposta data e ora (O)
- Preferenze operatore (P)
- Modalità ingegneristica (Q)
- Informazioni di sistema (R)
- Calibrazione schermo (S)
- Aggiornamento di sistema (T)

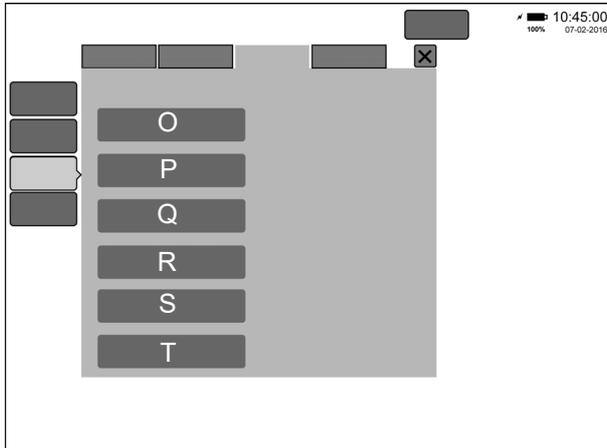


19.1.7.4.1 Imposta data e ora

Il pulsante Imposta data e ora (O) consente all'utente di impostare la data e l'ora per il ventilatore.

Nota: risparmio Giorno deve essere manualmente impostato dall'utente quando richiesto.


1. Impostare la data e il formato data
2. Impostare l'ora.

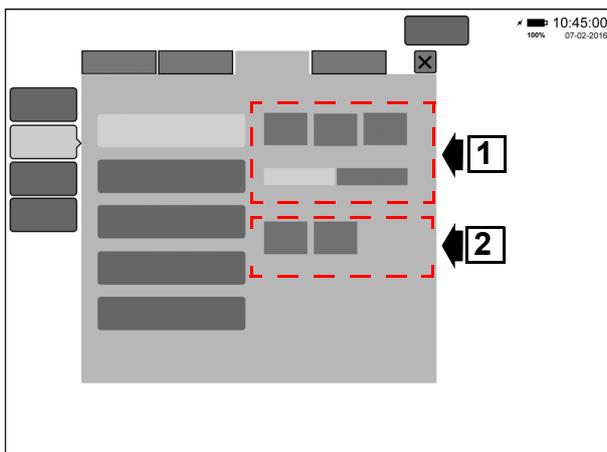

Nota: il formato data e ora predefinito può essere impostato da preferenze operatore.

19.1.7.4.2 Preferenze operatore

Il pulsante Preferenze operatore (P) consente all'utente di impostare l'avvio con i valori predefiniti per il ventilatore.

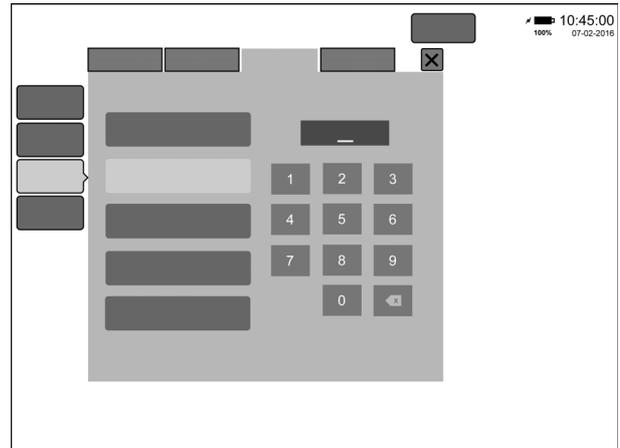


L'accesso alle preferenze utente richiede l'inserimento del codice di sicurezza.

Vedere "Preferenze operatore" a pagina 266 per una descrizione dettagliata.

19.1.7.4.3 Modalità Ingegnistica

Il pulsante Modalità Ingegnistica (Q) consente al tecnico dell'assistenza di accedere alle funzioni di impostazione e calibrazione.

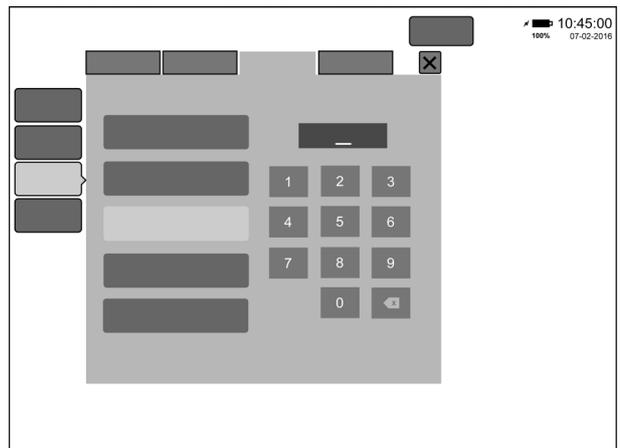

Attenzione. L'accesso alla modalità tecnico è consentito esclusivamente per il personale dell'assistenza formato. Per informazioni sulla modalità Ingegnistica, consultare il manuale di assistenza. Vedere il capitolo '45. Parti consumabili e accessori' a pagina 280 per il numero di pezzo del manuale di assistenza.

19.1.7.4.4 Informazioni di sistema


Il pulsante informazioni di sistema (R) mostra le informazioni sul sistema del ventilatore.

I numeri di versione del sottosistema sono utilizzati per determinare la versione generale del software che è visualizzato su questo pannello. Vedere il capitolo '35. Identificazione della versione software' a pagina 241 per ulteriori informazioni sulla versione software.

Nota: Mostra scheda CPU vitali, Tempo trascorso dall'ultimo intervento e le pressioni gas di ingresso sono principalmente per l'uso del personale di assistenza.

19.1.7.4.5 Calibrazione schermo

Il pulsante calibrazione schermo (S) consente al tecnico dell'assistenza di ricalibrare il touchscreen.

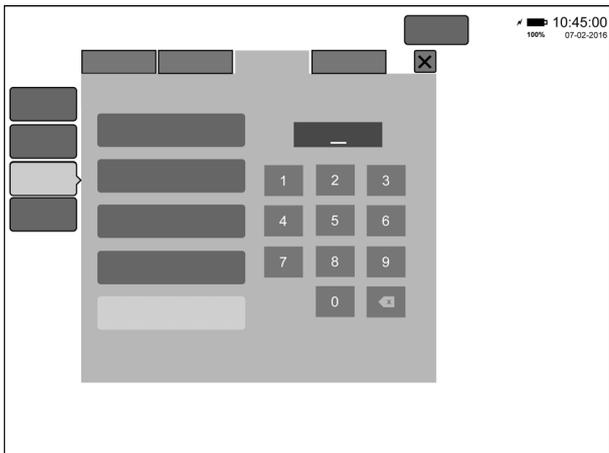


Attenzione. l'accesso alla calibrazione schermo è consentito esclusivamente per il personale dell'assistenza formato. Per informazioni sulla calibrazione schermo, consultare il manuale di assistenza. Vedere il capitolo '45. Parti consumabili e accessori' a pagina 280 per il numero di pezzo del manuale di assistenza.

Avvertenza. La calibrazione non corretta del touchscreen renderà il ventilatore inutilizzabile.

19.1.7.4.6 Aggiornamento di sistema

Il pulsante Aggiornamento di sistema (T) consente al tecnico dell'assistenza di ricalibrare il software dei ventilatori.

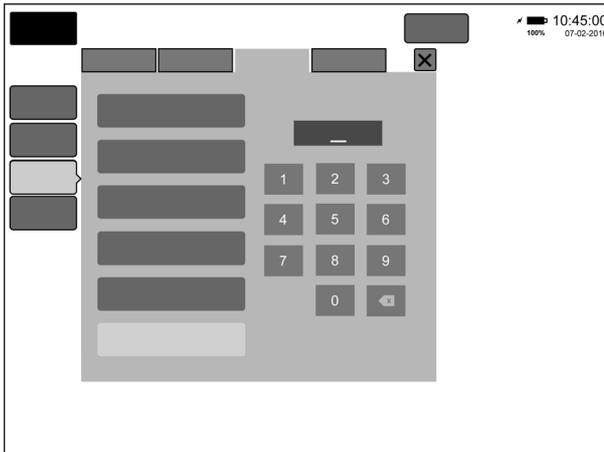


Nota: questo pulsante è disponibile solo nel software Versione 1.0.43 o superiore.

Attenzione. l'accesso alla funzione di aggiornamento software è consentito esclusivamente per il personale dell'assistenza formato. Per informazioni sull'Aggiornamento software consultare il manuale dell'assistenza. Vedere il capitolo '45. Parti consumabili e accessori' a pagina 280 per il numero di pezzo del manuale di assistenza.

19.1.7.5 Scheda Dati

La scheda dati consente all'utente di selezionare dalle seguenti funzioni relative all'esportazione:

- Dati paziente (U)
- Log eventi (V)
- Foto schermata (W)

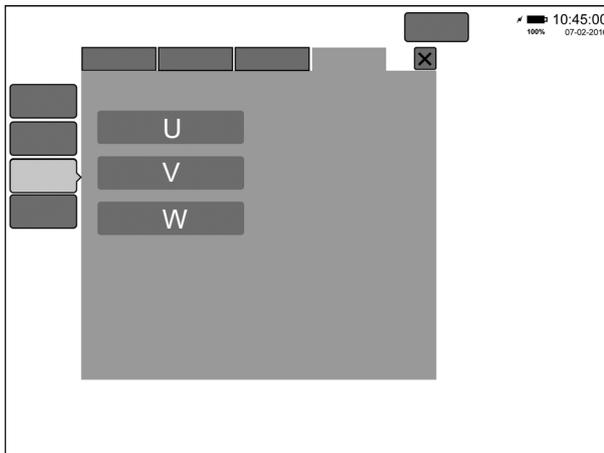

19.1.7.5.1 Dati paziente

Il pulsante log pazienti esporta Andamenti pazienti, Forme d'onda, Log allarmi e Registro Eventi Allarmi. Premendo il pulsante (U) verrà visualizzato il pulsante "Avvia esportazione". Se è presente una memoria USB, il pulsante sarà attivo. Vedere "Software Log viewer eventi e pazienti SLE 6000" a pagina 270 per maggiori informazioni.

19.1.7.5.2 Registro Eventi Allarmi

Il pulsante log eventi consente di esportare il Registro Eventi Allarmi.

Premendo il pulsante (V) verrà visualizzato il pulsante "Avvia esportazione". Se è presente una memoria USB, il pulsante sarà attivo. Vedere "Software Log viewer eventi e pazienti SLE 6000" a pagina 270 per maggiori informazioni.

19.1.7.5.3 Foto schermata

Il pulsante Foto schermata esporta le ultime 10 foto schermata.


Premendo il pulsante (V) verrà visualizzato il pulsante "Avvia esportazione". Se è presente una memoria USB, il pulsante sarà attivo.

Vedere come effettuare foto schermata nella sezione '19.2.15 Foto schermata' a pagina 144.


19.1.7.6 Download foto schermata

Accendere il ventilatore e attendere che entri in modalità Attesa.


Inserire una chiavetta di memoria USB nella porta dati sul retro del ventilatore.

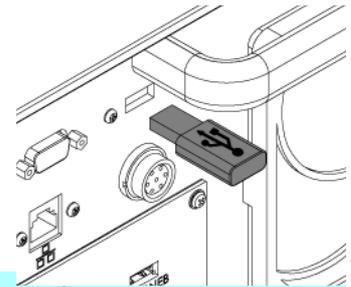


Nota: ci sono due porte USB sul retro del ventilatore. Utilizzare la porta indicata (Esportazione dati).

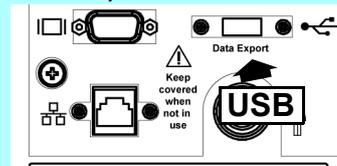

Attivare la scheda Strumenti (1) e selezionare la scheda Dati (2).

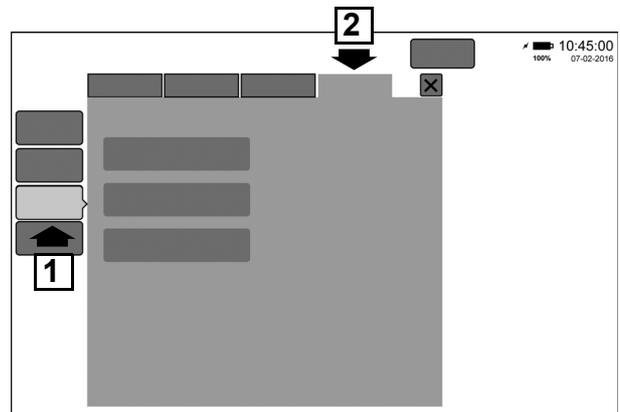

Selezionare il pulsante Foto schermata

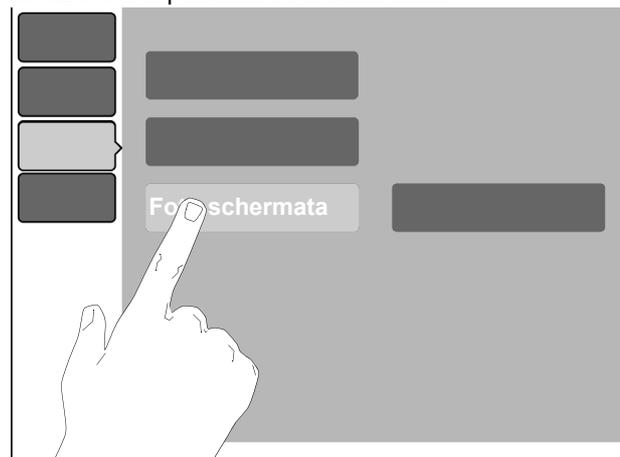

Selezionando il pulsante Foto schermate, il pulsante "Avvia esportazione" diventa attivo. Premere il pulsante per avviare l'esportazione nella memoria USB.



Il ventilatore mostrerà una barra di avanzamento durante il processo di esportazione, oltre al pulsante annulla che consente all'utente di terminare il processo di esportazione.



Una volta terminato, il ventilatore indicherà che l'esportazione dei dati era OK.

Rimuovere la memoria USB dal ventilatore.

SLE6000 crea una cartella con un numero identificativo che è unico per ogni ventilatore.

Esempio: ID ventilatore 1001453795

All'interno della cartella, l'utente troverà i file bitmap esportati.

Ogni file ha un prefisso con la data seguito da un codice seriale e dal tipo di file.

Esempio:

16_03_31_55929_ScreenCapture_00.bmp

Nota: il ventilatore non sovrascrive i file esistenti, ma crea nuovi file con un codice seriale diverso.


Il ventilatore controlla che la memoria USB abbia uno spazio sufficiente per i nuovi file di esportazione. Se lo spazio libero non è sufficiente, il ventilatore mostrerà il seguente messaggio. "la chiavetta USB non ha spazio sufficiente. Spazio libero disponibile necessario, minimo XMB".

Nota: se l'utente esporta anche i dati pazienti o i log eventi questi verranno posizionati nella stessa cartella.

I bitmap possono essere visualizzati dalla maggior parte degli elaboratori di testo PC/MAC o applicazioni di visualizzazione di file.


19.1.8 Scheda Grafici

La scheda grafico consente all'utente di selezionare e configurare i grafici Forme d'onda (W), Loop (X) e Andamento (Y) e SpO₂ (Z) prima di entrare nella modalità ventilatoria.

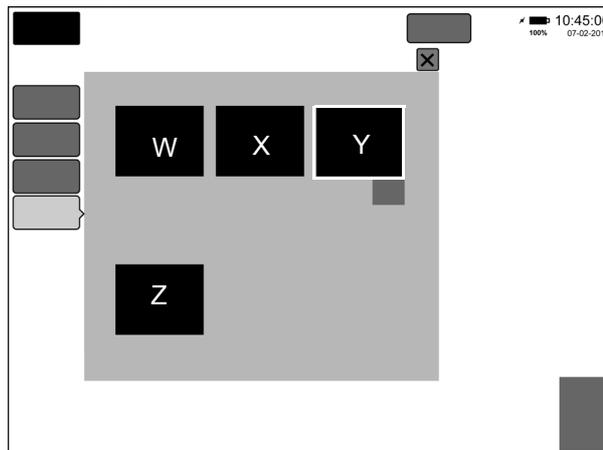

La selezione predefinita in modalità Attesa è Andamenti. Per visualizzare gli andamenti in modalità Attesa, premere il pulsante Layout e quindi il pulsante conferma.

Per modificare uno dei formati layout, toccare il grafico richiesto. Verrà visualizzato il pulsante modifica.

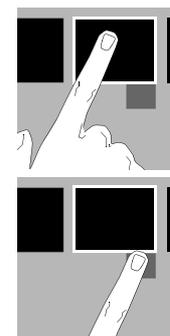

Premere il pulsante modifica per entrare nel pannello del grafico selezionato.

Nota: il ventilatore registrerà l'ultima selezione di grafico e la imposterà come sessione predefinita.

19.1.8.1 Forme d'onda

Il pannello forme d'onda consente all'utente di configurare il pannello forme d'onda in modalità ventilatoria.

Nota: il pannello forme d'onda configurato non è visibile in modalità Attesa.

Nota: quando il sensore di flusso non è collegato al pannello, mostrerà solo la forma d'onda di pressione come impostazione predefinita.

L'utente può disattivare due delle tre forme d'onda disponibili. Le forme d'onda disponibili sono:

Pressione (Predefinita On)


Flusso (Predefinito On)

Volume (Predefinito On)

L'utente può inoltre modificare lo stile degli andamenti visualizzati.

Riempito - quando attivo riempie le forme d'onda con il colore.

Sfondo- quando attivo applica una griglia basata sul tempo nello sfondo di tutte le forme d'onda.

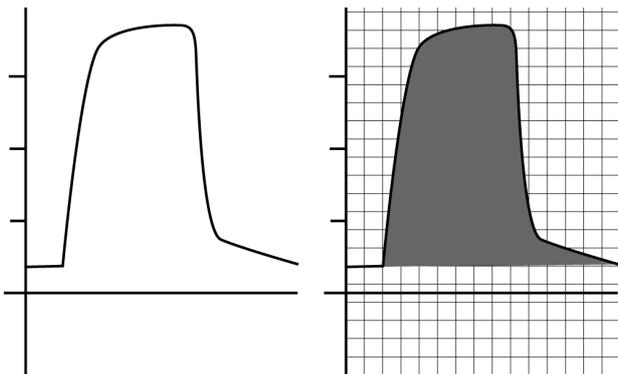


19.1.8.2 Loop

Il pannello Loop consente all'utente di configurare il pannello di forma d'onda in modalità ventilatoria.

Nota: il pannello forme d'onda configurato dai loop non è visibile in modalità Attesa.

Nota: quando il sensore di flusso non è collegato, il pannello mostrerà solo la forma d'onda della pressione come predefinita.

Il pannello Forma d'onda viene configurato quando i loop sono selezionati in 1 forma d'onda (1), 1 loop principale (2) e 1 loop secondario (3).

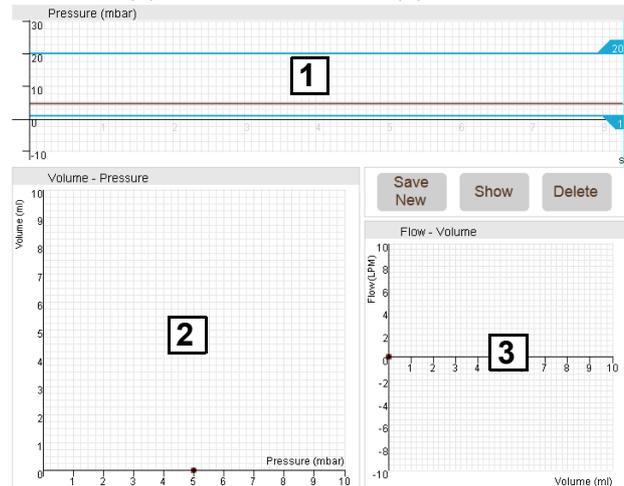

La forma d'onda (1) può essere configurata per visualizzare.

Pressione (Predefinita)

Flusso

Volume

Il loop principale (2) può essere configurato per visualizzare.

Flusso contro Volume - F/V

Flusso contro Pressione - F/P

Volume contro pressione - V/P (predefinito)

Il loop secondario (3) può essere configurato per visualizzare.

Flusso controllo Volume - F/V (predefinito)

Flusso contro Pressione - F/P


Volume contro pressione - V/P

19.1.9 Cattura, recupero ed eliminazione dei loop.


19.1.9.1 Per acquisire i Loop

Nella finestra della forma d'onda principale saranno visualizzati due loop, quello primario e quello secondario.

Premere il pulsante "Salva". I loop correnti sono salvati. Il ventilatore mostrerà l'ora e la data quando i loop vengono salvati nella memoria nella parte superiore di ciascun loop.

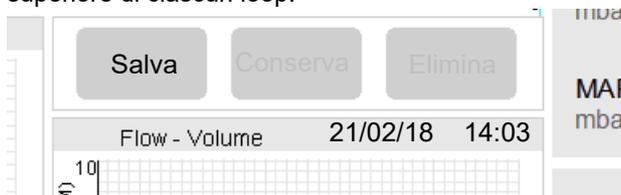


Due nuovi pulsanti diventano attivi "Archivia" e "Elimina".

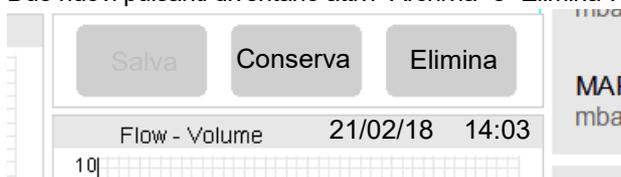

Premere "Elimina" per cancellare i loop archiviati l'utente ritornerà al pulsante "Salva" iniziale.

Premere il pulsante "Archivia" per salvare i loop. Premendo il pulsante "Archivia" compariranno i due nuovi pulsanti.

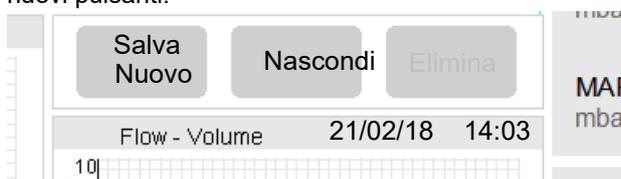

I loop salvati sono mostrati in bianco.

Nota: quando si consulta un loop archiviato i loop attivi vengono visualizzati con linee blu.

Premendo "Nascondi" si rimuove il loop salvato dalle aree di visualizzazione del loop. I due nuovi pulsanti "Mostra" e "Elimina" diventano attivi.



Premere "Mostra" per recuperare e visualizzare i loop salvati.

Premere "Elimina" per cancellare il loop salvato dalla memoria.

Nota: l'utente non riesce a visualizzare il loop da eliminare.

Premendo "Salva nuovo" i loop correnti sono salvati e i pulsanti "Archivia" ed "Elimina" compariranno

di nuovo.

19.1.9.2 Trend

Gli andamenti sono l'unica opzione che verrà visualizzata in modalità Attesa.

L'utente ha la possibilità di visualizzare fino a otto andamenti simultaneamente in quattro linee del display. Ogni riga del display può mostrare un massimo di due andamenti.

Il ventilatore memorizza 14 giorni di dati sugli andamenti per ciascuno degli andamenti elencati in basso.

Il dati di andamento vengono conservati dopo lo spegnimento dell'unità o dopo la perdita totale di alimentazione.

Gli andamenti disponibili in ciascuna riga del display sono:

- O₂
- O₂ impostata
- PIP
- PEEP
- MAP
- CPAP
- ΔP
- Vte
- Vmin
- RR
- Trigger
- Resistenza
- Conformità
- DCO₂
- SpO₂
- SIQ

Nota: l'utente può visualizzare lo stesso trend due volte in una riga di visualizzazione. La selezione dei trend non è influenzata dalla connessione o dalla disconnessione del sensore di flusso.

La selezione predefinita per la modalità Attesa¹:

Riga display 1: PIP/PEEP

Riga display 2: O₂/Off

Riga display 3: MAP/Off


Riga display 4: Off/Off

Nota¹. I valori predefiniti per la riga 1 del display in modalità ventilatoria sono diversi. Il valore predefinito è Pressione (dal vivo)/Off. Pressione (dal vivo) non è un andamento, ma una forma d'onda di pressione in tempo reale.


Attenzione. L'impostazione dei valori predefiniti in modalità Attesa ignorerà i valori predefiniti degli andamenti della modalità ventilatoria. Se il trend è selezionato per Display riga 1, nessuna forma d'onda in tempo reale sarà visualizzata all'inserimento della modalità ventilatoria.

19.1.9.2.1 Impostazione andamenti predefiniti.

Dal pannello Modifica andamenti, selezionare la riga del display da modificare.

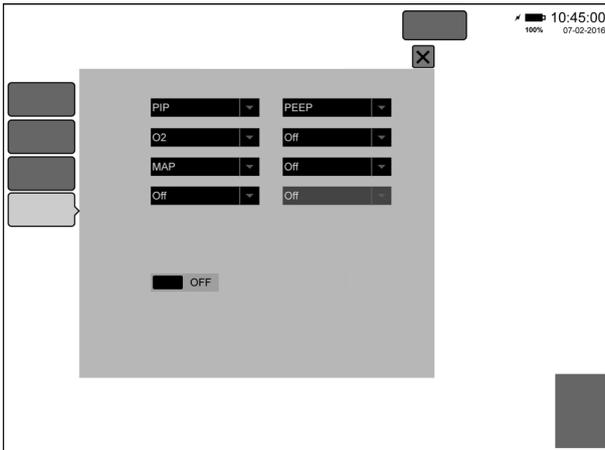

Questo attiverà il menu a discesa.

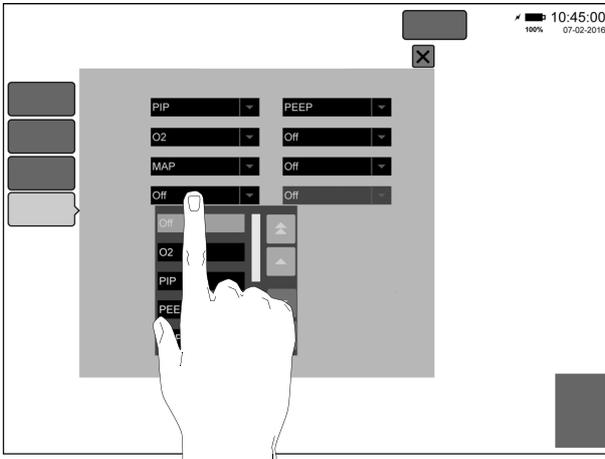

Il menu a discesa elenca tutti i dati sugli andamenti che è possibile visualizzare per tale riga.

L'utente può scorrere utilizzando il pulsante freccia singola (1).

L'utente può passare alla fine dell'elenco premendo il pulsante doppia freccia (2).



Quando l'utente si è allontanato dall'inizio dell'elenco, i pulsanti su (3 e 4) diventano attivi.

Toccare l'andamento richiesto da selezionare.

Ripetere il processo per le altre righe del display.

Per annullare la selezione, premere il pulsante Grafico.

Per confermare la selezione, premere il pulsante conferma.

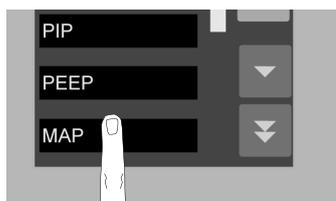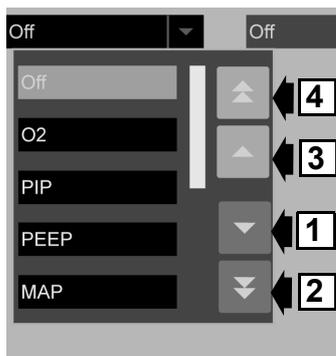

Il pannello Trend ha un comando relativo allo stile, Sfondo.



Sfondo (5) - quando attivo applica una griglia basata sull'ora nello sfondo di tutti gli andamenti.

19.1.9.3 Display andamento singolo e doppio

Quando è necessario un singolo andamento per la riga del display, la finestra dell'andamento visualizzerà l'andamento come riga blu. Quando i due andamenti sono visualizzati nella stessa riga del display, il secondo andamento è arancione e sovrapposto al primo.


19.1.9.4 Visualizzazione andamenti

Dopo l'impostazione delle viste richieste sugli andamenti, premere il pulsante conferma per visualizzare gli andamenti nelle finestre forme d'onda.

I controlli della vista sugli andamenti associati diventeranno attivi. Questi si trovano nell'angolo in basso a destra delle finestre forma d'onda.

Visualizzati come i pulsanti Zoom (A), Cursore (B) e Scorri (C). L'ora di avvio dell'andamento (D).

L'ingrandimento impostato dello zoom (E). La barra per individuare la finestra degli andamenti (F).

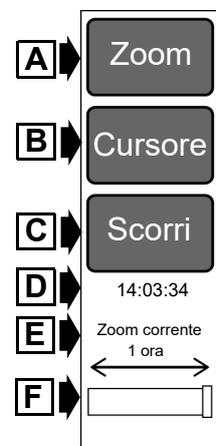


Quando si seleziona Zoom, Cursore o Scorri, la riga del cursore e la casella del valore di andamento diventa attiva per ogni finestra di andamento.

I valori visualizzati in ogni casella sono colorati e corrispondono all'andamento dello stesso colore per tale finestra.

I valori sono per i punti in cui la linea del cursore si interseca con la linea degli andamenti.

Se è stato selezionato un solo andamento per una finestra particolare, viene mostrato un solo valore.

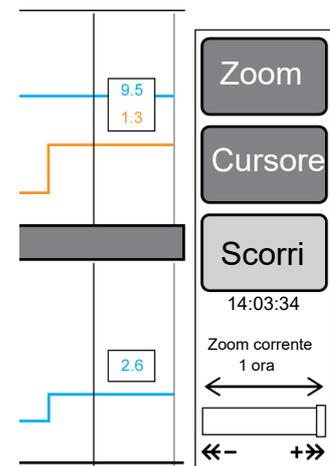

19.1.9.4.1 Zoom


La funzione Zoom aumenta o riduce l'ingrandimento della scala di tempo della finestra di andamento.

Il pulsante zoom quando toccato attiva i pulsanti più o meno.

I pulsanti più o meno sono utilizzati per aumentare/ridurre l'ingrandimento. Visualizzate sempre nella parte inferiore del pannello due icone che collegano i pulsanti più/meno al livello di ingrandimento.

La visualizzazione predefinita di tempo per tutte le finestre è di 1 ora. La riduzione di ingrandimento dello zoom è limitata alle fasi predefinite di 2, 4, 6, 9, 12 e 24 ore. L'incremento dello zoom è limitato alle fasi predefinite di 30 e 15 minuti.

Quando l'ingrandimento viene aumentato, il cursore nella barra di posizionamento della finestra di andamento aumenterà o diminuirà a seconda del periodo di zoom.



19.1.9.4.3 Cursore

La funzione cursore consente all'utente di spostare la riga del cursore attraverso la finestra di andamento visualizzato corrente.

Il pulsante Cursore quando toccato attiva i pulsanti più e meno. Visualizzate sempre nella parte inferiore del pannello ci sono due icone che collegano i pulsanti più/meno alla direzione di spostamento.

Spostando la riga del cursore oltre la fine della finestra, si sposterà la riga all'inizio della successiva finestra di tempo.

Le finestre di tempo sono comandate dallo Zoom.



19.1.9.4.2 Scorri

La funzione Scorri consente all'utente di spostare la riga del cursore nei 14 giorni di dati di andamento con l'ingrandimento impostato.

Il pulsante Scorri quando toccato attiva i pulsanti più e meno. Visualizzate sempre nella parte inferiore del pannello ci sono due icone che collegano i pulsanti più/meno alla direzione di spostamento.


Quando l'utente scorre nel registro degli andamenti, la barra di posizionamento delle finestre di andamento si sposta di conseguenza.

La data verrà visualizzata come inserita nei dati di andamento dei giorni precedenti.



19.2 Modalità di ventilazione

Lo scopo di questa sezione è descrivere l'interfaccia utente in termini generici salvo diversamente specificato

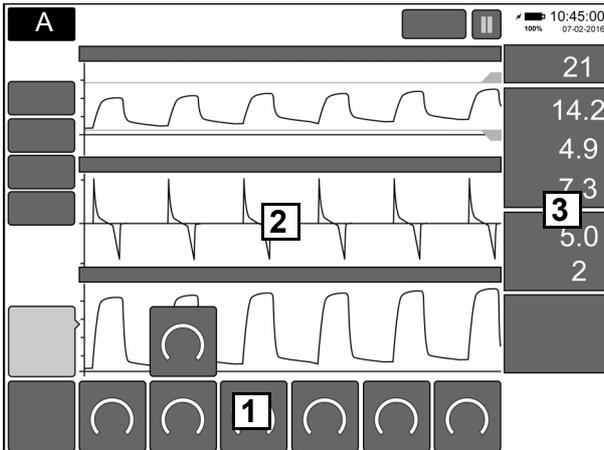

1. Parametri (principali e aggiuntivi)
2. Pannello Forme d'onda
3. Valori monitorati

Le altre aree sono quelle della modalità Attesa.

19.2.1 Pulsante silenziamento e pre-silenziamento allarme (A)

Il pulsante silenziamento/pre-silenziamento allarme consente all'utente di presilenziare tutti gli allarmi silenziabili che potrebbero essere generati oppure silenziare l'allarme paziente attivo.



Il periodo in cui il componente audio dell'allarme viene messo in pausa per entrambi gli scenari è 120 secondi. Il tempo di silenziamento arriva fino a zero (Il tempo viene visualizzato in minuti e secondi).



19.2.2 Parametri

19.2.2.1 Tipi di parametri

Controlli basati sul tempo [Blu]

RR, Ti, Per. Insp. Max, Frequenza, Rapporto I:E

Controlli Pressione/Volume [arancione]:

CPAP, PIP, PIP Max, MAP (in HFO), PEEP, VTV, ΔP (in HFO), Flusso/Gas fresco (terapia ossigeno)

Ossigeno [verde]

Parametri aggiuntivi [Blu]:

Fronte di salita, FR di backup, Sigh FR, Per. Insp Resp

Parametri aggiuntivi [bianco]:

Sensibilità del trigger, Sensibilità di fine flusso

Parametri aggiuntivi [arancione]

Supporto Press., Press. Resp. (in HFO)

19.2.2.2 Stati parametro

Tutti i parametri hanno tre stati, anteprema disponibile, modalità attiva disponibile e selezionata.

Il pulsante selezionato è bianco.

Il pulsante di anteprema disponibile è nero con un bordo bianco.

Il pulsante disponibile è grigio scuro.

19.2.2.3 Modifica di un parametro

Toccare il parametro richiesto.



Questo attiverà i pulsanti più/meno.




Utilizzare i pulsanti più/meno per regolare il parametro. Dopo la prima regolazione, comparirà il pulsante conferma.



Nota: se non viene intrapresa nessuna azione, la selezione viene annullata dopo 15 secondi.

Premere il pulsante conferma per accettare la modifica.

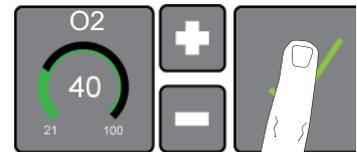

19.2.2.4 Accensione di una funzione parametro

Alcuni parametri sono inattivi fino a quando non vengono accesi. Qualsiasi parametro inattivo ha il testo OFF al centro della curva.



Tenere premuto il parametro per 2 secondi.



Verranno visualizzati i pulsanti più/meno e il pulsante conferma.




L'utente può regolare il parametro e quindi confermare l'impostazione oppure confermare solo l'attivazione del parametro e quindi regolare il parametro come precedentemente descritto nella sezione 19.2.2.3.

Nota: se non viene intrapresa nessuna azione, la selezione viene annullata dopo 15 secondi.

19.2.3 Modalità Anteprima

L'utente preme il pulsante Modalità e viene mostrato il pannello modalità.

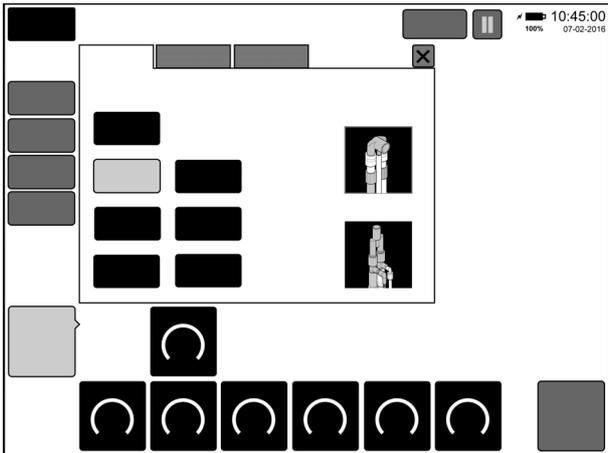

Per impostazione predefinita, la scheda Invasiva sarà selezionata all'avvio, a meno che l'utente non abbia pre-selezionato la scheda non invasiva come predefinita nelle preferenze operatore.

Se già in modalità ventilazione, premendo il pulsante modalità verrà mostrato il pannello modalità con la scheda associata della modalità corrente.

All'avvio, la modalità di ventilazione che è stata scelta nelle preferenze operatore sarà pre-selezionata. Per impostazione predefinita (impostazione di fabbrica) questa selezione verrà impostata nella 'scheda Invasiva'. Il pulsante modalità selezionata sarà nello stato 'Selezionato', gli altri nello stato 'Disponibile'.

L'utente seleziona la modalità ventilazione a scelta; I controlli della modalità selezionata saranno visualizzati all'interno del menu in modalità 'anteprima'.

Se già in modalità di ventilazione, le impostazioni saranno le stesse di quelle in modalità corrente, tutte le impostazioni sono comuni.

In modalità anteprima, il pulsante Conferma sarà sempre disponibile.

L'utente regola i parametri del ventilatore.

Preme il parametro da regolare.

Il parametro passa allo stato 'selezionato'.

L'utente utilizza i tasti più/meno per cambiare il valore del parametro.

L'utente preme un diverso parametro.

Il parametro precedentemente premuto ritorna alla modalità "disponibile", ma rimane con l'ultimo valore regolato. Il nuovo parametro passa allo stato "selezionato".

L'utente ripete il processo con gli altri parametri se richiesto.


Quando l'utente è pronto, premendo il pulsante conferma accetta tutte le modifiche ai controlli del parametro e attiva la modalità scelta.

La procedura in alto può essere utilizzata quando l'utente desidera modificare più di un parametro alla volta, rimanendo nella stessa modalità di ventilazione.

19.2.4 Selezione circuito paziente

Il pannello della modalità invasiva contiene due pulsanti che consentono all'utente di selezionare circuiti pazienti con diametro compreso tra 10 mm e 15 mm.

Circuito pazienti
10 mm




Per pazienti che richiedono volumi correnti inferiori a 50 ml utilizzare:

10 mm

Per pazienti che richiedono volumi correnti superiori a 50 ml utilizzare:

15 mm

15mm



Nota: la selezione dei circuiti pazienti da 15 mm è disponibile solo per la ventilazione invasiva. Passando alla ventilazione non invasiva si selezionano automaticamente i circuiti paziente da 10 mm.

19.2.5 Valori monitorati

19.2.5.1 Grafico colonna singola/colonna doppia

L'area dei valori monitorati sulla destra del grafico della forma d'onda presenta due opzioni di visualizzazione. Colonna singola con numeri grandi e colonna doppia con numeri più piccoli.

In modalità colonna singola, l'area mostra un massimo di 8 valori monitorati.

In modalità colonna doppia, l'area mostra un massimo di 16 valori monitorati.

21
14.2
4.9
7.3
5.0
2

19.2.5.1.1 Cambio di visualizzazioni


L'impostazione predefinita di fabbrica è a colonna singola. Il grafico predefinito è impostato dalle preferenze utente, vedere "Scheda Interfaccia" a pagina 268. Dalle preferenze operatore, l'utente può impostare il predefinito a doppia colonna.

Qualsiasi grafico viene selezionato, l'utente in modalità ventilatoria può cambiare modalità toccando il pannello per 1 secondo.

30	21
0.40	14.2
1.60	4.9
1.4	7.3
0.1	5.0
0.5	2

19.2.6 Scheda Allarmi - modalità ventilatoria

Selezionando il pannello degli allarmi, verranno mostrate tutte le soglie di allarme attive.

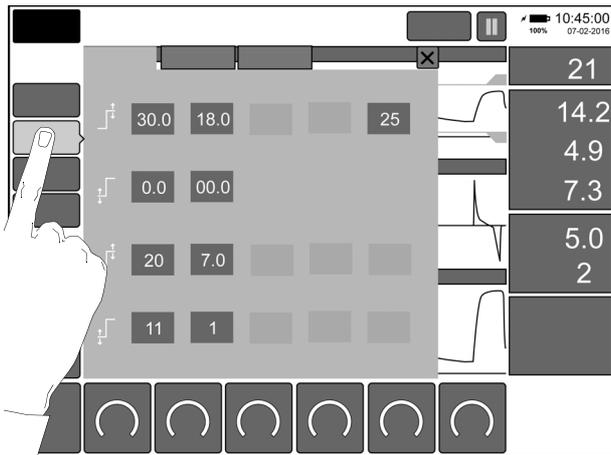

Il numero di soglie di allarme varia a seconda della modalità selezionata o del numero di sensori selezionati connessi.


Nota: la soglia di allarme traccia automaticamente il controllo del parametro associato. Regolare le soglie di allarme dopo aver impostato il parametro delle ventilazioni.

Nota: selezionando il parametro ventilatorio si annulla automaticamente il pannello degli allarmi e si eliminano le modifiche alle soglie di allarme non confermate.


19.2.6.1 Regolazione della soglia di allarme

Selezionare il pannello degli allarmi. Toccare la soglia che richiede la regolazione.

La soglia cambierà colore per mostrare che è stato selezionato.



Per regolare la soglia, utilizzare i pulsanti più e meno.



Premere il pulsante conferma quando la soglia è impostata.

Nota: ogni modifica di soglia deve essere confermata in modo indipendente.

Nota: selezionando una nuova soglia senza confermare le modifiche alla soglia precedente, questo causerà l'eliminazione dell'impostazione della soglia precedente.

19.2.6.2 Tracciatura automatica allarme/soglie impostate automaticamente

I seguenti allarmi tracciano automaticamente i parametri di ventilazione.

19.2.6.2.1 Invasiva Convenzionale

Vte:

VTV Off:

Alto = 30 ml

Basso = 0 ml

VTV On:

Sotto 10 ml

Alto = 130% del valore impostato - minimo 3 ml sopra quello impostato

Basso = 10% del valore impostato

Oltre 10 ml

Alto = 30% sopra il valore impostato

Basso = 10% sopra il valore impostato

Vmin:

VTV Off:

Alto = 18 L

Basso = 0 L

VTV On:

Alto = 200% di (Vte x FR)

Basso = 50% di (Vte x FR)

RR

Predefinito = 100 BPM

Tempo di apnea

Predefinito = 15 secondi

Perdita

Predefinito = 25%

PIP

Alto = 5 mbar sopra la PIP impostata

Basso = 70% della PIP impostata per le pressioni PIP tra 8 mbar e 16 mbar,

5 mbar sotto la PIP impostata per le pressioni PIP tra 17 e 50 mbar

90% della PIP impostata per le pressioni PIP tra 51 e 65 mbar

CPAP

Alta = 5 mbar oltre la CPAP impostata

Bassa = 5 mbar sotto la CPAP impostata o 1 mbar se la PEEP è impostata a 6 mbar o meno

PEEP

Alta = 5 mbar oltre la PEEP impostata

Bassa = 5 mbar sotto la PEEP impostata o 1 mbar se la PEEP è impostata a 6 mbar o meno

19.2.6.2.2 Invasiva oscillatoria

HFOV PIP alta (Paw alta)

Alta = 10 mbar oltre la MAP + ($\Delta P \div 2$)

HFO+CMV PIP alta (Paw alta)

Alta = 10 mbar sopra la PIP + ($\Delta P \div 2$)

HFOV Paw bassa (Pressione bassa)

Bassa = 10 mbar sotto la MAP - ($\Delta P \div 2$)

HFO+CMV Paw bassa (Pressione bassa)

Bassa = 10 mbar sotto la PEEP - ($\Delta P \div 2$)

19.2.6.2.3 Non invasiva Convenzionale

RR

Predefinito = 100 BPM

Tempo di apnea

Predefinito = 15 secondi

Perdita

Predefinito = 25%

PIP

Alto = 5 mbar sopra la PIP impostata

Basso = 70% della PIP impostata per le pressioni PIP tra 8 mbar e 16 mbar,

5 mbar sotto la PIP impostata per le pressioni PIP tra 17 e 50 mbar

90% della PIP impostata per le pressioni PIP tra 51 e 65 mbar

CPAP

Alta = 5 mbar oltre la CPAP impostata

Bassa = 5 mbar sotto la CPAP impostata o 1 mbar se la PEEP è impostata a 6 mbar o meno

PEEP

Alta = 5 mbar oltre la PEEP impostata

Bassa = 5 mbar sotto la PEEP impostata o 1 mbar se la PEEP è impostata a 6 mbar o meno

19.2.6.2.4 Non invasiva oscillatoria

HFOV PIP alta (Paw alta)

Alta = 10 mbar oltre la MAP + ($\Delta P \div 2$)

HFOV Paw bassa (Pressione bassa)


Bassa = 10 mbar sotto la MAP - ($\Delta P \div 2$)

19.2.7 Registro e Volume

Queste schede funzionano come descritto in "Scheda Registro" a pagina 130 e "Scheda Volume" a pagina 130.

19.2.8 Scheda Strumenti - modalità ventilatoria

Selezionando il pannello utente verrà mostrata la scheda sensore.

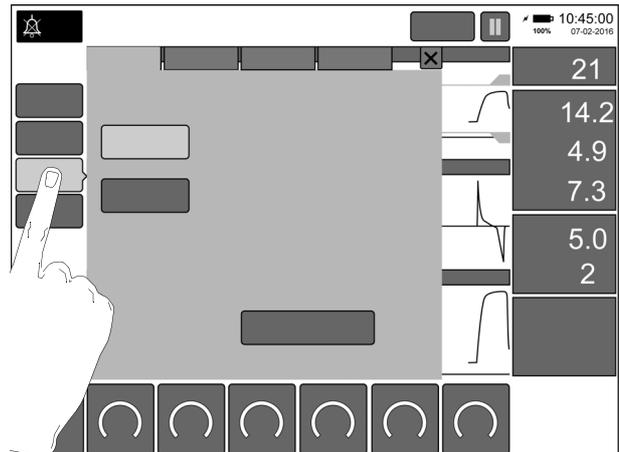


L'utente può scegliere tra la calibrazione del sensore di flusso o il sistema di ossigeno (100%).

Nota: se si utilizza il ventilatore senza il sensore di flusso connesso, il pulsante Sensore di flusso non sarà presente.

19.2.8.1 Calibrazione sensore di flusso


Attenzione. Il sensore di flusso dovrà essere rimosso dal circuito paziente.

Bloccare il sensore di flusso per impedire qualsiasi flusso attraverso i fili del sensore.



Attenzione: per evitare la contaminazione del sensore di flusso, utilizzare i guanti quando si effettua la calibrazione.

Premere il pulsante Avvia calibrazione.

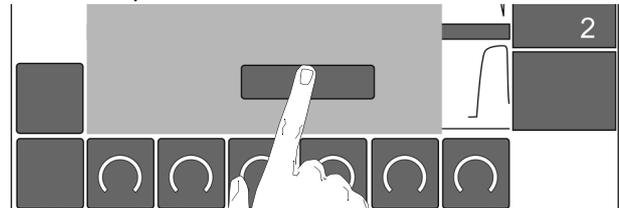

Sul pulsante comparirà il testo "Calibrazione in corso..."


Il ventilatore emetterà un suono di allarme di media priorità e mostrerà il messaggio di allarme "Calibrare il sensore di flusso."

Quando calibrato, il pulsante ritorna allo stato non premuto e verrà visualizzato il testo "Calibrazione completa."

Nota: il pulsante Sensore di flusso non ha un'impostazione predefinita. Verrà selezionata la calibrazione O₂ se è stata l'ultima ad essere utilizzata.

19.2.8.2 Calibrazione O₂

Selezionare il pulsante O₂.

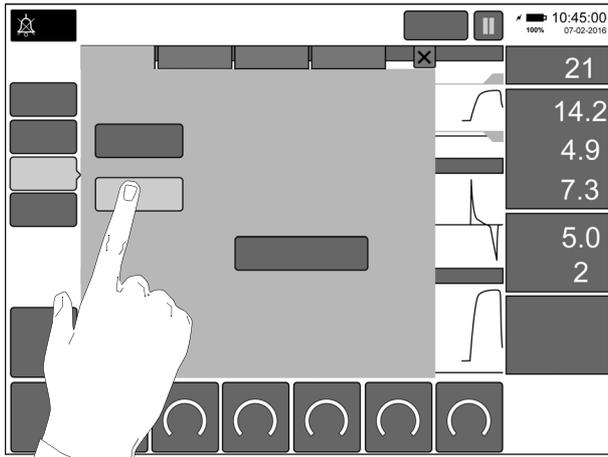

Premere "Avviare la calibrazione O₂ a un punto".

Il testo "Calibrazione in corso..." verrà visualizzato sotto il pulsante e il valore O₂% misurato mostrerà il testo "CAL".

La calibrazione durerà circa 4 minuti.

L'utente può tuttavia impostare lo O₂% durante la calibrazione.

Nota: il pulsante di calibrazione O₂ non ha un'impostazione predefinita. Verrà selezionato il sensore di flusso ultimo selezionato.

Nota: l'andamento O₂ (%) non mostrerà nessuna lettura durante la routine automatica di calibrazione dell'ossigeno.

19.2.9 Scheda Luminosità - Modalità Ventilatoria

Vedere "Scheda Luminosità" a pagina 131.

19.2.10 Scheda Sistema - Modalità Ventilatoria

La scheda sistema ha solo due pulsanti attivi in modalità ventilatoria. Imposta data e ora e informazioni Sistema. Tutti gli altri pulsanti sono disponibili solo in modalità Attesa. Vedere "Imposta data e ora" a pagina 132 e "Informazioni di sistema" a pagina 133 per maggiori informazioni.

19.2.11 Scheda Dati - modalità ventilatoria

I pulsanti sono disponibili solo in modalità Attesa. Vedere "Scheda Dati" a pagina 133.

19.2.12 Layout

La scheda grafici consente all'utente di selezionare e configurare i grafici Forma d'onda, Loop e Andamento. La funzione è la stessa della modalità "Attesa", vedere "Scheda Grafici" a pagina 135.

19.2.13 Pulsante Blocco Funzioni

Il pulsante "Blocco Funzioni" è disponibile quando non ci sono allarmi attivi. Premendo il pulsante si blocca la schermata.

Verrà visualizzata l'icona "Lucchetto" sul pulsante per mostrare Nessuna funzione disponibile.



Quando bloccata, tutte le aree a parte il pulsante Blocco funzioni sono inattive.

Nel caso di attivazione di un allarme, viene automaticamente sbloccata la schermata.

Nota: in una condizione di allarme, il pulsante blocco funzioni diventa il pulsante "Reset" del messaggio di allarme.

Premendo la schermata quando bloccata, verrà visualizzato il messaggio informativo la Nessuna funzione disponibile e l'icona lucchetto diventerà di colore giallo.

Per sbloccare la schermata, l'utente dovrà premere il pulsante per 1 secondo.

19.2.14 Pausa/play

In modalità ventilatoria sarà disponibile il pulsante pausa. Il pulsante pausa metterà in pausa la sezione grafici per 120 secondi.




Per riavviare la sezione grafici, l'utente dovrà premere il pulsante play.



19.2.15 Foto schermata

In modalità ventilatoria, il pulsante pausa o play quando premuto per 3 secondi, creerà una copia della schermata e la memorizzerà nel log di foto schermata.



Il log di foto schermata memorizza un massimo di 10 catture schermate.

Quando il log è pieno, la foto schermata più vecchia verrà eliminata per fare spazio alla nuova.

Le foto schermata possono essere scaricate solo in "Modalità Attesa". Vedere "Download foto schermata" a pagina 134 per maggiori informazioni.

19.2.16 Barra Allarmi

Nell'area informazioni, verrà visualizzata la barra degli allarmi se si verifica una condizione di allarme.



La barra degli allarmi mostrerà il messaggio di allarme con la priorità più alta. Questo sarà di colore rosso/giallo/ciano quando la condizione di allarme è attiva.

La barra degli allarmi è accompagnata da una barra lampeggiante e dal segnale sonoro di alta priorità.

Se la condizione di allarme si cancella senza l'intervento dell'utente, la barra diventerà di colore ciano.

Quando la barra degli allarmi è attiva, il pulsante blocco schermata cambia funzione per diventare il pulsante di ripristino allarme.

Se la condizione di allarme è stata cancellata premendo il pulsante reset, sarà cancellata la barra degli allarmi.

Quando non ci sono condizioni di allarme attive, l'area informazioni può mostrare 1 dei seguenti messaggi:

- Nessuna funzione disponibile
- Per sbloccarla, tenere premuto per 1 secondo
- Sezione grafici in pausa Pausa per 120 secondi

19.2.17 Controlli specifici modalità

19.2.17.1 Respiro manuale (pausa inspiratoria)

Il pulsante respiro manuale viene mostrato nelle seguenti modalità invasive, CPAP, CMV, PTV, PSV, SIMV e modalità non invasive a singolo/doppio lume, nCPAP, NIPPV.

19.2.17.1.1 Respiro manuale

Premendo il pulsante respiro manuale verrà fornito un respiro meccanico alla PIP e Ti impostate.

19.2.17.1.2 Pausa inspiratoria

Premendo il pulsante pausa inspiratoria verrà fornito un respiro meccanico alla PIP impostata per un massimo di 5 - 10 secondi. Il periodo di tempo viene impostato nelle Preferenze operatore. La Ti impostata viene ignorata.

19.2.17.2 Sigh (Pausa Respirone)

Il pulsante Sigh compare nella seguente modalità invasiva, HFOV e modalità non invasiva a sezione singola nHFOV.

19.2.17.2.1 Sigh

Premendo il pulsante Sigh verrà fornita una pausa oscillatoria alla Press. Resp. e Per. Insp Resp impostate.

19.2.17.2.2 Pausa Respirone

Premendo il pulsante Pausa Respirone verrà fornita una pausa oscillatoria alla Press. Resp. impostata per un massimo di 5 o 10 secondi. Il periodo di tempo è impostato nelle Preferenze operatore. Il Per. Insp Resp impostato viene ignorato.

19.2.18 Pausa di oscillazione


Il pulsante Pausa di oscillazione compare nella seguente modalità invasiva, HFOV e modalità non invasiva a sezione singola nHFOV.

Premendo il pulsante Pausa di oscillazione verrà fornita una pausa oscillazione alla MAP impostata per un massimo di 60 secondi. Premendo nuovamente il pulsante per 60 secondi, si annullerà la pausa.


19.2.19 Attività HFO

Il pulsante Attività HFO compare solo in modalità HFOV+CMV invasiva. Il pulsante Attività HFO consente all'utente di cambiare le oscillazioni nelle fasi di inspirazione ed espirazione o anche solo nella fase espiratoria.


Toccare il pulsante Parametri aggiuntivi. In questo modo si attiverà il pulsante Attività HFO.

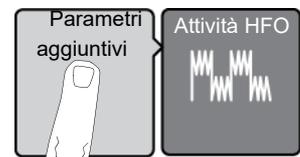

Toccare il pulsante attività HFO.

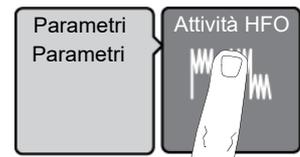


L'indicatore di attività sostituirà il pulsante.



Questo attiverà i pulsanti più/meno. Utilizzare i pulsanti più/meno per cambiare le oscillazioni nelle fasi di inspirazione ed espirazione o solo nella fase espiratoria. Premere il pulsante Conferma per accettare la modifica.



L'indicatore passerà alla nuova attività di oscillazione.



Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Dati tecnici

- “Descrizione tecnica” a pagina 148
- “Routine di calibrazione dell'ossigeno” a pagina 151
- “N5402-REV2 & N5302 sensore di flusso” a pagina 152
- “Specifiche tecniche” a pagina 154
- “Specifiche del sensore” a pagina 189
- “Allarmi” a pagina 193
- “Pulizia e disinfezione” a pagina 235
- “Compliance elettromagnetica” a pagina 237
- “Schema dell'unità pneumatica” a pagina 239
- “Istruzioni di installazione” a pagina 260



20. Descrizione tecnica

Il ventilatore è un dispositivo a controllo computerizzato. Il computer è costituito da tre sottosistemi elettronici principali alloggiati nella sezione superiore (elettronica) del ventilatore.

I tre sottosistemi sono l'interfaccia utente, il monitor e il controller.


Il sottosistema dell'interfaccia utente controlla l'interfaccia utente, il display e il touchscreen.

Il sottosistema del controller regola i sistemi pneumatici del ventilatore.

Il sottosistema del monitor raccoglie ed elabora i dati del flusso e genera gli allarmi.

Ciascun sottosistema comunica con gli altri due in un protocollo peer to peer, ovvero nessun sottosistema è in controllo completo.

Un modulo di comunicazione che si integra con l'interfaccia utente e il monitor noto come ESMO garantisce la connettività per i sensori esterni Masimo SpO2 e Covidians etCO2.

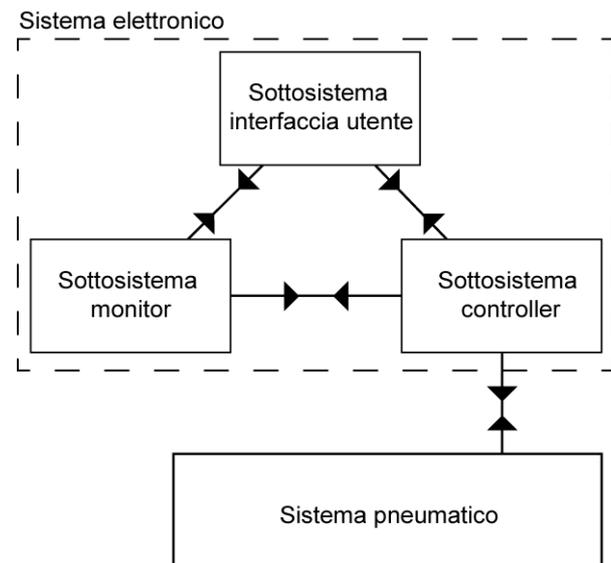

Il ventilatore è provvisto di un alimentatore auto-ranging in grado di operare con alimentazioni di rete di 100 V - 240 V, 50-60 Hertz.

Il ventilatore può essere inoltre eseguito da un ingresso CC esterno da 24 V.

Il ventilatore include una fonte di alimentazione di riserva formata da pacchi batteria agli ioni di litio in grado di far funzionare il ventilatore in caso di guasto nella rete elettrica.

Le batterie sono caricate dall'alimentatore dei ventilatori. La potenza della batteria interna, 24 V CC e l'alimentatore principale sono monitorati dai ventilatori degli altri sottosistemi.

In normali modalità di ventilazione e con la batteria completamente carica, in caso di guasto di alimentazione il ventilatore continuerà a funzionare con l'alimentazione di riserva.

Il sistema pneumatico comprende quanto segue.

Un miscelatore elettronico dell'ossigeno miscela il gas. Il gas miscelato viene quindi controllato da una elettrovalvola per alimentare il sistema di ventilazione convenzionale e il sistema oscillatorio.

Per la ventilazione convenzionale, il gas è controllato da due regolatori di pressione che producono flussi di gas positivo e negativo mediante getti bidirezionali.

Per la ventilazione oscillatoria, il flusso di gas è controllato da quattro valvole a solenoide ad alta velocità, in linea, che producono il flusso di gas oscillatorio mediante getti bidirezionali.

Il blocco di esalazione è montato su due porte per i getti, una bidirezionale e una a pressione media.

La pressione è monitorata attraverso la porta prossimale delle vie respiratorie mediante un paio di trasduttori di pressione e i dati vengono inviati al sottosistema del monitor.

Il flusso è monitorato da un anemometro a doppio filo caldo montato sul collettore endotracheale e i dati di flusso vengono inviati al sottosistema del monitor.

Le modalità invasive utilizzeranno un circuito paziente a doppia sezione, mentre la ventilazione non invasiva può essere eseguita su un circuito a sezione singola o doppia. Nel funzionamento del circuito a doppia sezione una sezione è collegata alla porta del gas fresco e l'altra è collegata alla porta di scarico.

Il metodo principale per generare la pressione del paziente nell'uso della doppia sezione è quello di guidare i getti nella porta di scarico.

Il circuito paziente non invasivo a singolo lume è collegato alla porta del gas fresco in modo che il controllo della pressione del paziente si ottiene controllando direttamente il flusso di gas fresco.

La porta di scarico sul ventilatore non è collegata al circuito paziente. Un incremento del flusso di gas fresco fa aumentare la pressione del paziente in base alla resistenza pneumatica della "sezione" di scarico del circuito a sezione singola (un circuito a sezione singola presenta una sezione o una porta di scarico, ma non è collegata al ventilatore).

La pressione del paziente è monitorata e il gas di scarico è controllato per mantenere la pressione desiderata del paziente.

Il ventilatore presenta due ingressi da 5 V dedicati per il monitoraggio etCO2 e SpO2.

SpO2 può essere monitorato utilizzando i sensori Masimo SET SpO2. Questi devono essere collegati al cavo SLE uSpO2.

etCO2 può essere monitorato utilizzando la tecnologia Microstream™ utilizzando il Covidian MicroPod™

21. Descrizione delle modalità di ventilazione (invasiva)

Il ventilatore può essere usato sia come dispositivo a pressione controllata e volume prefissato, sia come ventilatore a pressione limitata time cycled e come ventilatore ad alta frequenza oscillatoria.

21.1 CPAP

Pressione positiva continua delle vie respiratorie

Il ventilatore genera una pressione positiva continua delle vie respiratorie impostata dall'utente. L'allarme di apnea suona se il paziente non compie alcun tentativo di respirazione entro il periodo di apnea impostato.

Il ventilatore fornirà respiri di backup se necessario.

21.2 CMV

Ventilazione obbligatoria continua

In questa modalità, il ciclo inspiratorio viene avviato dal ventilatore alla frequenza BPM impostata. I respiri sono time cycled.

21.2.1 CMV & VTV

Questa è per la modalità CMV di base in cui la pressione inspiratoria sarà controllata dal ventilatore per ottenere la VTV impostata dall'utente.

21.3 PTV

Ventilazione triggerata dal paziente

In questa modalità, tutti i tentativi di respirazione del paziente sono a supporto pressorio. Se non vengono identificate azioni ventilatorie del paziente, la ventilazione meccanica avviene ai parametri impostati (T insp, PEEP e PIP).

21.3.1 PTV & VTV

Questo vale per la PTV base in cui la pressione inspiratoria sarà controllata dal ventilatore per ottenere la Vte impostata dall'utente (per i respiri assistiti).

21.4 PSV

Ventilazione con supporto pressorio

È una modalità di ventilazione a pressione limitata nella quale ogni respiro è triggerato dal paziente e con supporto pressorio. Il respiro è triggerato dal paziente, con supporto pressorio e terminato dal paziente. Il bambino ha pertanto il controllo sull'intero ciclo, ovvero sul tempo inspiratorio, sulla frequenza e sul volume minuto. Questa forma di ventilazione è resa possibile dall'uso di un sensore di flusso posto tra il connettore del tubo endotracheale e il circuito paziente. Eventuali variazioni del segnale di flusso o volume identificano la presenza di respirazione spontanea.

L'utente può inoltre regolare la sensibilità di fine flusso (da 0% a 50%).

Esempio: una sensibilità di fine flusso del 5% indica

che il supporto pressorio può essere manualmente terminato quando il flusso inspiratorio scende al di sotto del 5% del valore di picco. Il livello di supporto pressorio può essere manualmente regolato mediante l'uso del controllo parametro PIP.

La PSV può essere usata nel processo di svezzamento respiratorio. Lo svezzamento si ottiene riducendo il livello di supporto man mano che il bambino è in grado di compiere maggiori azioni ventilatorie.

In questa modalità, tutti i tentativi di respirazione del paziente sono a supporto pressorio, ma, quando vengono rilevate azioni ventilatorie del paziente, la ventilazione meccanica avviene ai parametri impostati (T insp, PEEP e PIP).


21.4.1 PSV & VTV

È come la PSV base con Supporto apnea, in cui la pressione inspiratoria sarà controllata dal ventilatore per ottenere la VTV impostata dall'utente (per i respiri assistiti).


21.5 SIMV

Ventilazione obbligatoria intermittente sincronizzata

La frequenza degli atti respiratori obbligatori è determinata dal controllo BPM. Nel momento in cui deve verificarsi un atto respiratorio obbligatorio, si apre una finestra di respirazione assistita e si attende l'azione ventilatoria del paziente. Allorché ciò si verifica, il ventilatore fornisce un atto respiratorio sincronizzato (respiri SIMV), al termine del quale la finestra di respirazione assistita si chiude fino al momento in cui deve verificarsi l'atto respiratorio successivo impostato.

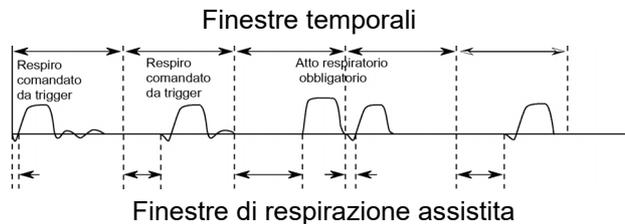

Se il ventilatore non rileva alcun tentativo di respirazione del paziente prima della fine della finestra temporale predefinita, viene generato un atto respiratorio obbligatorio. Il punto dell'atto respiratorio obbligatorio è la Finestra temporale meno il Tempo inspiratorio.

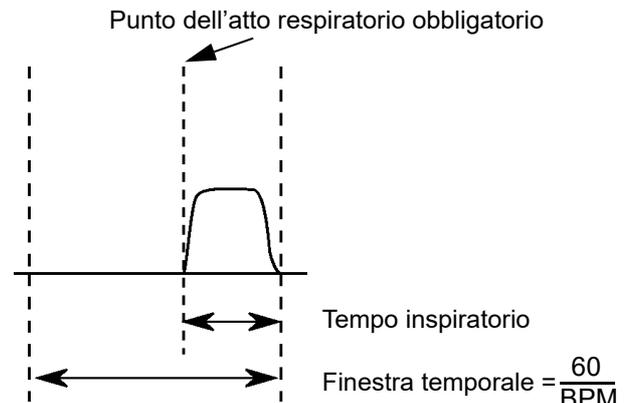

21.5.1 SIMV con Supporto Press.

La SIMV con supporto Press. consente all'utente di selezionare la sensibilità di fine flusso e il livello di supporto pressorio in presenza di respiri non SIMV. Non appena viene erogato al paziente un respiro meccanico, il flusso che il bambino riceve aumenta rapidamente per poi diminuire fino alla soglia di fine flusso. A questo punto l'inspirazione termina e può iniziare l'espirazione.

La SIMV con supporto Press. produce respiri a pressione limitata time cycled forniti alla frequenza BPM impostata. Ogni ulteriore tentativo di respirazione del paziente è con supporto pressorio (con cicli di flusso e a pressione limitata).

21.5.2 SIMV & VTV

È come la SIMV base (con o senza Supporto P), in cui la pressione inspiratoria sarà controllata dal ventilatore per ottenere la VTV impostata dall'utente (per respiri assistiti).

21.6 HFOV

Oscillazione ad alta frequenza

In questa modalità, il ventilatore fornisce oscillazione ad alta frequenza continua. I piccoli volumi correnti sono forniti a velocità superfisiologiche.

21.6.1 HFO & VTV

È come la HFO base ma regola automaticamente la ΔP , per raggiungere il V_{te} obiettivo, impostato dall'utente.

21.7 HFOV+CMV

Una combinazione di oscillazioni durante la fase espiratoria o inspiratoria ed espiratoria di una ventilazione time cycled a pressione limitata in modalità CMV.

22. Descrizione delle modalità di ventilazione (non invasive)

Il ventilatore ha la possibilità di essere utilizzato come ventilatore a pressione controllata, ventilatore time cycled e come ventilatore ad alta frequenza oscillatoria. Uso di circuiti di erogazione a singolo o doppio lume.

Nota: alti flussi viene fornita solo da un circuito di erogazione a singolo lume.

22.1 nCPAP (sezione singola o doppia)

Pressione positiva continua delle respiratorie per via nasale

Il ventilatore genera una pressione positiva continua delle vie respiratorie impostata dall'utente. L'allarme di apnea suona se il paziente non compie alcun tentativo di respirazione entro il periodo di apnea impostato.

Il ventilatore fornirà respiri di backup se necessario.

22.2 NIPPV (doppio lume)

Ventilazione della pressione positiva intermittente non invasiva

In questa modalità, il ciclo inspiratorio viene avviato dal ventilatore alla frequenza BPM impostata. I respiri sono time cycled.

22.3 NIPPV Tr. (Doppio lume)

Ventilazione della pressione positiva intermittente non invasiva triggerata

In questa modalità, tutti i tentativi di respirazione del paziente sono a supporto pressorio. Se non vengono identificate azioni ventilatorie del paziente, la ventilazione meccanica avviene ai parametri impostati (T insp, PEEP e PIP).

22.4 nHFOV (Doppio lume solo)

Oscillazione ad alta frequenza nasale

In questa modalità, il ventilatore fornisce oscillazione ad alta frequenza continua.

22.5 Terapia O₂ (a singolo lume)

In questa modalità, il ventilatore fornirà il flusso continuo alla concentrazione di ossigeno impostata.

23. Routine di calibrazione dell'ossigeno

Il ventilatore ha due routine di calibrazione della cellula di misura ossigeno. La prima routine è la calibrazione dell'ossigeno al 100% (a un punto), che viene eseguita ai seguenti intervalli dopo l'accensione del dispositivo: avvio, 10 minuti, 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti e quindi a intervalli di 8 ore.

La seconda routine è la calibrazione dell'ossigeno al 21% e al 100% (a due punti), che deve essere eseguita soltanto se la cella di misura ossigeno è stata sostituita o ha registrato un valore al di sotto del 21% (deriva della cella in seguito all'uso).

Avvertenza: l'utente non può eseguire la calibrazione a due punti quando è collegato a un paziente. Il ventilatore deve essere messo in modalità "Attesa" e il processo di calibrazione fornirà il 21% di O₂ al paziente per 3 minuti.

23.1 Calibrazione di O₂ a un punto

L'utente può effettuare la calibrazione a un punto del sistema accedendo al pannello di calibrazione del sensore dell'ossigeno dal pannello di Service.

Per questa calibrazione, il ventilatore può essere connesso a un paziente.

Durante la calibrazione il ventilatore continua a fornire la percentuale impostata dall'utente di O₂.

Per il valore misurato O₂ si leggerà "CALIB".

Nota: la possibilità di effettuare la calibrazione O₂ a un punto è disponibile solo quando il ventilatore è impostato in modalità ventilatoria.

23.2 Calibrazione O₂ a due punti

La calibrazione a due punti può essere eseguita solo dalla modalità Ingegneristica.

Attenzione. L'accesso alla modalità tecnico è consentito esclusivamente per il personale dell'assistenza formato. Per informazioni sulla modalità Ingegneristica, consultare il manuale di assistenza. Vedere il capitolo '45. Parti consumabili e accessori' a pagina 280 per il numero di pezzo del manuale di assistenza.

Eseguendo la Calibrazione O₂ a due punti, l'utente dovrà attendere 6 minuti prima di eseguire una nuova operazione.

Il ventilatore inizierà con una calibrazione al 21% per 3 minuti seguita da una calibrazione al 100% per 3 minuti.

Avvertenza: l'utente non può selezionare la modalità di ventilazione mentre è in esecuzione il processo di calibrazione a due punti.

Se il ventilatore eseguirà la calibrazione standard al 100% a un punto, l'utente non potrà eseguire la calibrazione a due punti fino a quando questa non sarà completata.

Nella modalità ventilazione, il valore misurato di O₂ leggerà "CALIB" nel parametro O₂ fino a quando la routine non è completa.


24. N5402-REV2 & N5302 sensore di flusso

Il ventilatore impiega un sensore ad anemometro a filo riscaldato a basso spazio morto (<1ml). Per minimizzare lo spazio morto, la struttura del sensore riempie gran parte dell'adattatore del tubo endotracheale e della connessione al circuito paziente.

Avvertenza: non usare gas nebulizzati (farmaci, soluzioni saline, ecc.) insieme al sensore perché potrebbero degradarne le prestazioni e i livelli di accuratezza specificati.

Attenzione: il sensore del flusso è un oggetto soggetto a manutenzione e potrebbe richiedere la pulizia durante l'uso.

SLE offre due tipi di sensore di flusso: l'N5402-REV2, che è riutilizzabile o l'N5302, che è monouso.

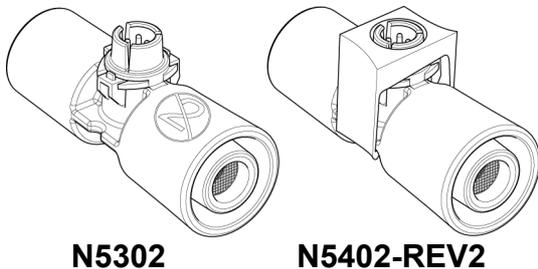

N5302

N5402-REV2

Avvertenza: non utilizzare il sensore del flusso N5302 se la confezione è stata danneggiata.

Avvertenza: non utilizzare questo sensore di flusso per monitorare pazienti con tubi endotracheali di dimensioni superiori a 5,0 mm o che richiedano portate superiori a 30 l/min.

Nota: il sensore di flusso N5302 è un dispositivo monouso. Viene fornito sterile. Può essere pulito durante l'uso ma non può essere risterilizzato. È pertanto necessario smaltirlo come rifiuto ospedaliero. Il sensore N5302 può essere pulito risciacquandolo con acqua sterile.


L'utente deve calibrare il sensore di flusso prima del reinserimento nel circuito paziente.

24.1 Calibrazione del sensore di flusso

Collegare il cavo del sensore di flusso al sensore di flusso stesso. Assicurarsi che la chiave del connettore del cavo si adatti all'incavo posteriore del connettore del sensore di flusso.

Il ventilatore invierà l'allarme calibra sensore di flusso. Premere il pulsante "Calibra" nella barra delle informazioni per attivare il pannello del sensore o premere il pulsante "Strumenti" o il pulsante "Calibrazione ed Utenze".

Bloccare il sensore di flusso per impedire qualsiasi flusso attraverso i fili del sensore.



Premere il pulsante Avvia calibrazione e il testo "Calibrazione in corso..."verrà visualizzato sul pulsante.

Una volta che le calibrazioni hanno superato il test, comparirà "Calibrazione completa".

Il sensore di flusso adesso è calibrato.

Nota: durante l'impiego, il sensore di flusso deve essere calibrato ogni 24 ore, se le condizioni del paziente lo consentono.


Nota: la procedura di calibrazione è la medesima per i sensori N5402-REV2 e N5302.

24.2 Pulizia e sterilizzazione profonda del sensore N5402-REV2

Avvertenza: prima di ogni impiego, controllare che il sensore non sia danneggiato. Non usare parti danneggiate.

Rimuovere il cavo di collegamento del sensore di flusso prima di effettuare la pulizia o la sterilizzazione.

Risciacquare la struttura del sensore immediatamente dopo l'uso e immergerlo in un disinfettante (procedura raccomandata dall'autorità per il controllo delle infezioni dell'ospedale/della struttura sanitaria) per evitare incrostazioni che comprometterebbero la possibilità di riutilizzare il sensore.

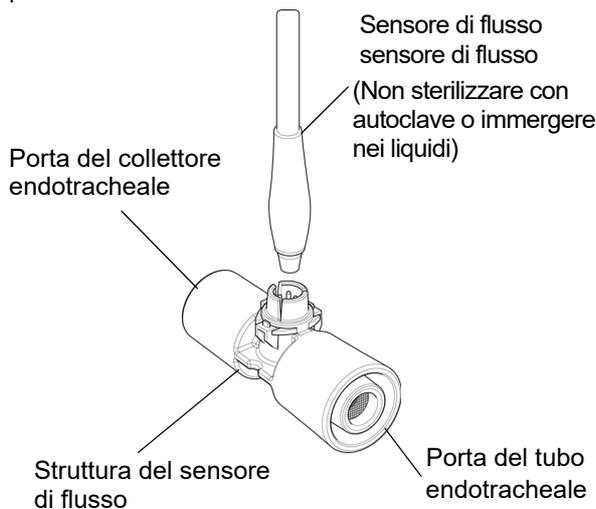

Avvertenza: non pulire il sensore di flusso con aria compressa o getti d'acqua perché potrebbero distruggerne i fili.

Prima di usarlo per la prima volta e subito dopo ogni uso o la disinfezione/sterilizzazione del sensore.

24.2.1 Pulizia:

Usare una soluzione di sapone o una soluzione alcalina delicata.

24.2.2 Disinfezione:

Usare disinfettanti in commercio raccomandati per l'uso con MATERIALI PLASTICI. Concentrazioni e tempi di immersione specifici devono essere conformi alle istruzioni dei fabbricanti.

Nota: i disinfettanti contenenti composti simili a FENOLO o ALCHILAMMINE (glucorrotamina) non sono adatti.

Nota: dopo ogni procedura di pulizia e disinfezione, eliminare tutti i residui di agenti detergenti e disinfettante usati, sciacquando accuratamente con acqua sterile.

24.2.3 Sterilizzazione profonda

Sterilizzazione in autoclave a

134°C (277°F) (variazione di temperatura consentita di 3°C) a 220 kPa (32 psi) con un tempo di permanenza minimo di 3 minuti.

oppure

121°C (248°F) (variazione di temperatura consentita di 3°C) a 96 kPa (14,1 psi) con un tempo di permanenza minimo di 15 minuti.

Nota: non connettere il sensore ad altri connettori standard allorché sterilizzato in autoclave per evitare incrinature. Assicurarsi che durante il processo di sterilizzazione sul sensore non vi siano altri componenti/articoli.

25. Specifiche tecniche

25.1 Modalità operative - Ventilazione invasiva convenzionale

Questa sezione riassume la specifica del ventilatore SLE6000 in termini di modalità, range e limiti richiesti per i controlli e la precisione regolabile dell'operatore. Riepiloga i limiti meccanici e di alimentazione elettrica.

Nota: se il ventilatore è impostato a cmH₂O mediante le preferenze operatore sostituiscono cmH₂O per mbar.

25.1.1 Modalità CPAP

Tempo inspiratorio (Ti): da 0,1 a 3,0 secondi
 Risoluzione: 0,01 secondi)
 Impostazione valori
 di fabbrica: 0,40 secondi.
 Pressione CPAP (CPAP): da 0 a 35 mbar
 Risoluzione: 0,5 mbar <10mbar,
 1 mbar >10 mbar)

Impostazione predefinita
 di fabbrica: 4,0 mbar
 Pressione PIP: da 0 a 65 mbar
 Risoluzione: 1 mbar
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 15 mbar
 Concentrazione O₂: da 21 a 100%
 Risoluzione: 1%
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 21%

Parametri aggiuntivi:

Frequenza backup apnea
 (comando di Supporto Apnea): da 1 a 150 BPM
 Risoluzione: 1 BPM
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 40 mbar
 Fronte di salita: da 0,0 a 3.0 secondi
 Risoluzione: 0,01 secondi
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 0,04 secondi

Sensibilità del trigger con sensore di flusso

Sens. trigger: da 0,2 l/min a 20 l/min
 Risoluzione: 0,2 l/min
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 0,6 l/min

Sensibilità del trigger senza sensore di flusso

Sens. trigger: dall'1% al 100%
 Risoluzione: 1%
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 50%

25.1.2 Modalità CMV

Frequenza respiratoria (FR): . . da 1 a 150
 Risoluzione: 1 BPM
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 30 mbar
 Tempo inspiratorio (Ti): da 0,1 a 3,0 secondi
 Risoluzione: 0,01 secondi
 Impostazione valori
 di fabbrica: 0,40 secondi.
 Pressione PEEP: da 0 a 35 mbar
 Risoluzione: 0,5 <10 mbar,
 1 mbar >10 mbar)

Impostazione predefinita
 di fabbrica: 4,0 mbar
 Pressione PIP: da 0 a 65 mbar
 Risoluzione: 1 mbar
 Valore predefinito: 15 mbar
 VTV: da 2 a 300 ml
 da 3 a 300 ml con
 etCO₂ acceso.

Impostazione predefinita
 di fabbrica: impostata su "Off"
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 3 ml su "On"

Controllo VTV, quando abilitato diventa controllo Vte obiettivo.

Da 2 ml a 9,8 ml il parametro aumenta con progressioni da 0,2 ml (risoluzione fine).

Da 10 ml a 100 ml il parametro aumenta con progressioni da 1 ml (risoluzione standard).

Da 100 ml a 300 ml il parametro ha incrementi da 5 ml (bassa risoluzione).

Concentrazione O₂: da 21 a 100%
 Risoluzione: 1%
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 21%

Parametri aggiuntivi:

Fronte di salita: da 0,0 a 3.0 secondi
 Risoluzione: 0,01 secondi
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 0,04 secondi

25.1.3 Modalità PTV

Frequenza respiratoria (FR):	da 1 a 150
Risoluzione:	1 BPM
Impostazione predefinita di fabbrica:	30 BPM
Tempo inspiratorio (Ti):	da 0,1 a 3.0 secondi
Risoluzione:	0,01 secondi
Impostazione predefinita di fabbrica:	0,40 secondi
Pressione PEEP:	da 0 a 35 mbar
Risoluzione:	da 0,5 mbar <10 mbar, 1 mbar >10 mbar
Impostazione predefinita di fabbrica:	4,0 mbar
Pressione PIP:	da 0 a 65 mbar
Risoluzione:	1 mbar
Impostazione predefinita di fabbrica:	15 mbar
VTV:	da 2 a 300 ml da 3 a 300 ml con etCO ₂ acceso.
Impostazione predefinita di fabbrica:	impostata su "Off"
Impostazione predefinita di fabbrica:	3 ml su "On"
Controllo VTV, quando abilitato diventa controllo Vte obiettivo.	
Da 2 ml a 9,8 ml il parametro aumenta con progressioni da 0,2 ml (risoluzione fine).	
Da 10 ml a 100 ml il parametro aumenta con progressioni da 1 ml (risoluzione standard).	
Da 100 ml a 300 ml il parametro ha incrementi da 5 ml (bassa risoluzione).	
Concentrazione O ₂ :	da 21 a 100%
Risoluzione:	1%
Impostazione predefinita di fabbrica:	21%
Parametri aggiuntivi:	
Fronte di salita:	da 0,0 a 3.0 secondi
Risoluzione:	0,01 secondi
Impostazione predefinita di fabbrica:	0,04 secondi
Sensibilità del trigger con sensore di flusso	
Sens. trigger:	da 0,2 l/min a 20 l/min
Risoluzione:	0,2 l/min
Impostazione predefinita di fabbrica:	0,6 l/min
Sensibilità del trigger senza sensore di flusso	
Sens. trigger:	dall'1% al 100%
Risoluzione:	1%
Impostazione predefinita di fabbrica:	50%

25.1.4 Modalità PSV

Frequenza respiratoria (FR):	da 1 a 150 BPM
Risoluzione:	1 BPM
Impostazione predefinita di fabbrica:	30 BPM
Tempo insp. (Ti Max):	da 0,1 a 3.0 secondi
Risoluzione:	0,01 secondi
Impostazione predefinita di fabbrica:	0,40 secondi
Pressione PEEP:	da 0 a 35 mbar
Risoluzione:	da 0,5 mbar <10 mbar, 1 mbar >10 mbar)
Impostazione predefinita di fabbrica:	4,0 mbar
Pressione PIP:	da 0 a 65 mbar
Risoluzione:	1 mbar
Impostazione predefinita di fabbrica:	15 mbar
VTV:	da 2 a 300 ml da 3 a 300 ml con etCO ₂ acceso.
Impostazione predefinita di fabbrica:	impostata su "Off"
Impostazione predefinita di fabbrica:	3 ml su "On"
Controllo VTV, quando abilitato diventa controllo Vte obiettivo.	
Da 2 ml a 9,8 ml il parametro aumenta con progressioni da 0,2 ml (risoluzione fine).	
Da 10 ml a 100 ml il parametro aumenta con progressioni da 1 ml (risoluzione standard).	
Da 100 ml a 300 ml il parametro ha incrementi da 5 ml (bassa risoluzione).	
Concentrazione O ₂ :	da 21 a 100%
Risoluzione:	1%
Impostazione predefinita di fabbrica:	21%
Parametri aggiuntivi:	
Fronte di salita:	da 0,0 a 3.0 secondi
Risoluzione:	0,01 secondi
Impostazione predefinita di fabbrica:	0,04 secondi
Sensibilità del trigger con sensore di flusso	
Sens. trigger:	da 0,2 l/min a 20 l/min
Risoluzione:	0,2 l/min
Impostazione predefinita di fabbrica:	0,6 l/min
Sensibilità del trigger senza sensore di flusso	
Sens. trigger:	dall'1% al 100%
Risoluzione:	1%
Impostazione predefinita di fabbrica:	50%
Sensibilità di fine flusso (controllo sens. Fine): da 5 a 50%	
Risoluzione:	5%
Impostazione predefinita di fabbrica:	5%

25.1.5 Modalità SIMV

Frequenza respiratoria (FR):	da 1 a 150 BPM
Risoluzione:	1 BPM
Impostazione predefinita di fabbrica:	30 BPM
Tempo inspiratorio (Ti):	da 0,1 a 3,0 secondi
Risoluzione:	0,01 secondi
Impostazione predefinita di fabbrica:	0,40 secondi
Pressione PEEP:	da 0 a 35 mbar
Risoluzione:	da 0,5 mbar <10 mbar, 1 mbar >10 mbar
Impostazione predefinita di fabbrica:	4,0 mbar
Pressione PIP:	da 0 a 65 mbar
Risoluzione:	1 mbar
Impostazione predefinita di fabbrica:	15 mbar
VTV:	da 2 a 300 ml da 3 a 300 ml con etCO ₂ acceso
Impostazione predefinita di fabbrica:	impostata su "Off"

Impostazione predefinita di fabbrica: 3 ml su "On"

Controllo VTV, quando abilitato diventa controllo Vte obiettivo.

Da 2 ml a 9,8 ml il parametro aumenta con progressioni da 0,2 ml (risoluzione fine).
Da 10 ml a 100 ml il parametro aumenta con progressioni da 1 ml (risoluzione standard).
Da 100 ml a 300 ml il parametro ha incrementi da 5 ml (bassa risoluzione).

Concentrazione O ₂ :	da 21 a 100%
Risoluzione:	1%
Impostazione predefinita di fabbrica:	21%

Parametri aggiuntivi:

Fronte di salita:	da 0,0 a 3,0 secondi
Risoluzione:	0,01 secondi
Impostazione predefinita di fabbrica:	0,04 secondi
Supporto Press:	da 0 a 65 mbar
Impostazione predefinita di fabbrica:	impostata su "Off"
Impostazione predefinita di fabbrica:	8 mbar su "On"

Sensibilità del trigger con sensore di flusso

Sens. trigger:	da 0,2 l/min a 20 l/min
Risoluzione:	0,2 l/min
Impostazione predefinita di fabbrica:	0,6 l/min

Sensibilità del trigger senza sensore di flusso

Sens. trigger:	dall'1% al 100%
Risoluzione:	1%
Impostazione predefinita di fabbrica:	50%

Sensibilità di fine flusso (controllo sens. Fine):	da 5 a 50%
Risoluzione:	5%
Impostazione predefinita di fabbrica:	5%

Nota: il parametro Sensibilità di fine flusso non viene mostrato quando il supporto pressorio (Supporto Press.) è disattivato.

25.1.6 Modalità HFOV

Frequenza:	da 3 a 20 Hz
Risoluzione:	0,1 Hz
Impostazione predefinita di fabbrica:	10,0 Hz
Rapporto I:E:	1:1 / 1:2 / 1:3
Impostazione predefinita di fabbrica:	1:1
MAP:	da 0 a 45 mbar
Risoluzione:	1 mbar
Impostazione predefinita di fabbrica:	5 mbar
Range Delta P:	da 4 a 180 mbar
Risoluzione:	1 mbar
Impostazione predefinita di fabbrica:	4 mbar
Concentrazione O ₂ :	da 21 a 100%
Risoluzione:	1%
Impostazione predefinita di fabbrica:	21%

Parametri aggiuntivi:

Rr Respirone:	da 1 a 150 BPM
Risoluzione:	1 BPM
Impostazione predefinita di fabbrica:	impostata su "Off"
Impostazione predefinita di fabbrica:	30 BPM su "On"
Controllo Per. Insp Resp:	da 0,1 a 3,0 secondi
Risoluzione:	0,01 secondi
Impostazione predefinita di fabbrica:	0,40 secondi
Controllo Press. Resp.:	da 0 a 45 mbar
Risoluzione:	1 mbar
Impostazione predefinita di fabbrica:	20 mbar
VTV:	da 2 a 50 ml da 3 a 50 ml con etCO ₂ acceso
Impostazione predefinita di fabbrica:	impostata su "Off"
Impostazione predefinita di fabbrica:	2 ml su "On"
Controllo VTV, quando abilitato diventa controllo Vte obiettivo.	
Da 2 ml a 9,8 ml il parametro aumenta con progressioni da 0,2 ml (risoluzione fine).	
Da 10 ml a 50 ml il parametro aumenta con progressioni da 1 ml (risoluzione standard).	

25.1.7 Modalità HFOV+CMV

Frequenza respiratoria (FR):	da 1 a 150 BPM
Risoluzione:	1 BPM
Impostazione predefinita di fabbrica:	30 BPM
Tempo inspiratorio (Ti):	da 0,1 a 3,0 secondi
Risoluzione:	0,01 secondi
Impostazione predefinita di fabbrica:	0,40 secondi
Gamma di frequenza:	da 3 a 20 Hz
Risoluzione:	0,1Hz
Impostazione predefinita di fabbrica:	10,0 Hz.
Pressione PEEP:	da 0 a 35 mbar
Risoluzione:	da 0,5 mbar <10 mbar, 1 mbar >10 mbar
Impostazione predefinita di fabbrica:	4,0 mbar
Pressione PIP:	da 0 a 65 mbar
Risoluzione:	1 mbar
Impostazione predefinita di fabbrica:	15 mbar
Range Delta P:	da 4 a 180 mbar
Risoluzione:	1 mbar
Impostazione predefinita di fabbrica:	4 mbar
Concentrazione O ₂ :	da 21 a 100%
Risoluzione:	1%
Impostazione predefinita di fabbrica:	21%

Parametri aggiuntivi:

Attività HFO: oscillazione su entrambi i cicli alto e basso.

Oscillazione solo su ciclo basso.

Pausa di oscillazione: 60 secondi

25.2 Modalità operative Convenzionale Non invasiva Ventilazione**25.2.1 Modalità nCPAP D (doppio lume)**

Tempo inspiratorio (Ti):	da 0,1 a 3,0 secondi
Risoluzione:	0,01 secondi
Impostazione predefinita di fabbrica:	0,40 secondi
Pressione CPAP:	da 0 a 35 mbar
Risoluzione:	da 0,5 mbar <10 mbar, 1 mbar >10 mbar
Impostazione predefinita di fabbrica:	4 mbar
Pressione PIP:	da 0 a 65 mbar
Risoluzione:	1 mbar
Impostazione predefinita di fabbrica:	15 mbar
Concentrazione O ₂ :	da 21 a 100%
Risoluzione:	1%
Impostazione predefinita di fabbrica:	21%
Parametri aggiuntivi:	
Comando Supporto Apnea:	da 1 a 150 BPM
Risoluzione:	1 BPM
Impostazione predefinita di fabbrica:	impostata su "Off"
Impostazione predefinita di fabbrica:	40 BPM su "On"
Fronte di salita:	da 0,0 a 3,0 secondi
Risoluzione:	0,01 secondi
Impostazione predefinita di fabbrica:	0,04 secondi
Sens. trigger:	dall'1% al 100%
Risoluzione:	1%
Impostazione predefinita di fabbrica:	50%

25.2.2 Modalità NIPPV D (doppio lume)

Frequenza respiratoria (FR): da 1 a 150 BPM
 Risoluzione: 1 BPM
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 30 BPM

Tempo inspiratorio (Ti): da 0,1 a 3,0 secondi
 Risoluzione: 0,01 secondi
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 0,40 secondi

Pressione PEEP: da 0 a 35 mbar
 Risoluzione: da 0,5 mbar <10 mbar,
 1 mbar >10 mbar

Impostazione predefinita
 di fabbrica: 4 mbar

Pressione PIP: da 0 a 65 mbar
 Risoluzione: 1 mbar)
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 15 mbar

Concentrazione O₂: da 21 a 100%
 Risoluzione: 1%
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 21%

Parametri aggiuntivi:

Fronte di salita: da 0,0 a 3.0 secondi
 Risoluzione: 0,01 secondi
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 0,04 secondi

25.2.3 Modalità NIPPV Tr. (Doppio lume)

Frequenza respiratoria (FR): da 1 a 150 BPM
 Risoluzione: 1 BPM
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 30 BPM

Tempo inspiratorio (Ti): da 0,1 a 3,0 secondi
 Risoluzione: 0,01 secondi
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 0,40 secondi

Pressione PEEP: da 0 a 35 mbar
 Risoluzione: da 0,5 mbar <10 mbar,
 1 mbar >10 mbar

Impostazione predefinita
 di fabbrica: 4 mbar

Pressione PIP: da 0 a 65 mbar
 Risoluzione: 1 mbar
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 15 mbar

Concentrazione O₂: da 21 a 100%
 Risoluzione: 1%
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 21%

Parametri aggiuntivi:

Fronte di salita: da 0,0 a 3.0 secondi
 Risoluzione: 0,01 secondi

Impostazione predefinita
 di fabbrica: 0,04 secondi

Sens. trigger: dall'1% al 100%
 Risoluzione: 1%
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 50%

25.2.4 Modalità nHFOV (Doppio lume)

Frequenza: da 3 a 20Hz
 Risoluzione: 0,1Hz
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 10,0 Hz

Rapporto I:E: 1:1 / 1:2 / 1:3
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 1:1

Pressione media vie respiratorie (controllo MAP):
 da 0 a 45 mbar
 Risoluzione: 1 mbar
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 5 mbar

Range Delta P: da 4 a 180 mbar
 Risoluzione: 1 mbar
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 4 mbar

Concentrazione O₂: da 21 a 100%
 Risoluzione: 1%
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 21%

Parametri aggiuntivi:

Rr Respirone: da 1 a 150 BPM
 Risoluzione: 1 BPM
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: impostata su "Off"

Impostazione predefinita
 di fabbrica: 30 BPM su "On"

Controllo Per. Insp Resp: da 0,1 a 3,0 secondi
 Risoluzione: 0,01 secondi)
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 0,40 secondi

Controllo Press. Resp.: da 0 a 45 mbar
 Risoluzione: 1 mbar
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 10 mbar

25.2.5 Modalità nCPAP S (a singolo lume)

Tempo inspiratorio (Ti): da 0,1 a 3,0 secondi
 Risoluzione: 0,01 secondi
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 0,50 secondi

Pressione CPAP: da 2 a 15 mbar
 Risoluzione: da 0,5 mbar <10 mbar,
 1 mbar >10 mbar

Impostazione predefinita
 di fabbrica: 4,0 mbar

Pressione PIP: da 2 a 25 mbar
 Risoluzione: 1 mbar
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 10 mbar

Concentrazione O₂: da 21 a 100%
 Risoluzione: 1%
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 21%

Parametri aggiuntivi:

Comando Supporto Apnea: da 1 a 10 BPM
 Risoluzione: 1 BPM
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: impostata su "Off"
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 10 BPM su "On"

Sens. trigger: dall'1% al 100%
 Risoluzione: 1%
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 50%

25.2.6 Modalità DuoPAP (a singolo lume)

Frequenza respiratoria (FR): da 1 a 60 BPM
 Risoluzione: 1 BPM
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 20 BPM

Tempo inspiratorio (Ti): da 0,1 a 3,0 secondi
 Risoluzione: 0,01 secondi
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 0,50 secondi

Pressione PEEP: da 2 a 15 mbar
 Risoluzione: da 0,5 mbar <10 mbar,
 1 mbar >10 mbar

Impostazione predefinita
 di fabbrica: 4,0 mbar

Pressione PIP: da 2 a 25 mbar
 Risoluzione: 1 mbar
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 10 mbar

Concentrazione O₂: da 21 a 100%
 Risoluzione: 1%
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 21%

25.2.7 Alti Flussi (a singolo lume)

Portata: da 2 a 30 l/min
 Risoluzione: 0,1 l/min
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 8,0 l/min.

Concentrazione O₂: da 21 a 100%
 Risoluzione: 1%
 Impostazione predefinita
 di fabbrica: 21%

25.2.8 OxyGenie

Intervallo O₂: da 21 a 100%
 Intervalli stabiliti: 90-94, 91-95, 92-96,
 94-98

25.2.8.1 Attributi OxyGenie PCLCS

Per casi di uso normale

Tempo di risposta 19 secondi
 Tempo di impostazione 29 secondi
 Eccesso di correzione 4%

Per casi d'uso peggiori

Tempo di risposta 20 secondi
 Tempo di impostazione 38 secondi
 Eccesso di correzione 4%

25.3 Modalità di funzionamento

Il ventilatore è pensato per il funzionamento continuo.

25.4 Controlli

25.4.1 Pulsante Power

Il pulsante ON/OFF ha un LED integrato per indicare lo stato del ventilatore, dove:

“LED Off” significa che l'unità è spenta e nessuna alimentazione elettrica è collegata al sistema.

Il colore “verde” indica che l'unità è accesa e pronta per l'uso,

il colore “giallo” indica che il ventilatore è spento, l'alimentazione è collegata e le batterie interne sono completamente cariche,

il colore “giallo lampeggiante” indica che il ventilatore è spento, l'alimentazione è collegata e le batterie interne sono in carica;

25.4.2 Interfaccia utente



SLE6000 è montato con un display a colori con risoluzione di 1024 da 768 pixel.


Le dimensioni dello schermo sono di 12.1” con LED retroilluminato.






Il touchscreen è di tipo resistivo a 5 fili adatto per il funzionamento quando si indossano guanti medici.




25.4.2.1 Pulsanti



I seguenti pulsanti sono accessibili dal touchscreen.


Pulsante	Descrizione
	Apri le schede modalità Singola pressione per selezionare o annullare
	Apri le schede allarme Singola pressione per selezionare o annullare
	Apri le schede strumenti Singola pressione per selezionare o annullare
	Apri le schede di layout Singola pressione per selezionare o annullare
	Apri le schede modalità Singola pressione per selezionare
	Apri le schede strumenti Singola pressione per selezionare
	Blocco funzioni Singola pressione per selezionare
	Sblocca la schermata Mantieni premuto per 1 secondo
	Ripristina allarme attivo o cancella un messaggio di allarme Singola pressione per selezionare

Pulsante	Descrizione
	Seleziona scheda sensori Singola pressione per selezionare
	Seleziona modalità CPAP Singola pressione per selezionare o annullare
	Seleziona la modalità CMV Singola pressione per selezionare o annullare
	Seleziona la modalità PTV Singola pressione per selezionare o annullare
	Seleziona la modalità PSV Singola pressione per selezionare o annullare
	Seleziona la modalità SIMV Singola pressione per selezionare o annullare
	Seleziona la modalità HFOV Singola pressione per selezionare o annullare
	Seleziona la modalità HFOV+CMV Singola pressione per selezionare o annullare
	Seleziona la modalità NCPAP Singolo o doppio lume Singola pressione per selezionare o annullare
	Seleziona modalità NIPPV Sezione doppia Singola pressione per selezionare o annullare
	Seleziona la modalità NHFOV Doppio lume solo Singola pressione per selezionare o annullare
	Seleziona la modalità alti Flussi Singolo lume Singola pressione per selezionare o annullare
	Seleziona la modalità Attesa Singola pressione per selezionare o annullare
	Scorri in alto rapido Singola pressione per selezionare
	Scorri in alto lento Singola pressione per selezionare
	Scorri in basso lento Singola pressione per selezionare
	Scorri in basso rapido Singola pressione per selezionare
	Volume % Singola pressione per selezionare o annullare
	Seleziona la calibrazione del sensore di flusso Singola pressione per selezionare

Pulsante	Descrizione
	Avvia la routine di calibrazione Singola pressione per selezionare
	Seleziona la calibrazione ossigeno Singola pressione per selezionare
	Avvia la routine di calibrazione Singola pressione per selezionare
	Seleziona la modalità schermata giorno Singola pressione per selezionare
	Seleziona la modalità schermata notte Singola pressione per selezionare
	Seleziona la % luminosità Singola pressione per selezionare
	Seleziona i pulsanti data/ora Singola pressione per selezionare
	Seleziona il pannello codice per la modalità di impostazione preferenze operatore Singola pressione per selezionare
	Seleziona il pannello codice per modalità Ingegneristica Singola pressione per selezionare
	Mostra le informazioni sul sistema Singola pressione per selezionare
	Seleziona il pannello codice per la modalità calibrazione schermata Singola pressione per selezionare
	Attiva la funzione Esportazione dati paziente Richiede l'inserimento della memoria USB. Singola pressione per selezionare
	Attiva la funzione Registro Eventi Allarmi Richiede l'inserimento della memoria USB. Singola pressione per selezionare
	Attiva la funzione esportazione foto schermata Singola pressione per selezionare
	Avvia l'esportazione dei dati selezionati. Singola pressione per selezionare - attiva solo quando la memoria USB è presente e in modalità attesa.
	Annulla l'esportazione dei dati selezionati. Singola pressione per selezionare - attiva solo quando la memoria USB è presente, in modalità attesa e l'esportazione in corso.


Pulsante	Descrizione
	Fa ritornare l'utente alla scheda Dati. Singola pressione per selezionare - attiva solo quando la memoria USB è presente, in modalità attesa e l'esportazione completa. Scade dopo 3 secondi
	Seleziona il grafico delle forme d'onda Singola pressione per selezionare
	Seleziona il grafico dei loop Singola pressione per selezionare
	Seleziona il grafico dei trend Singola pressione per selezionare
	Apre la scheda grafico selezionata Singola pressione per selezionare
	Passa da On a Off Singola pressione per selezionare o annullare
	Seleziona la forma d'onda della pressione Singola pressione per selezionare
	Seleziona la forma d'onda del flusso Singola pressione per selezionare
	Seleziona la forma d'onda del volume Singola pressione per selezionare
	Seleziona il loop di flusso/volume Singola pressione per selezionare
	Seleziona il loop flusso/pressione Singola pressione per selezionare
	Seleziona il loop volume/pressione Singola pressione per selezionare
	Seleziona il menu a discesa del trend di andamento Singola pressione per selezionare
	Pulsante Conferma impostazione Singola pressione per selezionare
	Pulsante Annulla/Esci Singola pressione per selezionare
	Attiva la funzione zoom trend Singola pressione per selezionare o annullare
	Attiva il cursore di trend Singola pressione per selezionare o annullare





Pulsante	Descrizione
	Attiva la funzione scorri trend Singola pressione per selezionare o annullare
	Aumenta impostazione Singola pressione per selezionare
	Riduci impostazione Singola pressione per selezionare
	Seleziona ventilazione circuito paziente da 10 mm Singola pressione per selezionare
	Seleziona ventilazione circuito paziente da 15 mm Singola pressione per selezionare
	Attiva tutti i parametri aggiuntivi Singola pressione per selezionare o annullare
	Attiva un respiro manuale Singola pressione per selezionare
	Attiva una pausa inspiratoria Singola pressione per selezionare o pulsante da premere per un massimo di 5 o 10 secondi a seconda della preferenza operatore impostata.
	Attiva un sospiro oscillatorio Singola pressione per selezionare
	Attiva una pausa respirone oscillatorio Singola pressione per selezionare o pulsante da premere per un massimo di 5 o 10 secondi a seconda della preferenza operatore impostata.
	Attiva OxyGenie Singola pressione per selezionare.
	Attiva una pausa oscillatoria. Premere per 2 secondi
	Mette in pausa le forme d'onda Singola pressione per selezionare Tenere premuto per 1 secondo per attivare la foto schermata.

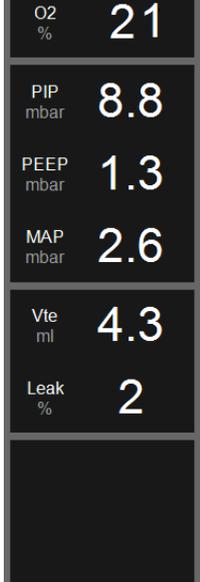Pulsante	Descrizione
	Rilascia le forme d'onda in pausa Singola pressione per selezionare Tenere premuto per 1 secondo per attivare la foto schermata.
	Salva foto schermata in memoria Premere per 3 secondi per attivare la foto schermata
	Tasti numerici da 0 a 9 Singola pressione per selezionare
	Cancellazione indietro - Annulla inserimento Singola pressione per selezionare
	Pulsante Indietro - ritorna alle schede precedenti Singola pressione per selezionare
	Pausa allarme audio Singola pressione per selezionare o annullare
	Valori misurati Tenere premuto per 1 secondo per passare dai valori della colonna singola o doppia.

25.4.2.2 Schede

Le seguenti schede sono disponibili con il touchscreen:






Schede	Descrizione
	Scheda modalità Invasiva La scheda consente di accedere alle modalità Invasive e alla selezione della grandezza del circuito. Singola pressione per selezionare
	Scheda modalità Non invasiva La scheda consente di accedere alle modalità non invasive. Singola pressione per selezionare
	Scheda modalità Attesa La scheda consente di accedere alla modalità Attesa. La modalità Attesa è attiva solo durante la ventilazione. Singola pressione per selezionare


Schede	Descrizione
	Scheda Limiti La scheda consente di accedere ai limiti di allarme. Limiti di allarme attivi solo durante la ventilazione. Singola pressione per selezionare
	Scheda Registro La scheda consente di accedere al registro allarmi. Singola pressione per selezionare
	Scheda Volume La scheda consente di accedere alla scheda di regolazione del volume. Singola pressione per selezionare
	Scheda Sensori La scheda consente di accedere alla scheda calibrazione sensore. Singola pressione per selezionare
	Scheda Luminosità La scheda consente di accedere alla scheda di regolazione della luminosità della schermata. Singola pressione per selezionare
	Scheda Sistema La scheda consente di accedere alla scheda funzioni di sistema. Singola pressione per selezionare
	Scheda Dati La scheda consente di accedere alla scheda dati. Singola pressione per selezionare

25.4.2.3 Controlli

I seguenti Controlli sono disponibili mediante il touchscreen:

Controlli	Descrizione
	Controllo Ti (Tempo inspiratorio) Range da 0,1 - 3,0 secondi Singola pressione per selezionare o annullare
	Controllo Ti Max (tempo inspiratorio massimo) Range da 0,1 - 3,0 secondi Singola pressione per selezionare o annullare
	Controllo CPAP Range 0,0 - 35 mbar Singola pressione per selezionare o annullare
	Controllo PEEP Range 0,0 - 35 mbar Singola pressione per selezionare o annullare

Controlli	Descrizione
	Controllo PIP Range 1 - 65 mbar Singola pressione per selezionare o annullare
	Controllo % ossigeno Range 21 - 100 % Singola pressione per selezionare o annullare
	Comando Supporto Apnea (frequenza respiratoria) Range 1 - 150 BPM Singola pressione per selezionare o annullare
	Controllo fronte di salita Range 1 - 150 BPM Singola pressione per selezionare o annullare
	Controllo Sens. trigger (sensibilità trigger) Range 1 - 150 l/min con sensore di flusso Range 1 - 100 % senza sensore di flusso Singola pressione per selezionare o annullare
	Controllo FR (frequenza respiratoria) Range 1 - 150 BPM Singola pressione per selezionare o annullare
	Controllo Sens. fine (sensibilità file flusso) Range 5 - 50 % Singola pressione per selezionare o annullare
	Controllo VTV (Ventilazione a volume prefissato) Vte obiettivo quando attivo. Range 2 - 300 ml Tenere premuto per 2 secondi per selezionare
	Controllo supporto Press. Range 0 - 65 mbar Tenere premuto per 2 secondi per selezionare
	Controllo ΔP (pressione Delta) Range 4 - 180 mbar Singola pressione per selezionare o annullare

Controlli	Descrizione
	Controllo MAP Range 0 - 45 mbar Singola pressione per selezionare o annullare
	Controllo frequenza Range 3 - 20 Hz Singola pressione per selezionare o annullare
	Controllo I:E (Rapporto inspirazione – espirazione) Range 3 - 20 Hz Singola pressione per selezionare o annullare
	Controllo Rr Respirone (Frequenza respiratoria alta) Range 1 - 150 BPM Tenere premuto per 2 secondi per selezionare
	Controllo Per. Insp Resp (tempo inspiratorio respiro) Range da 0,1 - 3,0 secondi Singola pressione per selezionare o annullare
	Controllo Press. Resp. (pressione respiro) Range 0 - 45 mbar Singola pressione per selezionare o annullare

25.5 Misurazione

25.5.1 Sensore di flusso

Tipo di sensore di flusso: anemometro a doppio filo caldo da 10 mm.

Parte applicata: tipo BF
Portata: da 0,2 l/min a 30 l/min
Precisione: ± 8 % massimo
Spazio morto: 1 ml
Peso: 10 g

25.5.2 Flusso

Portata: 0 l/ min s 99 l/min
Risoluzione: 0,1 l/min

25.5.3 Volume

Volume espiratorio corrente: . . da 0 a 999 ml (0,1 ml)
Volume minuto espiratorio: . . . da 0 a 18 L
Risoluzione: 1 ml

25.5.4 Precisione respiro controllato del volume Volume

Errore bias massimo: ± 3 ml
Errore linearità massima: ± 8 %

PEEP

Errore bias massimo: ± 1 mbar
Errore linearità massima: ± 18 %

Ossigeno

Errore bias massimo: ± 3 %
Errore linearità massima: $\pm 0,5$ %

25.5.5 Precisione respiro controllato dalla pressione (Ventilazione invasiva)

PIP

Errore bias massimo: ± 1 mbar
Errore linearità massima: ± 11 %

PEEP

Errore bias massimo: ± 1 mbar
Errore linearità massima: ± 18 %

Ossigeno

Errore bias massimo: ± 3 %
Errore linearità massima: $\pm 0,5$ %

25.5.6 Precisione respiro controllato dalla pressione (ventilazione non invasiva)

PIP

Errore bias massimo: ± 1 mbar

Errore linearità massima: ± 18 %

PEEP

Errore bias massimo: ± 1 mbar

Errore linearità massima: ± 18 %

Ossigeno

Errore bias massimo: ± 3 %

Errore linearità massima: $\pm 0,5$ %

25.5.7 Parametri misurati

Perdita

Intervallo di misurazione: da 0 a 99%

Risoluzione: 1%

Perdita percentuale misurata intorno al tubo endotracheale (quando si utilizza un tubo senza cuffia). La differenza tra il volume espirato e il volume inspirato espressa in valore percentuale in media più di 5 respiri. Un valore calcolato.

Valore livellato con un filtro (costante temporale pari a 10 respiri).

Frequenza respiratoria (FR)

Intervallo di misurazione: da 0 a 999 BPM

Risoluzione: 1 BPM

Il numero totale di respiri rilevati dal ventilatore (meccanici e triggerati dal paziente). Un valore misurato.

Compliance (C)

Intervallo di misurazione: da 0 a 99,9 ml/mbar

Risoluzione: 1 ml/mbar

La compliance è il rapporto tra la variazione nel volume polmonare e la variazione nelle pressioni applicate. Un valore calcolato. Valore livellato con un filtro (costante temporale pari a 3 respiri).

C20/C:

Intervallo di misurazione: da 0 a 9999,9

Risoluzione: 0,1

Tempo di campionamento: 2 ms

Si tratta del rapporto tra la compliance durante l'ultimo 20% del ciclo respiratorio e la compliance totale. Un valore calcolato. Valore livellato con un filtro (costante temporale pari a 3 respiri).

Resistenza (R)

Intervallo di misurazione: da 0 a 999 mbar l/secondo

Risoluzione: 1

La resistenza del polmone del paziente al flusso è la variazione totale nella pressione applicata al polmone del paziente diviso il flusso massimo espiratorio dal polmone. Un valore misurato.

Valore livellato con un filtro (costante temporale pari a 3 respiri).

Tempo inspiratorio (T insp)

Intervallo di misurazione: da 0 a 9,99 secondi

Risoluzione: 10 millisecondi

Il tempo inspiratorio misurato, dove il respiro può essere terminato da flusso o volume e pertanto più breve del tempo inspiratorio impostato.

Tempo espiratorio (Te)

Intervallo di misurazione: da 0 a 9,99 secondi

Risoluzione: 10 millisecondi

Il tempo espiratorio misurato, La frequenza respiratoria totale meno il tempo inspiratorio. Un valore calcolato.

Vmin (l)

Intervallo di misurazione: da 0 a 99,99 l

Risoluzione: 0,01 l

Il volume minuto è il volume corrente espiratorio accumulato in un periodo di un minuto. Un valore misurato in litri al minuto.

Trigger (Trig)

Risoluzione: 1

Il numero di respiri triggerati dal paziente (aggiornato ogni 2 secondi). Un valore misurato.

Vte (ml)

Intervallo di misurazione: da 0 a 99,9 ml

Risoluzione: 0,1 ml

Volume espirato di respiri grandi e piccoli. Un valore misurato in millimetri. Valore livellato con un filtro (costante temporale pari a 3 respiri).

DCO₂

Intervallo di misurazione: da 0 a 9999

Risoluzione: 1

Si tratta di un coefficiente di trasporto del gas. Un valore calcolato basato sul volume corrente e sulla frequenza. Valore livellato con un filtro (costante temporale pari a 3 respiri).

Rapporto I:E

Intervallo di misurazione: 1:9,9 o 9,9:1

Risoluzione: 0,1

Rapporto inspirazione – espirazione. Un valore calcolato derivato dal tempo inspiratorio impostato dall'utente rispetto al tempo diviso il valore BPM impostato dall'utente meno il tempo inspiratorio.

etCO₂

mmHg

Intervallo di misurazione: da 0 a 99,9 mmHg

Risoluzione: 0,1 mmHg

Kpa

Intervallo di misurazione: da 0 a 9,9 kPa
 Risoluzione: 0,1 kPa
 CO₂ corrente finale. Un valore misurato.

Volume %
 Intervallo di misurazione: da 0 a 100%
 Risoluzione: 1 %

SpO₂
 Intervallo di misurazione: da 0 a 100%
 Risoluzione: 1 %
 Saturazione di ossigeno nei capillari periferici. Un valore misurato.

PR (Frequenza pulsazioni)
 Intervallo di misurazione: da 0 a 999 pulsazioni al minuto
 Risoluzione: 1 pulsazione
 Un valore calcolato.

PI (Indice perfusione)
 Intervallo di misurazione: da 0 a 99 %
 Risoluzione: 0,1
 Un valore calcolato.

25.5.7.1 Concentrazione ossigeno
 Intervallo di misurazione: da 0% a 999%
 Risoluzione: 1%
 Precisione: ±3%
 Tempo di risposta: 45 secondi

25.5.7.2 Pressione
 Pressione di picco: da 0 a 999 mbar
 Risoluzione: 0,1 mbar
 Precisione: ±0,75% della scala completa

Valore calcolato

Pressione PEEP: da 0 a 999 mbar
 Risoluzione: 0,1 mbar
 Precisione: ±0,75% di scala completa

Valore calcolato

Pressione media: da -999 a 999 mbar
 Risoluzione: 0,1 mbar
 Precisione: ±0,75% della scala completa

Valore calcolato

Delta P:
 Pressione media: da 9 a 999 mbar
 Risoluzione: 1 mbar
 In modalità HFO combinata, Delta P viene misurato soltanto durante l'espirazione. Valore calcolato.

I valori sopra riportati sono stati ottenuti in condizioni di pressione e temperatura ambiente, a secco.

25.5.7.3 Trend
 Dati di trend registrati a 1 Hz

25.5.7.4 Livello pressione sonora
 Livello pressione sonora: 49 dBA
 Livello potenza sonora: 53 dBA

25.5.7.5 Dimensioni dei getti della porta del blocco di esalazione
 Getto indietro o negativo: Ø 1,45/1,5 mm
 Getto avanti o positivo: Ø 1,25/1,3 mm
 Getto medio o 3° getto: Ø 0,60/1,0 mm

25.5.8 Dichiarazione BS EN ISO 80601-2-12
Respiri controllati del volume

In base alla norma indicata in alto, la Clausola 201.12.1.101 del tipo di respiro controllato del volume, le massime imprecisioni sono contenute nelle tolleranze indicate nella Sezione 25.5.4 di questo documento.

Riferimento alla Nota 3 della clausola 201.12.1.101

Intenzionalmente, per alcuni di questi test, ovvero, quelli con una grossa compliance e grande resistenza, il flusso respiratorio finale non raggiunge zero.

In questi casi il volume effettivo fornito e il valore nella tabella 201.103 (in BS EN ISO 80601-1-12) vengono registrate le seguenti differenze:

Volumi di 50 ml e lo O₂% impostato al 60% (compliance circuito 3 ml/hPa, resistenza 200 hPa//s, BPM 30 e Ti di 0,6 sec.) l'imprecisione sale a ±12%.

PEEP ai volumi di 20 ml e lo O₂% impostato a 30% (Compliance circuito 1 ml/hPa, resistenza 200 hPa//s, BPM 60 e Ti di 0.4 sec.) l'imprecisione sale a ±38%.

Respiri controllati di pressione

In base alla norma indicata in alto, la Clausola 201.12.1.102 del tipo di respiro controllato del volume, le massime imprecisioni sono contenute nelle tolleranze indicate nella Sezione 25.5.5 di questo documento.

Riferimento alla Nota 3 della clausola 201.12.1.102

Intenzionalmente, per alcuni di questi test, ovvero, quelli con una grossa compliance e grande resistenza, il flusso respiratorio finale non raggiunge zero.

In questi casi il volume effettivo fornito e il valore nella tabella 201.104 (in BS EN ISO 80601-1-12) vengono registrate le seguenti differenze:

PIP a 15 mbar e lo O₂% impostato a 30% (Compliance circuito 20 ml/hPa, resistenza 20 hPa//s, BPM 20 e Ti di 1 sec.) l'imprecisione sale a ±11%.

PEEP a 5 mbar e lo O₂% impostato a 30% (Compliance circuito 3 ml/hPa, resistenza 50 hPa//s, BPM 30 e Ti di 0,6 sec.) l'imprecisione sale a ±34%.

25.5.9 Incertezze di misurazione

In basso sono elencate le incertezze di misurazione per le seguenti variabili monitorate:

Flusso.....	±2%
Pressione.....	±0,5%
Concentrazione ossigeno.....	±2%

25.6 Circuiti paziente

Ø 10 mm BC6188

Resistenza:.....	@15 l/min 1,5 mbar
Resistenza:.....	@30 l/min 6 mbar
Compliance:.....	1,89 ml/kPa/m
Caduta di pressione inspiratoria ed espiratoria	
5 l/min.....	0,8 mbar
2,5 l/min.....	0,38 mbar

Ø 10 mm BC6188/DHW

Resistenza:.....	@15 l/min 1,5 mbar
Resistenza:.....	@30 l/min 6 mbar
Compliance:.....	1,89 ml/kPa/m
Caduta di pressione inspiratoria ed espiratoria	
5 l/min.....	1,50 mbar
2,5 l/min.....	0,25 mbar

Ø 15 mm BC6198

Resistenza:.....	@15 l/min 0,3 mbar
Resistenza:.....	@30 l/min 1,0 mbar
Compliance:.....	3,72 ml/kPa/m
Caduta di pressione inspiratoria ed espiratoria	
5 l/min.....	0,15 mbar
2,5 l/min.....	0 mbar

25.7 Filtri del sistema di respirazione

25.7.1 N3029

Efficienza di filtrazione:.....	BFE 99,999% VFE 99,992%
Resistenza	
@ 30 l/min:.....	160 pa
Spazio morto:.....	65ml
Connessioni:.....	22M/15F-22F/15M
Peso:.....	40 gm
Cicli di sterilizzazione in autoclave:.....	
	5

25.7.2 N3587

Efficienza di filtrazione:.....	BFE 99,99% VFE 99,99%
Resistenza	
@ 30 l/min:.....	49,5 pa
Spazio morto:.....	30 ml
Connessioni:.....	22M/15F-22F
Peso:.....	23 gm

25.7.3 N3588

Efficienza di filtrazione:.....	BFE 99,99995% VFE 99,99985%
Resistenza	
@ 30 l/min:.....	76 pa
Spazio morto:.....	30 ml
Connessioni:.....	22M/15F-22F/15M
Peso:.....	25 gm

25.8 Pressioni limitate massime

PLIM convenzionale.....	120 mbar (condizione di guasto singola)
-------------------------	---

25.9 Alimentazioni gas

Come gas fresco si utilizzano alimentazioni di aria e ossigeno ad alta pressione di gas.

25.9.1 Alimentazione ossigeno

Il ventilatore richiede un'alimentazione di ossigeno per uso medico tra 2,8 e 6 bar.

25.9.2 Alimentazione aria

Il ventilatore richiede un'alimentazione di aria compressa per uso medico conforme alla norma ISO8573.1, Classe 1.4.1 (livello minimo di filtrazione), compresa tra 2,8 e 6 bar.

Il livello di filtrazione consigliato è di classe 1.1.1.

Descrizione della classe 1.4.1

1= Numero massimo di particelle per metro cubico come funzione della dimensione della particella.

Da 0,1 µm a 0,5 µm : < 20 000

Da 0,5 µm a 1,0 µm : < 400

Da 1,0 µm a 5,0 µm : < 10

4 = Punto di rugiada della pressione di +3 °C.

1= contenuto olio 0,01 mg/m³

Descrizione della classe 1.1.1

1= dimensione della particella di 0,1 micron.

1 = Punto di rugiada della pressione di -70 °C.

1= contenuto olio 0,01 mg/m³

Se l'alimentazione di aria compressa risulta inferiore ai requisiti della norma ISO8573.1, è necessaria la filtrazione in linea dell'aria.

25.9.2.1 Connettori

P/N° Z6000/NST	
Connettore aria	NIST (ISO 18082:2014)
Connettore ossigeno	NIST (ISO 18082:2014)
P/N° Z6000/DIS	
Connettore aria	DISS
Connettore ossigeno	DISS

25.9.3 Flussi

Flusso gas fresco variabile:	da 2 a 30 l/min
Risoluzione:	1l/min
Massimo flusso di gas:	85 l/min
Risoluzione:	1 l/min
Flusso nebulizzatore:	7 l/min
Risoluzione:	1l/min

25.10 Durata utile

Il ventilatore SLE6000 ha una durata utile di 10 anni dalla data di messa in servizio.

25.11 Alimentazione, Dimensioni, Classificazione

25.11.1 Alimentazione CA

Tensione di rete:	100-240 V/ 50-60 Hz
	Alimentazione: 115 VA
Fusibile:	T2.5AH 250 V
	(5 x 20 mm) (Q.tà 2)

Il ventilatore funzionerà generalmente per oltre 3 ore con la carica della batteria al 100%, sia in modalità convenzionale che HFO. La durata effettiva della scarica dipenderà dalla condizione della batteria e dalle impostazioni di ventilazione applicate.

Carica della batteria:	Carica completa 18 ore
	80% carica 8 ore

25.11.2 Alimentazione CC

Tensione:	24 V 4 A (Richiede un'alimentazione per uso medico)
Connettore:	EN3 serie connettore maschio a 2.2 vie. (Switchcraft EN32F16X)

25.12 Ambiente operativo

Temperatura:	da +10°C a +40°C
Umidità relativa:	da 10 a 90% (senza condensa)
Pressione ambiente:	620 mbar (4000 m) a 1060 mbar (livello del mare)
Dimensioni del solo ventilatore:	330 mm L x 369 mm A x 548 mm P
Altezza sull'asta:	1310 mm
Peso (ventilatore):	22 Kg

Nota: il ventilatore mantiene la precisione delle variabili controllate e visualizzate quando si utilizza oltre i limiti stabiliti di temperatura, umidità e pressione ambiente.

25.12.1 Connettori

Porta di scarico:	15 mm (F) /22 mm (M) Conica in base a ISO5356-1
Porta prossimale delle vie respiratorie:	5 mm non conica
Porta gas fresco:	15 mm (M) Conica in base a ISO5356-1
Porta nebulizzatore:	5 mm Non conica

25.13 Classificazione (elettrica)

Tipo di protezione contro le scosse elettriche: Classe I.
Grado di protezione contro gli shock elettrici: parte applicata di tipo BF
L'unità deve essere messa a terra.

25.14 Numero di classificazione GMDN

GMDN: 14361

25.15 Protezione IP

Tipo di protezione contro l'ingresso dell'acqua: IP21
Primo numero 2: Protetto contro gli oggetti solidi estranei di 12,5 mm di diametro o maggiore
Secondo numero 1: Protezione contro le cadute d'acqua verticali.

25.16 Condizioni ambientali di immagazzinaggio

Se imballato per il trasporto o l'immagazzinaggio
Temperatura ambiente: da -20°C a +50°C
Umidità relativa: da 10% a 90% senza condensa
Pressione atmosferica: da 500 mbar a 1060 mbar

26. Porte di uscita (elettriche)

26.1 Porta RS232

SLE6000 ha due versioni di uscita dati

Uscita dati base (V2.0) elencati in basso o uscita dati migliorata (V3.0)

Vedere "Uscita dati migliorata SLE6000 (V3.0)" a pagina 175. per descrizione.

26.2 Uscita dati base SLE6000 (V2.0).

L'uscita dati base del ventilatore SLE6000 è il protocollo predefinito utilizzato per l'uscita dei dati dal ventilatore a un monitor medico esterno.

I dati sono stringhe ASCII delimitate da virgole di 63 parametri di dispositivo.

26.2.1 Specifiche uscita dati base SLE6000 (V2.0)

L'uscita dati base di SLE6000 contiene il formato Inizio, dati e chiusura.

Inizio	Dati	Chiusura
ID dispositivo, Versione, Unità di pressione, Numero di parametri	63 parametri, separati da virgola	CRC, ritorno a capo, Avanzamento linea

I dati sono in uscita con una baud rate fissa, senza bit di parità o collegamento hardware. Il protocollo è unidirezionale e non richiede una risposta dal monitor medico collegato. Il protocollo non consente la trasmissione dei dati dal monitor medico; qualsiasi dato ricevuto dal ventilatore SLE6000 sarà ignorato.

26.2.2 Impostazioni di comunicazione (V2.0)

Il protocollo SLE viene trasmesso utilizzando il formato RS232, con una baud rate fissa. L'interfaccia di comunicazione utilizza le seguenti impostazioni RS232:

Tipo impostazione	Valore
Baud Rate	19,200 bps
Parità	Nessuno
Bit di dati	8
Bit di stop	1
Formato dati	Stringa di testo ASCII
Controllo di flusso	Nessuno

26.2.2.1 Velocità dati e dimensioni (V2.0)

La trasmissione della stringa dei dati inizia ogni 1 secondo. La dimensione massima di ogni stringa ASCII è 512 byte.

26.2.2.2 Formato dati

I dati all'interno dell'uscita dati base SLE6000 sono implementati come formato di stringa ASCII delimitato da virgola. Tutti i dati validi sono rappresentati utilizzando caratteri alfanumerici. I caratteri sono utilizzati per rappresentare i dati che sono fuori intervallo o non validi per un motivo diverso e saranno utilizzati al posto del valore di parametro.

Caratteri	Caso d'uso	Descrizione
'?'	Dati non validi	I dati che sono sconosciuti o scaduti saranno sostituiti da '?'.
'-'	Dati fuori intervallo	Ogni dato ha un intervallo associato. I dati fuori da questo intervallo sono sostituiti da '-'.
','	Separazione dei parametri	
<CR><LF>	Fine della stringa di uscita	Ritorno a capo, Avanzamento linea. Utilizzati per indicare la fine di una trasmissione di dati

26.2.3 Grafico dati

Un esempio di uscita è mostrato in basso. Le sezioni iniziali e finali sono mostrate in grassetto e i dati in corsivo.

Inizio	Dati	Chiusura
SLE6000,V2.0,0,63,30,-,15,40,15,21,4,-,?, ?, ?, ?, 1,0, ?, ?, 4, ?, ?, 35, ?, 10,90,110,200,0,300,0,18000,20,50,88,99,100,180,0,0,40,0,0,0,0,0,0,0,0,-,-,-,-,-,-, ?, ?, ?, ?, ?, -, -, -, -, -, 64,6968		

Formato iniziale

Nome parametro	Descrizione	Valore
ID ventilatore	Unico per ogni tipo di ventilatore ovvero "SLE6000"	SLE6000
ID versione	ID versione protocollo	V2.0
Unità di pressione	Le unità di tutti i valori di pressione visualizzati. mbar o cmH ₂ O	'0' - mbar, '1' - cmH ₂ O
Numero parametro	Il numero di uscita dei parametri.	63

Formato finale

Descrizione	Numero di caratteri	Intervallo
Valore CRC	4	0000 – FFFF
Ritorno a capo	1	<CR> (0x0D)
Avanzamento linea	1	<LF> (0x0A)

26.2.4 Formato dati

I dati contengono 63 parametri che sono emessi in un ordine fisso. Ogni parametro ha un limite e un ordine definiti. Ogni parametro viene emesso in formato intero.

La validità di ogni parametro viene verificata prima della trasmissione dal ventilatore SLE6000.

Nota: se il parametro Unità di pressione è sconosciuto, tutti i parametri relativi alla pressione sono sostituiti dal carattere di dati non validi.

N°	Nome	Descrizione	Unità	Intervallo di uscita (intervallo fisico)
1	RR	Impostazione frequenza respiratoria (Respiri per minuto).	Respiri/min	1 – 150 0 se Supporto Apnea è OFF
2	CPAP	Impostazione valore CPAP.	0,1 * unità di pressione	0 – 350 (0 – 35 mbar o cmH ₂ O)
3	Volume corrente	Impostazione volume corrente prefissato	0,2ml	10 – 1500 (2 – 300 ml) 15 – 1500 (3 – 300ml) con sensore etCO ₂ connesso
4	Ti (T insp)	Impostazione tempo inspiratorio prefissato	0,01 s	10 – 300 (0,10 – 3,00 s)
5	PIP	Impostazione pressione PIP	Unità di pressione (1 mbar o 1 cmH ₂ O)	0 – 65 (mbar o cmH ₂ O) 2 – 25 (mbar or cmH ₂ O) in nCPAP S, DuoPAP Valore Press. Resp. in HFOV, nHFOV
6	O2	Impostazione concentrazione di ossigeno	%	21 – 100
7	HFO Delta P	Impostazione Delta P HFO	Unità di pressione	4 – 180 (mbar o cmH ₂ O)
8	HFO MAP	Impostazione pressione media HFO	Unità di pressione	0 – 45 (mbar o cmH ₂ O)
9	Frequenza HFO	Impostazione frequenza HFO	0,1Hz	30 – 200 (3,0 – 20,0Hz)
10	Rr Respirone	Frequenza respiratoria di backup in modalità HFO	Respiri/min	0 – 150 '-' se il ciclo del respiro non è abilitato.
11	Per. Insp Resp	Tempo inspiratorio in modalità HFO, per respiri Sigh	0,01 s	10 – 300 (0,10 – 3,00 s) '-' se il ciclo del respiro non è abilitato.
12	Press. Resp.	Pressione applicata ai respiri Sigh, modalità HFO.	Unità di pressione	0 – 45 (mbar o cmH ₂ O) '-' se il ciclo del respiro non è abilitato.
13	Modalità di ventilazione	n/a	n/a	Utilizza l'elenco di modalità Respiri enumerate: CPAP = 0 CMV = 1 PTV = 2 PSV = 7 SIMV = 3 HFO solo = 4 HFO + CMV = 5 nCPAP D= 9 NIPPV (doppio lume)= 10 NIPPV Tr = 11 NHFOV (doppio lume)= 12 NCPAP (singolo lume)=13 DuoPAP =14 Alti Flussi = 16 Attesa = 17
14	Stato VTV	N/A	N/A	0 = OFF. 255 = ON
15	Sensibilità fine flusso	Impostazione % del flusso massimo di respirazione che comanda il trigger di fine flusso di respirazione.	%	5 – 50 '-' se OFF
16	Soglia trigger respiro	Soglia trigger prefissata	0,1 Lpm per basso trigger. Se la pressione è triggerata, 0,5%	2 – 200 (0,2 – 20 l/min per trigger di flusso. 1 – 100% per trigger di pressione)

Dati tecnici

N°	Nome	Descrizione	Unità	Intervallo di uscita (intervallo fisico)
17	Fronte di salita	Tempo impiegato per il raggiungimento della curva di pressione del 99% della pressione prefissata	10 ms	0 – 300 (0.00 – 3.00 s)
18	Impostazione flusso (modalità O2)	Flusso porta espiratoria con modalità supporto O2.	0,1 l/min	50 – 300 (5,0 – 30,0l/mbar)
19	Nebulizzatore abilitato	Il nebulizzatore è collegato e abilitato.	ON/OFF	255 = ABILITATO 0 = DISABILITATO.
20	Allarme di perdita al paziente	Valore allarme di perdita	%	5 – 50 '-' se OFF
21	Allarme apnea	Tempo impiegato per triggerare l'allarme apnea	Secondi	5 – 60 '-' quando l'allarme Apnea è disattivato
22	Allarme pressione bassa	Valore per triggerare l'allarme di pressione bassa	0,1 * unità di pressione	-2200 – 1100 (-220 – 110 mbar o cmH2O)
23	Allarme PEEP alta	Soglia di allarme PEEP alta.	Unità di pressione 0,1*	0 – 450 (0 – 25,5 ml/mbar) 1 – 450 (1 – 45,0 cmH2O)
24	Allarme errore di ciclo	Soglia di allarme errore di ciclo.	0,1 * unità di pressione	0 – 640 (0 – 64 mbar o cmH2O)
25	Allarme PIP alta Allarme Paw alta in HFOV, HFOV+ CMV e nHFOV	Valore per triggerare l'allarme di alta pressione	0,1 * unità di pressione	10 – 1750 (1 – 175 mbar) 50 – 1750 (5 – 175 cmH2O)
26	Allarme volume corrente basso	Valore per triggerare l'allarme volume corrente basso	0,1ml	0 – 3950 (0 – 395ml)
27	Allarme volume corrente alto	Valore per triggerare l'allarme volume corrente alto	0,1ml	10 – 4000 (1 – 400ml)
28	Allarme volume minuto basso	Valore per triggerare l'allarme volume minuto (basso)	ml	0 – 17900 (0 – 17,90l)
29	Allarme volume minuto alto	Valore per triggerare l'allarme volume minuto (alto)	ml	10 – 18000 (0,01l – 18 l)
30	Allarme etCO2 basso	Allarme concentrazione CO2 corrente finale bassa	Unità etCO2 (come mostrate nel parametro 54)	0 – 145
31	Allarme etCO2 alto	Allarme concentrazione CO2 corrente finale alta	Unità etCO2 (come mostrate nel parametro 54)	5 – 150
32	Allarme spO2 basso	Allarme concentrazione spO2 basso	%	1 – 98
33	Allarme spO2 alto	Allarme concentrazione spO2 alto	%	2 – 99 e '-' se OFF
34	Allarme frequenza pulsazioni bassa	Allarme frequenza pulsazioni bassa	Battiti/min	30 – 230
35	Allarme frequenza pulsazioni alta	Allarme frequenza pulsazioni alta	Battiti/min	35 – 235 '-' se OFF
36	FR calcolata (frequenza respiratoria)	Conteggio totale dei respiri nell'ultimo minuto	Respiri/min	0 – 255
37	CPAP calcolata	Valore CPAP calcolato	0,1 * unità di pressione	- 1 – 32767 (-0,1 – +3276,7 mbar) - 1 – 32767 (-0,1 – +3276,7 cmH2O)
38	Ti calcolata	Tempo inspiratorio calcolato.	0,01 s	0 – 9900 (0.00 – 99.0s)
39	V insp calcolato	Volume inspiratorio calcolato	0,1ml	0 – 32767 (0 – 3,2767l)
40	Vte misurata	Volume espiratorio calcolato	0,1ml	0 – 32767 (0 – 3,2767l)
41	PEEP misurata	Valore PEEP misurato	0,1 * unità di pressione	- 1 – 32767 (-0,1 – +3276,7 mbar) - 1 – 32767 (-0,1 – +3276,7 cmH2O)
42	PIP misurata	Valore PIP misurato	0,1 * unità di pressione	- 1 – 32767 (-0,1 – +3276,7 mbar) - 1 – 32767 (-0,1 – +3276,7 cmH2O)

Dati tecnici

N°	Nome	Descrizione	Unità	Intervallo di uscita (intervallo fisico)
43	Concentrazione ossigeno	Concentrazione ossigeno misurata come % della composizione dell'aria	%	18 – 100 '-' durante la calibrazione O2
44	Delta P HFO calcolata	La differenza tra la pressione minima e massima in modalità HFO.	Unità di pressione	0 – 255
45	HFO MAP calcolata	Pressione media HFO calcolata	0,1* unità di pressione	-2200 – 1100 (-220 – +110 mbar) - 2200 – 1100 (-220 – +110 cmH ₂ O)
46	Conteggio trigger	Numero di respiri triggerati dal paziente nell'ultimo minuto	Respiri/min	0 – 255
47	Volume minuto calcolato	Modifica volume calcolato nell'ultimo minuto	ml	0 – 18900l (0.00 – 18.9l)
48	Perdita	% calcolata di perdita aria dal sistema	%	0 – 99
49	Resistenza	Resistenza calcolata vie respiratorie	0,1 (mbar o mmH2O.s./litro)	0 – 9990 (0 – 999 mbar/l/s o cmH ₂ O/l/s)
50	Conformità	Compliance vie respiratorie dinamica calcolata	0,1 ml/mbar (0,1 ml/unità di pressione)	0 – 254 (0.0 – 25.4 ml/mbar o ml/cmH ₂ O)
51	C20/C	Il rapporto della compliance nel corso dell'ultimo 20% dell'aumento di pressione rispetto alla compliance totale	0,1	0 – 99 (0,0 – 9,9)
52	DCO ₂	Coefficiente di trasporto del gas	1	0 – 65534
53	etCO ₂	Pressione CO ₂ corrente fine calcolata	mmHg	0 – 150 (mmHg)
54	Unità etCO ₂	Unità di pressione etCO ₂	N/A	0 = mmHg, 1 = Percentuale volume, 2 = kPa
55	SpO ₂	Saturazione di ossigeno	0,1%	0 – 250 (0.0 – 100.0%)
56	Frequenza pulsazioni	Frequenza pulsazioni	Battiti/minuto	25 – 239
57	PCO ₂	Pressione parziale anidride carbonica	mmHg	0 – 2000 (0,0 – 200,0 mbar)
58	PO ₂	Pressione parziale dell'ossigeno	mmHg	0 – 2000 (0,0 – 200,0 mbar)
59	Non assegnata	N/A	N/A	'-'
60	Non assegnata	N/A	N/A	'-'
61	Non assegnata	N/A	N/A	'-'
62	Non assegnata	N/A	N/A	'-'
63	Stato allarme	L'allarme attivo corrente. Vedere (tabella 6)	N/A	Vedere tabella allarmi

Tabella allarmi

Codice allarmi	Descrizione dell'allarme
1	Sensor O2 disconnesso. Riconnettere
2	La cella di misura ossigeno necessita di calibrazione.
3	Necessita sostituzione della cella di ossigeno.
4	Errore di calibrazione ossigeno
5	Alta concentrazione di ossigeno.
6	Bassa concentrazione di ossigeno.
15	Sensore Pressione Guasto. Porre il ventilatore fuori uso
16	Soglia di alta pressione superata.
17	Pressione bassa
18	Apnea.
19	Errore di ciclo.
20	Prolungata pressione positiva
21	CPAP alta
22	PEEP alta
23	PIP alta
24	PIP bassa
25	Errore Comunicazione Mon. Isolato. Riavviare ventilatore
26	Errore Sistema Monitor Isolato. Riavviare Ventilatore
27	Impossibile calibrare il flusso ADC. Nota: applicabile per l'Utilità tecnica
28	Calibrare il sensore di flusso.
29	Impossibile calibrare il sensore di flusso.
30	Sensore di flusso non connesso.
31	Sensore di flusso difettoso.
32	Sensore di flusso contaminato.
40	Allarme Errore Sistema. Porre il ventilatore fuori uso
41	Non utilizzato in V2.0.90
45	Batteria scarica.
46	Mancanza di alimentazione elettrica.
47	Errore Batteria. Porre il ventilatore fuori uso
48	Batteria scarica.
50	Volume minuto alto
51	Volume minuto basso
52	Volume corrente basso
53	Perdita elevata al paziente.
54	Apnea
55	Respiro non rilevato.
56	Volume corrente alto
60	Gas fresco bloccato. Verifica circuito paziente.
61	Perdita gas fresco. Verifica circuito paziente.

Codice allarmi	Descrizione dell'allarme
62	Mancanza ossigeno
63	Mancanza aria
64	Mancanza gas.
68	L'interfaccia Utente si è resettato. Controllare impostazioni ventilatore
71	Errore sistema Controller. Riavviare ventilatore
72	Errore Hardware Controller. Riavviare Ventilatore
73	Allarme Errore Sistema. Porre il ventilatore fuori uso
75	Controllo uscita dati. Nota: l'allarme passa al messaggio di stato al momento del reset.
80	Pressione inferiore a quella ambiente - 1
81	Pressione inferiore a quella ambiente - 2
82	Sensore di flusso malfunzionante
83	Sensore di flusso non montato correttamente
90	Aumento inatteso della pressione media
91	Diminuzione inattesa della pressione media
96	Rilevata variazione di pressione.
97	Aumento inatteso del Delta P.
98	Diminuzione inattesa del Delta P.
99	PAW alta
100	Guasto comunicazione interna. Porre fuori uso il ventilatore.
101	Errore di sistema 101 (Errore checksum memoria) - allarme ridondante
102	Errore di sistema 102 (Errore checksum memoria) - allarme ridondante
103	Errore di sistema 103 (Errore checksum memoria) - allarme ridondante
104	Errore di sistema 104 (Errore checksum memoria) - allarme ridondante
105	Errore di sistema 105 (Errore checksum memoria) - allarme ridondante
106	Calibrazione non possibile. Porre il ventilatore fuori uso
114	Errore Alimentazione elettrica Nota: ogni volta che il sotto-sistema di monitoraggio non riesce a comunicare con l'alimentazione elettrica
115	Errore Alimentazione elettrica. Porre il ventilatore fuori uso
116	Errore hardware Monitor. Porre il ventilatore fuori uso
117	Errore hardware Monitor. Porre il ventilatore fuori uso
118	Errore Alimentazione elettrica. Riavviare ventilatore Nota: quando l'allarme "Errore Alimentazione elettrica" viene attivato per più di 5 eventi, il messaggio cambia in
120	Frequenza respiratoria alta
255	Errore Interno UI. Riavviare Ventilatore
Allarme CO2 corrente finale	
151	Guasto hardware SpO2/etCO2
180	Nessun modulo etCO2 connesso
181	Guasto modulo etCO2 - 1

Codice allarmi	Descrizione dell'allarme
182	Guasto modulo etCO2 - 2
183	Guasto modulo etCO2 - 3
184	Eseguire calibrazione etCO2 NB: messaggio di stato
185	Eseguire manutenzione etCO2 NB: messaggio di stato
186	Nessuna Linea filtro etCO2 connessa
189	Sostituire la linea filtro etCO2
190	Guasto modulo etCO2 - 4
191	Guasto modulo etCO2 - 5
192	Valore CO2 non valido
193	Valore CO2 fuori intervallo
194	Nessun respiro etCO2
197	etCO2 alto
198	etCO2 basso
201	etCO2 alto
202	etCO2 basso
203	etCO2 Spont alto
204	Spurgo etCO2 NB: messaggio di stato
205	Modalità automanutenzione etCO2 NB: messaggio di stato
206	Pompa etCO2 Off NB: messaggio di stato
207	Inizializzazione etCO2 NB: messaggio di stato
Allarme SpO ₂	
151	Guasto hardware SpO2/etCO2
153	Nessun modulo SpO2 connesso
154	Nessun sensore SpO2 connesso
155	Guasto hardware SpO2 - 3
156	Guasto hardware SpO2 - 1
157	Sensore SpO2 difettoso - 1
158	Indice perfusione basso (SpO2) NB: messaggio di stato
159	Ricerca pulsazioni NB: messaggio di stato
160	Rilevata interferenza sensore SpO2
161	Sensore SpO2 Off paziente
162	Troppa luce ambiente (SpO2) NB: messaggio di stato
163	Sensore SpO2 difettoso - 2
164	Segnale IQ SpO2 basso NB: messaggio di stato
166	Nessun sensore SpO2 adesivo connesso (Continuare senza sensore SpO2)
167	Guasto hardware SpO2 - 2
168	SpO2 alto

Codice allarmi	Descrizione dell'allarme
169	SpO2 basso
170	Frequenza pulsazioni alta
171	Frequenza pulsazioni bassa
172	Pulsazioni non rilevate (SpO2)
173	Nessun cavo SpO2 connesso (continuare senza sensore SpO2)
84	Errore Comunicazione Monitor. Riavviare Ventilatore
208	O2 > 60%
210	OxyGenie non disponibile.
211	Oxygenie inatteso reset

26.3 Uscita dati migliorata SLE6000 (V3.0)

L'uscita dati migliorata del ventilatore SLE6000 è il protocollo richiesto utilizzato per l'uscita dei dati dal ventilatore a un monitor medico esterno.

I dati sono stringhe ASCII delimitate da virgole di 70 parametri di dispositivo.

26.3.1 Specifiche uscita dati migliorata SLE6000 (V3.0)

L'uscita dati base di SLE6000 contiene il formato Inizio, dati e chiusura.

Inizio	Dati	Chiusura
ID dispositivo, Versione, Unità di pressione, Numero di parametri	70 parametri, separati da virgola	CRC, ritorno a capo, Avanzamento linea

I dati sono in uscita con una baud rate fissa, senza bit di parità. Il protocollo è unidirezionale e richiede collegamento hardware dal monitor medico collegato (eg: formato stringa-
"REQUEST_SLE_PRTCL_V3_NUMBER")

26.3.2 Impostazioni di comunicazione (V3.0)

Il protocollo SLE viene trasmesso utilizzando il formato RS232, con una baud rate fissa. L'interfaccia di comunicazione utilizza le seguenti impostazioni RS232:

Tipo impostazione	Valore
Baud Rate	19,200 bps
Parità	Nessuno
Bit di dati	8
Bit di stop	1
Formato dati	Stringa di testo ASCII
Controllo di flusso	Nessuno

26.3.2.1 Velocità dati e dimensioni (V3.0)

La trasmissione della stringa dei dati inizia ogni 1 secondo. La dimensione massima di ogni stringa ASCII è 512 byte.

26.3.2.2 Formato dati

I dati all'interno dell'uscita dati base SLE6000 sono implementati come formato di stringa ASCII delimitato da virgola. Tutti i dati validi sono rappresentati utilizzando caratteri alfanumerici. I caratteri sono utilizzati per rappresentare i dati che sono fuori intervallo o non validi per un motivo diverso e saranno utilizzati al posto del valore di parametro.

Caratteri	Caso d'uso	Descrizione
'?'	Dati non validi	I dati che sono sconosciuti o scaduti saranno sostituiti da '?'.
'-'	Dati fuori intervallo	Ogni dato ha un intervallo associato. I dati fuori da questo intervallo sono sostituiti da '-'
','	Separazione dei parametri	
<CR><LF>	Fine della stringa di uscita	Ritorno a capo, Avanzamento linea. Utilizzati per indicare la fine di una trasmissione di dati

26.3.3 Grafico dati

Un esempio di uscita è mostrato in basso. Le sezioni iniziali e finali sono mostrate in grassetto e i dati in corsivo.

```

Inizio                               Dati
SLE6000,V3.0,0,70,-,0,-,10,65,66,-,-,-,-,-,0,0,-,50,
4,-,-,35,15,10,50,580,700,10,600,0,18000,-,-,-,-,-,0,
0,0,0,0,-,32767,21,-,-,0,-,-,32767,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,
17,80,-,-,-,-,-,-,2344
Chiusura
    
```

Formato iniziale

Nome parametro	Descrizione	Valore
ID ventilatore	Unico per ogni tipo di ventilatore ovvero "SLE6000"	SLE6000
ID versione	ID versione protocollo	V3.0
Unità di pressione	Le unità di tutti i valori di pressione visualizzati. mbar o cmH ₂ O	'0' - mbar, '1' - cmH ₂ O
Numero parametro	Il numero di uscita dei parametri.	70

Formato finale

Descrizione	Numero di caratteri	Intervallo
Valore CRC	4	0000 – FFFF
Ritorno a capo	1	<CR> (0x0D)
Avanzamento linea	1	<LF> (0x0A)

26.3.4 Formato dati

I dati contengono 70 parametri che sono emessi in un ordine fisso. Ogni parametro ha un limite e un ordine definiti. Ogni parametro viene emesso in formato intero.

La validità di ogni parametro viene verificata prima della trasmissione dal ventilatore SLE6000.

Nota: se il parametro Unità di pressione è sconosciuto, tutti i parametri relativi alla pressione sono sostituiti dal carattere di dati non validi.

N°	Nome	Descrizione	Unità	Intervallo di uscita (intervallo fisico)
1	RR Supporto Apnea (in CPAP, nCPAP S, nCPAP D)	Impostazione frequenza respiratoria/ Frequenza respiratoria di backup (respiri al minuto).	Respiri/min	1 – 150 0 – 10 (nCPAP S) 0 – 60 (DuoPAP) '- se Supporto Apnea è Off in CPAP, nCPAP D, nCPAP S
2	CPAP (in modalità CPAP, nCPAP S, nCPAP D) PEEP (in CMV, SIMV, PTV, PSV, HFOV+CMV, NIPPV, DuoPAP, NIPPV Tr)	Impostazione valore CPAP/ PEEP.	0,1 * unità di pressione	0 – 350 (0,0 – 35,0 mbar o cmH2O) 20 – 150 (2.0 – 15.0 mbar o cmH2O) in nCPAP S, DuoPAP
3	Volume corrente	Impostazione volume corrente prefissato	0,2ml	10 – 1500 (2,0 – 300 ml) 10 – 250 (2.0 – 50ml) HFOV senza sensore etCO2 connesso 15 – 250 (3.0 – 50 ml) HFOV con il sensore etCO2 connesso
4	Ti (T insp) Ti Max in PSV	Impostazione tempo inspiratorio prefissato	0,01 s	10 – 300 (0,10 – 3,00 s)
5	PIP	Impostazione pressione PIP	Unità di pressione (1 mbar o 1 cmH2O)	0 – 65 (mbar o cmH2O) 2 – 25 (mbar o cmH2O)
6	O2	Impostazione concentrazione di ossigeno	%	21 – 100
7	HFO Delta P	Impostazione Delta P HFO	Unità di pressione	4 – 180 mbar o cmH2O
8	HFO MAP	Impostazione pressione media HFO	Unità di pressione	0 – 45 (mbar o cmH2O)
9	Frequenza HFO	Impostazione frequenza HFO	0,1Hz	30 – 200 (3,0 – 20,0Hz)
10	Rr Respirone	Frequenza respiratoria di backup in modalità HFO	Respiri/min	0 – 150 '- se RR Respirone non è abilitato.
11	Per. Insp Resp	Tempo inspiratorio in modalità HFO, per respiri Sigh	0,01 s	10 – 300 (0,10 – 3,00 s)
12	Press. Resp.	Pressione applicata ai respiri Sigh, modalità HFO.	Unità di pressione	0 – 45 (mbar o cmH2O)

Dati tecnici

N°	Nome	Descrizione	Unità	Intervallo di uscita (intervallo fisico)
13	Modalità di ventilazione	n/a	n/a	Utilizza l'elenco di modalità Respiri enumerate: CPAP = 0 CMV = 1 PTV = 2 PSV = 7 SIMV = 3 HFO solo = 4 HFO + CMV = 5 nCPAP D = 9 NIPPV (doppio lume) = 10 NIPPV Tr = 11 NHFOV (doppio lume) = 12 NCPAP (singolo lume) = 13 DuoPAP = 14 Alti Flussi = 16 Attesa = 17
14	Stato VTV	N/A	N/A	0 = OFF 255 = ON
15	Sensibilità di fine flusso	Impostazione % del flusso massimo di respirazione che comanda il trigger di fine flusso di respirazione.	%	5 – 50 * Se Supporto Press. è OFF
16	Soglia trigger respiro	Soglia trigger prefissata	0,1 Lpm per basso trigger. Se la pressione è triggerata, 0,5%	2 – 200 (0,2 – 20,0 l/min per il trigger di flusso; 1 – 100% per il trigger di pressione)
17	Fronte di salita	Tempo impiegato per il raggiungimento della curva di pressione del 99% della pressione prefissata	10 ms	0 – 300 (0.00 – 3.00 s) * se non disponibile.
18	Impostazione flusso (modalità O2)	Flusso porta espiratoria con modalità supporto O2.	0,1 l/min	20 – 300 (2,0 – 30,0 l/mbar)
19	Nebulizzatore abilitato	Il nebulizzatore è collegato e abilitato.	ON/OFF	255 = ABILITATO 0 = DISABILITATO.
20	Allarme di perdita al paziente	Valore allarme di perdita	%	5 – 50 = ON. * = OFF
21	Allarme apnea	Tempo impiegato per triggerare l'allarme apnea	Secondi	5 – 60 * se l'allarme Apnea è disattivato
22	Allarme pressione bassa Allarme Paw bassa in HFOV, HFOV+ CMV e nHFOV	Valore per triggerare l'allarme di pressione bassa	0,1 * unità di pressione	Da -100 a +340 (da -10 a +34 mbar o cmH2O) in modalità convenzionale e NIV Da -650 a +340 (da -65 a +34 mbar o cmH2O) in HFOV, nHFOV Da -750 a +340 (da -75 a +34 mbar o cmH2O) in HFO+CMV
23	Allarme PEEP alta Allarme CPAP alta in CPAP, nCPAP D e nCPAP S	Soglia di allarme PEEP alta.	Unità di pressione 0,1*	10 – 450 (1 – 45 mbar o cmH2O) 10 – 250 (1- 25 mbar o cmH2O) in nCPAP S e DuoPAP
24	Allarme errore di ciclo	Soglia di allarme errore di ciclo.	0,1 * unità di pressione	0 – 640 (0 – 64 mbar o cmH2O) 0 – 240 (0 – 24 mbar o cmH2O) in nCPAP S e DuoPAP

Dati tecnici

N°	Nome	Descrizione	Unità	Intervallo di uscita (intervallo fisico)
25	Allarme PIP alta Allarme Paw alta in HFOV, HFOV+ CMV e nHFOV	Valore per triggerare l'allarme di alta pressione	0,1 * unità di pressione	50 – 800 (5 – 80 mbar o cmH2O) in CPAP, CMV, SIMV, PTV, PSV, nCPAP D, NIPPV D, NIPPV Tr. 50 - 400 (5 - 40 mbar o cmH2O) in nCPAP S, DuoPAP; 100 – 1550 (10 – 155 mbar o cmH2O) in HFOV, nHFOV; 100 – 1750 (10 – 175 mbar o cmH2O) in HFO+CMV
26	Allarme volume corrente basso	Valore per triggerare l'allarme volume corrente basso	0,1ml	0 – 3950 (0 – 395ml)
27	Allarme volume corrente alto	Valore per triggerare l'allarme volume corrente alto	0,1ml	10 – 4000 (1 – 400ml) quando VTV è spento OFF 2 – 4000 (0.2 – 400ml) quando VTV è acceso ON
28	Allarme volume minuto basso	Valore per triggerare l'allarme volume minuto (basso)	ml	0 – 17900 (0 – 17,90l)
29	Allarme volume minuto alto	Valore per triggerare l'allarme volume minuto (alto)	ml	10 – 18000 (0,01l – 18,00l)
30	Allarme etCO2 basso Allarme CO2 bassa in HFOV, HFOV+ CMV	Allarme concentrazione CO2 corrente finale bassa	Unità etCO2 (come mostrate nel parametro 54)	0 – 145
31	Allarme etCO2 alto Allarme CO2 alto in HFOV, HFOV+ CMV	Allarme concentrazione CO2 corrente finale alta	Unità etCO2 (come mostrate nel parametro 54)	5-150
32	Allarme spO2 basso	Allarme concentrazione spO2 basso	%	1 – 98
33	Allarme spO2 alto	Allarme concentrazione spO2 alto	%	2 – 99 e '-' se OFF
34	Allarme frequenza pulsazioni bassa	Allarme frequenza pulsazioni bassa	Battiti/min	30 – 230
35	Allarme frequenza pulsazioni alta	Allarme frequenza pulsazioni alta	Battiti/min	35 – 235
36	FR calcolata (frequenza respiratoria)	Conteggio totale dei respiri nell'ultimo minuto	Respiri/min	0 – 255
37	CPAP calcolata	Valore CPAP calcolato	0,1 * unità di pressione	- 90 – +9990 (-9,0 – +999 mbar o cmH2O)
38	Ti calcolata	Tempo inspiratorio calcolato.	0,01 s	0 – 9900 (0.00 –99.0s)
39	V insp calcolato	Volume inspiratorio calcolato	0,1ml	0 – 32767 (0 – 3,2767l)
40	Vte misurata	Volume espiratorio calcolato	0,1ml	0 – 32767 (0 – 3,2767l)
41	PEEP misurata	Valore PEEP misurato	0,1 * unità di pressione	- 90 – +9990 (-9,0 – +999 mbar o cmH2O)
42	PIP misurata	Valore PIP misurato	0,1 * unità di pressione	- 990 – +9990 (-99,0 – +999 mbar o cmH2O)
43	Concentrazione ossigeno	Concentrazione ossigeno misurata come % della composizione dell'aria	%	18 – 100 '-' durante la calibrazione O2
44	Delta P HFO calcolata	La differenza tra la pressione minima e massima in modalità HFO.	Unità di pressione	0 – 255
45	HFO MAP calcolata	Pressione media HFO calcolata	0,1* unità di pressione	-90 – 9990 (-9- +999 mbar o cmH2O)
46	Conteggio trigger	Numero di respiri triggerati dal paziente nell'ultimo minuto	Respiri/min	0 – 255

Dati tecnici

N°	Nome	Descrizione	Unità	Intervallo di uscita (intervallo fisico)
47	Volume minuto calcolato	Modifica volume calcolato nell'ultimo minuto	ml	0 – 18899l (0.00 – 18.9l)
48	Perdita	% calcolata di perdita aria dal sistema	%	0 – 99
49	Resistenza	Resistenza calcolata vie respiratorie	0.1 (mbar o mmH20) /l/s	0 – 9990 (0 – 999 mbar/l/s o cmH20/l/s)
50	Conformità	Compliance vie respiratorie dinamica calcolata	0,1 ml/mbar (0,1 ml/unità di pressione)	0 – 254 (0.0 – 25.4 ml/mbar o ml/cmH20)
51	C20/C	Il rapporto della compliance nel corso dell'ultimo 20% dell'aumento di pressione rispetto alla compliance totale	0,1	0 – 99 (0,0 – 9,9)
52	DCO2	Coefficiente di trasporto del gas	1	0 – 65534
53	etCO2	Pressione CO2 corrente fine calcolata	mmHg	0 – 150 (mmHg)
54	Unità etCO2	Unità di pressione etCO2	N/A	0 = mmHg, 1 = Percentuale volume, 2 = kPa
55	SpO2	Saturazione di ossigeno	0,1%	0 – 1000 (0.0 – 100.0%)
56	Frequenza pulsazioni	Frequenza pulsazioni	Battiti/minuto	25 – 239
57	PCO2	Pressione parziale anidride carbonica	mmHg	0 – 2000 (0,0 – 200,0 mbar)
58	PO2	Pressione parziale dell'ossigeno	mmHg	0 – 2000 (0,0 – 200,0 mbar)
59	PIP misurata	Indice perfusione calcolato	%	0 - 2000 (0 - 20,00 %) Dove: I valori numerici PI 0.02 – 0.99 % hanno la risoluzione +/- 0.01 %; I valori numerici PI 1 – 9.9 % hanno la risoluzione +/- 0.1 % e I valori numerici PI 10 – 20 % hanno la risoluzione +/- 1 %;
60	SIQ misurata	Inadeguatezza segnale misurato	%	0 – 255 (0 – 100%)
61	Spont etCO2 calcolato	Valore spontaneo CO2 corrente fine calcolata	mmHg	0 – 150 (mmHg)
62	Spont % calcolato	Valore spontaneo % calcolato	%	0 – 100%
63	Stato allarme	L'allarme attivo corrente. Vedere (tabella 6)	N/A	Vedere tabella allarmi protocollo SLE (Tabella 13)
64	Flusso gas fresco calcolato	Valore calcolato di gas fresco	l/min	0 – 500 (0,0 – 50,0l/mbar)
65	Allarme etCO2 Spont alto	Allarme spontaneo CO2 corrente finale alta	mmHg	5 – 150mmHg
66	Stato Auto-O2	Stato ossigeno automatizzato	%	a) Auto-O2: inattivo- l'uscita RS232 è 1 b) Auto-O2: attivo- l'uscita RS232 è 2 c) Auto-O2: limite raggiunto- l'uscita RS232 è 3 d) Auto-O2: Modalità alternativa- l'uscita RS232 è 4 e) Auto-O2: Override manuale- l'uscita RS232 è 5

Dati tecnici

N°	Nome	Descrizione	Unità	Intervallo di uscita (intervallo fisico)
67	Impostazione intervallo stabilito Auto-O2	Intervallo stabilito ossigeno automatizzato impostato	%	Ci sono 4 intervalli disponibili: 90-94% - l'uscita RS232 è 1 91-95% - l'uscita RS232 è 2 92-96% - l'uscita RS232 è 3 94-98% - l'uscita RS232 è 4
68	Valore O2 di riferimento	Valore di riferimento dell'ossigeno	%	21 – 100%
69	Co-efficiente di variazione (differito)	TBC	TBC	TBC
70	Tempo nell'intervallo (differito)	TBC	TBC	TBC

Tabella allarmi

Codice allarmi	Descrizione dell'allarme
1	Sensor O2 disconnesso. Riconnettere.
2	La cella di misura ossigeno necessita di calibrazione.
3	Necessita sostituzione della cella di ossigeno.
4	Errore di calibrazione ossigeno
5	Alta concentrazione di ossigeno.
6	Bassa concentrazione di ossigeno.
15	Sensore Pressione Guasto. Porre il ventilatore fuori uso
16	Soglia di alta pressione superata.
17	Pressione bassa
18	Apnea.
19	Errore di ciclo.
20	Prolungata pressione positiva
21	CPAP alta
22	PEEP alta
23	PIP alta
24	PIP bassa
25	Errore Comunicazione Mon. Isolato. Riavviare ventilatore
26	Errore Sistema Monitor Isolato. Riavviare Ventilatore
27	Impossibile calibrare il flusso ADC. Nota: applicabile per l'Utilità tecnica
28	Calibrare il sensore di flusso.
29	Impossibile calibrare il sensore di flusso.
30	Sensore di flusso non connesso.
31	Sensore di flusso difettoso.
32	Sensore di flusso contaminato.
40	Allarme Errore Sistema. Porre il ventilatore fuori uso
41	Non utilizzato in V2.0.90
45	Batteria scarica.
46	Mancanza di alimentazione elettrica.
47	Errore Batteria. Porre il ventilatore fuori uso
48	Batteria scarica.
50	Volume minuto alto
51	Volume minuto basso
52	Volume corrente basso
53	Perdita elevata al paziente.
54	Apnea
55	Respiro non rilevato.
56	Volume corrente alto
60	Gas fresco bloccato. Verifica circuito paziente.
61	Perdita gas fresco. Verifica circuito paziente.

Codice allarmi	Descrizione dell'allarme
62	Mancanza ossigeno
63	Mancanza aria
64	Mancanza gas.
68	L'interfaccia Utente si è resettato. Controllare impostazioni ventilatore
71	Errore sistema Controller. Riavviare ventilatore
72	Errore Hardware Controller. Riavviare Ventilatore
73	Allarme Errore Sistema. Porre il ventilatore fuori uso
75	Controllo uscita dati. Nota: l'allarme passa al messaggio di stato al momento del reset.
80	Pressione inferiore a quella ambiente - 1
81	Pressione inferiore a quella ambiente - 2
82	Sensore di flusso malfunzionante
83	Sensore di flusso non montato correttamente
90	Aumento inatteso della pressione media
91	Diminuzione inattesa della pressione media
96	Rilevata variazione di pressione.
97	Aumento inatteso del Delta P.
98	Diminuzione inattesa del Delta P.
99	PAW alta
100	Guasto comunicazione interna. Porre fuori uso il ventilatore.
101	Errore di sistema 101 (Errore checksum memoria) - allarme ridondante
102	Errore di sistema 102 (Errore checksum memoria) - allarme ridondante
103	Errore di sistema 103 (Errore checksum memoria) - allarme ridondante
104	Errore di sistema 104 (Errore checksum memoria) - allarme ridondante
105	Errore di sistema 105 (Errore checksum memoria) - allarme ridondante
106	Calibrazione non possibile. Porre il ventilatore fuori uso
114	Errore Alimentazione elettrica Nota: ogni volta che il sotto-sistema di monitoraggio non riesce a comunicare con l'alimentazione elettrica
115	Errore Alimentazione elettrica. Porre il ventilatore fuori uso
116	Errore hardware Monitor. Porre il ventilatore fuori uso
117	Errore hardware Monitor. Porre il ventilatore fuori uso
118	Errore Alimentazione elettrica. Riavviare ventilatore Nota: quando l'allarme "Errore Alimentazione elettrica" viene attivato per più di 5 eventi, il messaggio cambia in
120	Frequenza respiratoria alta
255	Errore Interno UI. Riavviare Ventilatore
Allarme CO2 corrente finale	
151	Guasto hardware SpO2/etCO2
180	Nessun modulo etCO2 connesso
181	Guasto modulo etCO2 - 1

Codice allarmi	Descrizione dell'allarme
182	Guasto modulo etCO2 - 2
183	Guasto modulo etCO2 - 3
184	Eseguire calibrazione etCO2 NB: messaggio di stato
185	Eseguire manutenzione etCO2 NB: messaggio di stato
186	Nessuna Linea filtro etCO2 connessa
189	Sostituire la linea filtro etCO2
190	Guasto modulo etCO2 - 4
191	Guasto modulo etCO2 - 5
192	Valore CO2 non valido
193	Valore CO2 fuori intervallo
194	Nessun respiro etCO2
197	etCO2 alto
198	etCO2 basso
201	etCO2 alto
202	etCO2 basso
203	etCO2 Spont alto
204	Spurgo etCO2 NB: messaggio di stato
205	Modalità automanutenzione etCO2 NB: messaggio di stato
206	Pompa etCO2 Off NB: messaggio di stato
207	Inizializzazione etCO2 NB: messaggio di stato
Allarme SpO ₂	
151	Guasto hardware SpO2/etCO2
153	Nessun modulo SpO2 connesso
154	Nessun sensore SpO2 connesso
155	Guasto hardware SpO2 - 3
156	Guasto hardware SpO2 - 1
157	Sensore SpO2 difettoso - 1
158	Indice perfusione basso (SpO2) NB: messaggio di stato
159	Ricerca pulsazioni NB: messaggio di stato
160	Rilevata interferenza sensore SpO2
161	Sensore SpO2 Off paziente
162	Troppa luce ambiente (SpO2) NB: messaggio di stato
163	Sensore SpO2 difettoso - 2
164	Segnale IQ SpO2 basso NB: messaggio di stato
166	Nessun sensore SpO2 adesivo connesso (Continuare senza sensore SpO2)
167	Guasto hardware SpO2 - 2
168	SpO2 alto

Codice allarmi	Descrizione dell'allarme
169	SpO2 basso
170	Frequenza pulsazioni alta
171	Frequenza pulsazioni bassa
172	Pulsazioni non rilevate (SpO2)
173	Nessun cavo SpO2 connesso (continuare senza sensore SpO2)
84	Errore Comunicazione Monitor. Riavviare Ventilatore
208	O2 > 60%
210	OxyGenie non disponibile.
211	Oxygenie inatteso reset

26.4 Vuelink & IntelliBridge EC10


Attenzione: l'uso di dati di allarme comunicati dalla porta RS232 è esclusivamente per le informazioni e non elimina la necessità di monitorare sia il paziente che il ventilatore a intervalli regolari.

26.4.1 Collegamento al monitor paziente Vuelink

Il link SLE6000 RS232 è stato adattato per Philips interfaccia aperta/modulo Vuelink. Il collegamento al monitor deve essere effettuato mediante il modulo Vuelink. (Philips P/N° M1032A) Il modulo deve essere di tipo "Ventilatore".

Il cavo del modulo M1032A (Philips P/N° M1032-61654) richiede l'adattatore SLE Vuelink (SLE P/N° W0344) per collegarlo alla presa RS232 a 9 pin sul retro del ventilatore SLE6000.

La velocità di trasmissione è di 19200 bps, formato dati 8 bit, 1 bit di stop e senza parità. Tutti i dati trasmessi al monitor Vuelink sono trasferiti in pacchetti o telegrammi. Il monitor Vuelink invia telegrammi di richiesta dati e SLE6000 invia telegrammi di risposta.

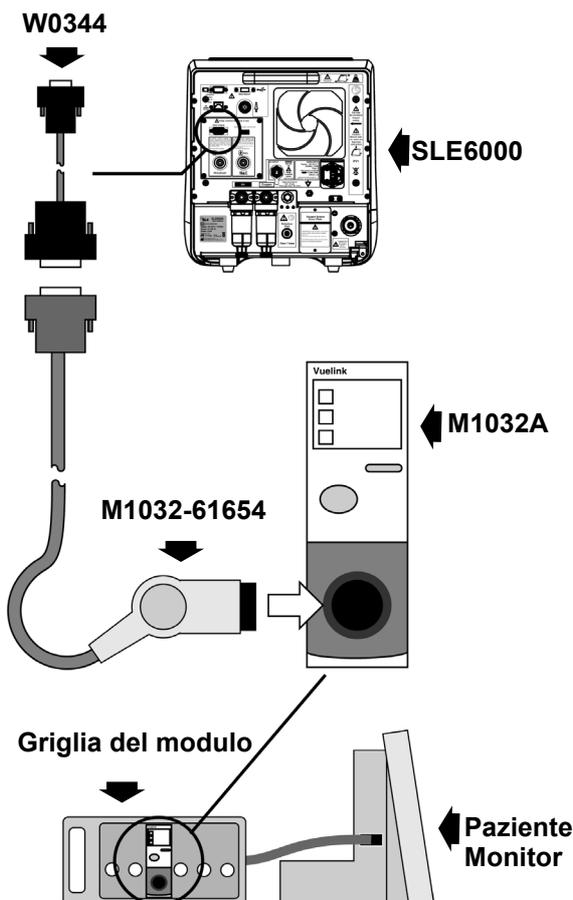


26.4.2 Collegamento al modulo IntelliBridge EC10

Il link RS232 di SLE6000 è stato adattato per il modulo di interfaccia Philips IntelliBridge EC10. (Philips P/N° 865115 #A01,101)

Il collegamento al monitor deve avvenire mediante il modulo EC5 ID (Philips P/N°865114 #101 DB9) e il cavo ethernet standard CAT5 con i connettori RJ45 alla presa RS232 a 9 pin sul retro del ventilatore SLE6000. (Philips P/N° 865114 #L02*) *(#L01 = 1.5m, #L02 = 3m & #L03 10m)

Gli articoli IntelliBridge possono essere acquistati da SLE o presso il distributore Philips. La velocità di trasmissione è di 19200 bps, formato dati 8 bit, 1 bit di stop e senza parità. Tutti i dati trasmessi al monitor IntelliVue sono trasferiti in pacchetti o telegrammi. Il monitor IntelliVue invia telegrammi di richiesta dati e SLE6000 invia telegrammi di risposta.

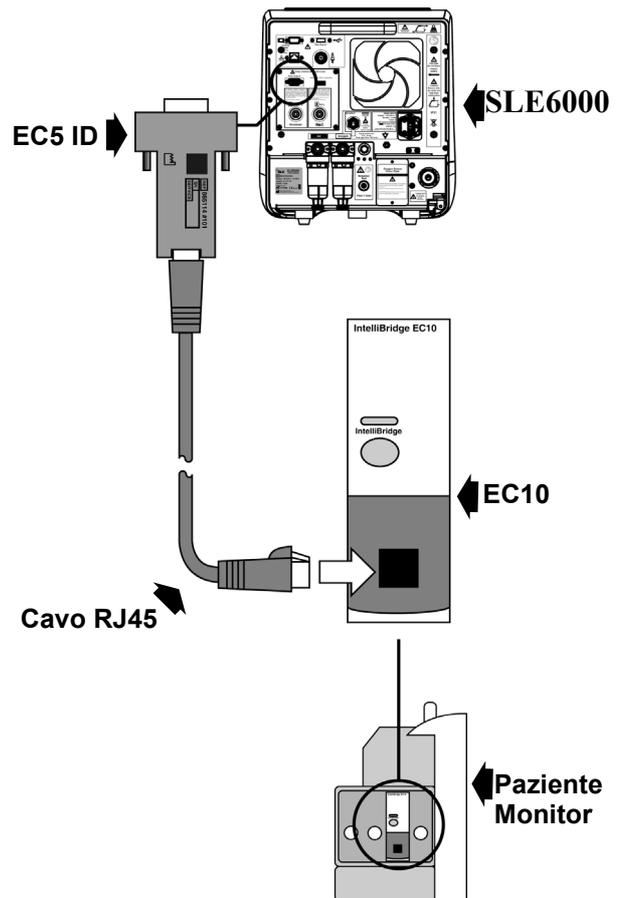

26.4.3 Descrizioni del parametro

N° parametro	Etichetta SLE 6000	Etichetta monitor Philips	Tipo param	Valore predefinito da mostrare	Disponibile su Vuelink
Forma d'onda	Pressione (forma d'onda)	AWP (curva pressione delle vie aeree)	Forma d'onda	Linea piatta	Si
Forma d'onda	Flusso (forma d'onda)	AWF (curva flusso delle vie aeree)	Forma d'onda	Linea piatta	Si
Forma d'onda	Volume (forma d'onda)	AWV (curva volume delle vie aeree)	Forma d'onda	Linea piatta	Si
Forma d'onda	CO2 (forma d'onda)	CO_2(curva CO2 vie aeree)	Forma d'onda	Linea piatta	Si
Forma d'onda	Pletis (forma d'onda)	SpO_2 (curva SPO2ve)	Forma d'onda	Linea piatta	Si
1	RR (BPM) misurata	AWRR (frequenza respiratoria vie aeree – misurazione vie aeree)	Misurazione	-1	Si
2	AWRR (limite allarme)	Alta	Limite allarme	-1	No
3	PIP	PIP (massima pressione inspiratoria in mbar)	Misurazione	0	Si
4	PIP (limiti allarme)	Alto e basso	Limite allarme	0	No
5	PEEP/CPAP	PEEP (pressione positiva espiratoria finale in mbar)	Misurazione	0	Si
6	PEEP/CPAP (limiti allarme)	Alto e basso	Limite allarme	0	No
7	Ti (T insp)	InsTi (tempo inspiratorio)	Misurazione	-1	Si
8	Texp	ExpTi (tempo espiratorio)	Misurazione	-1	Si
9	Vte	TVex (volume corrente espiratorio in ml)	Misurazione	-1	Si
10	Vte (limiti allarme)	Alto e basso	Limite allarme	-1	No
11	Vmin	MINVOL (Volume minuto)	Misurazione	-1	Si
12	Vmin (limiti allarme)	Alto e basso	Limite allarme	-1	No
13	O2	inO_2 (ossigeno inspirato)	Misurazione	0	Si
14	Vti	TVin (volume corrente inspirato in ml)	Misurazione	0	Si
15	HFO Delta P	HFVAmp (ampiezza resp. ventilazione frequenza alta) anche se Δp è disponibile (se preferito)	Misurazione	0	Si
16	C20/C	C20/C (indice di sovradistensione)	Misurazione	-1	Si
17	DCO2	DCO_2 (valore coefficiente di trasporto del gas ad α frequenza)	Misurazione	-1	Si
18	P media	MnAwP o Pmean? (Pressione media vie respiratorie)	Misurazione	0	Si
19	Compl.	Cdyn (compliance polmonare dinamica)	Misurazione	-1	Si
20	Resistenza	Rdyn (resistenza polmonare dinamica)	Misurazione	-1	Si
21	Perdita	Perdita (perdita in percentuale)	Misurazione	255	Si
22	Perdita (limiti allarme)	Alta	Limite allarme	100	No
23	etCO2	ETCO_2 (CO2 corrente finale)	Misurazione	-1	Si
24	etCO2 (limiti allarme)	Alto e basso	Limite allarme	-1	No
25	SpO2	SpO_2 (percentuale di emoglobina satura)	Misurazione	0	Si
26	SpO2 (limiti allarme)	Alto e basso	Limite allarme	100	No
27	fgFlow	fgFlow (flusso gas fresco totale)	Misurazione	0	Si
28	Pulsazione	PULSAZIONE (frequenza pulsazioni)	Misurazione	-1	Si
29	Pulsazione (limiti di allarme)	Alto e basso	Limite allarme	-1	No
30	Trig (eg in CPAP)	SpAWRR (frequenza respiratoria aerea spontanea)	Misurazione	-1	Si
31	Modalità di ventilazione	sMode (impostazione enumerazione: modalità)	Impostazione	Attesa	No
32	PIP/PAW alta	highP (limite allarme: pressione alta)	Limite allarme	0	No
33	FR impostata	sAWRR (frequenza respiratoria vie aeree impostata misurata in rpm)	Impostazione	0	No

N° parametro	Etichetta SLE 6000	Etichetta monitor Philips	Tipo param	Valore predefinito da mostrare	Disponibile su Vuelink
34	Imposta Per. Insp.	sInsTi (tempo inspiratorio impostato in secondi)	Impostazione	0	No
35	Impostazione frequenza HFO	sHFVRR (Impostazione frequenza respiratoria di ventilazione ad alta frequenza in Hz)	Impostazione	0	Sì
36	Impostazione PEEP/CPAP	sPEEP (impostazione PEEP in mbar)	Impostazione	0	No
37	Vte impostata	sTV (volume corrente impostato in ml)	Impostazione	0	No
38	Impostazione PIP	sPIP (impostazione PIP in mbar)	Impostazione	0	No
39	O2 impostata	sO2 (impostazione: concentrazione di ossigeno in %)	Impostazione	0	No
40	Impostazione delta P HFO	sHFVAm (impostazione amp ventilazione ad alta frequenza)	Impostazione	0	No
41	Impostazione media HFO	sHFMAP (Impostazione: Pressione media vie respiratorie, intorno alla quale si verificano Oscillazioni ad alta frequenza)	Impostazione	0	No
42	Soglia del trigger respiratorio	sTrgFI (impostazione trigger di flusso)	Impostazione	0	Sì
43	Tempo allarme di apnea	sAADel (ritardo allarme apnea)	Impostazione	0	No
44	Impostazione flusso	sfgFI (Impostazione: flusso di gas fresco totale nel miscelatore)	Impostazione	0	No
45	FR di backup	sRRbak (Impostazione: Frequenza respiratoria di backup del ventilatore)	Impostazione	0	No
47	Sensibilità del trigger (non flusso)	sTrig (Impostazione: Sensibilità del trigger)	Impostazione	0	No
48	sSpO2	sSpO2 (Punto medio dell'intervallo stabilito)	Impostazione	0	No
49	Perf	Perfusione	Misurazione	0	No

26.4.4 Messaggi di allarme

Tipo di messaggio Philips	Messaggio di allarme Philips	Allarme 6000 (ID)	Parametri interessati
1 Hardware generale inoperativo	"VENTILAZIONE NON OPERATIVA" (dati non disponibili)	Guasto al sistema di allarme (40,73) Errore Alimentazione elettrica (114, 118) Alimentazione guasta (115) Ventilatore fuori taratura (106) Guasto hardware monitor (117) Errore Controller Hardware (72) Errore del sistema controller (71) Guasto hardware monitor (27) Comunicazione isolata monitor (25) Errore di sistema monitor isolato (26) Impossibile calibrare il flusso ADC (27) L'interfaccia Utente si è resettato. (68) Guasto comunicazione interna (100) Controllo uscita dati.(75) Errore chiamata infermiera (41)	Tutti
2 Hardware specifico inoperativo	"SENSORE O2" (dati non disponibili)	Cella O2 disconnessa (15) Cella O2 esaurita (3) Errore calibrazione cella O2 (4) Calibrazione cella O2	FIO_2
3 Hardware specifico inoperativo	"SENSORE DI FLUSSO" (dati non disponibili)	Guasto del sensore di flusso (31) Sensore di flusso contaminato (32) Collegare il sensore di flusso (30) Impossibilità di calibrare il sensore di flusso (29) Calibrare il sensore di flusso (28) Sensore di flusso non montato correttamente (83) Sensore di flusso tagliato (82)	TVex TVin MV Cdyn Rdyn Perdita C20/C DCO_2

Tipo di messaggio Philips	Messaggio di allarme Philips	Allarme 6000 (ID)	Parametri interessati
4 Hardware specifico inoperativo	"SENSORE SPO2" (dati non validi e inutili)	Tutti i 14 allarmi del sistema SPO2 escludendo l'errore di comunicazione del sensore esterno (151)	PULSAZIONE SpO_2
5 Hardware specifico inoperativo	"SENSORE ETCO2" (dati non validi e inutili)	Tutti gli 11 allarmi del sistema ETCO2 escludendo l'errore di comunicazione del sensore esterno (151)	ETCO_2 PCO_2 PO_2
6 Software specifico inoperativo	"DERIVA SENS. PR." (dati non validi e inutili)	Deriva sens. press. (15)	PEEP/CPAP PIP HFVAm MnAwP Cdyn Rdyn
7 Allarme rosso	"PRESSIONE BASSA"	Ambiente inferiore sostitutiva (81) Ambiente inferiore (80) PIP bassa (24) Pressione bassa (17) Bassa pressione media (91)	
8 Allarme rosso	"ALTA PRESSIONE"	Cont. pressione positiva (20) Pressione alta (16) Paw alta (99) PIP alta (23) CPAP alta (21) PEEP troppo alta(22) Pressione media alta(91)	
9 Allarme rosso	"ERRORE VENTILAZIONE"	Errore di comunicazione monitor (allarme generato IU) Errore Controller Hardware (72) Ventilatore fuori taratura (106) Errore di comunicazione monitor isolato (23) Monitorare l'errore di sistema isolato (26) L'interfaccia Utente si è resettato. (68) Guasto al sistema di allarme (40) OxyGenie non disponibile (210) Ripristino inatteso Auto-O2 (211) Guasto hardware SpO2/etCO2 (151)	
10 Allarme rosso	"ERRORE DI CICLO"	Errore di ciclo (19)	
11 Allarme rosso	"DERIVA SENS. PR."	Guasto del sensore di pressione (15)	PEEP PIP HFVAmp MnAwP Cdyn Rdyn
12 Allarme rosso	"MODIFICA P HFO"	Modifica pressione MAX (96) Aumento pressione delta (97) Caduta pressione delta (98)	
13 Allarme rosso	"ERRORE ALIMENTAZIONE GAS"	Mancanza gas (64) Mancanza ossigeno (62) Mancanza aria (63)	
14 Allarme rosso	"BATTERIA"	Errore batteria (47) Batteria scarica (45,48)	
15 Allarme rosso	"CIRCUITO PAT."	Gas fresco bloccato (60) Perdita di gas fresco (61)	
16 Allarme rosso	"APNEA"	Respiro di apnea (55) Apnea - Volume (54) Apnea - Pressione (18)	
17 Allarme rosso	"FR ALTA"	BPM alta(120)	
18 Allarme giallo	"O2 AUTO"	Incremento rapido di O2 (209) O2>X% (208)	

Tipo di messaggio Philips	Messaggio di allarme Philips	Allarme 6000 (ID)	Parametri interessati
19 Allarme giallo	"SPO2"	Tutti i 18 allarmi di sistema e paziente SPO2	
20 Allarme giallo	"ETCO2"	Tutti i 17 allarmi di sistema e paziente ETCO2	
21 Allarme giallo	"ALLARME SENS. FLUSSO"	Guasto del sensore di flusso (31) Sensore di flusso contaminato (32) Collegare il sensore di flusso (30) Impossibilità di calibrazione flusso (29) Calibrare il sensore di flusso (28) Sensore di flusso non montato correttamente (83) Sensore di flusso tagliato (82)	TVex TVin MV Cdyn Rdyn Perdita C20/C DCO_2
22 Allarme giallo	"ALLARME VOLUME"	Volume minuto alto (50) Allarme di perdita al paziente (53) Volume corrente bassa (52) Volume corrente alta (56) Volume minuto basso (51)	
23 Allarme giallo	"GUASTO DI ALIMENTAZIONE"	Mancanza di alimentazione elettrica (46)	
24 Allarme giallo	"ERRORE CELLA O2"	Cella O2 disconnessa (1) La cella O2 necessita di calibrazione (2) La cella O2 necessita di sostituzione (3) Errore calibrazione cella O2 (4)	FIO_2
25 Allarme giallo	"O2 "	Livello O2 alto (5) Livello O2 basso (6)	

26.4.5 Forma d'onda

AWP (pressione aerea)
AWF (flusso d'aria)
AWV (volume d'aria)
CO_2 (curva anidride carbonica - aria)
PLETIS (curva PLETIS fornita dal parametro SpO_2)

26.4.6 Grafico finestra attività VueLink

La finestra attività VueLink per SLE6000 mostrerà i parametri come mostrati in basso.

```

|-----|-----|-----|
| AWRR   rpm   | TVex   ml   | sHFVRR Hz   |
|-----|-----|-----|
| PIP    mbar  | MV     l    | MnAwP  mbar  |
|-----|-----|-----|
| PEEP   mbar  | Leak   %   | HFVAmp  mbar  |
|-----|-----|-----|
| Insti  sec   | Cdyn   ml/mbar | DCO_2    |
|-----|-----|-----|
| ExpTi  sec   | Rdyn   mbar/l/s | fgFlow  l/min  |
|-----|-----|-----|
| SpAWRR rpm   | TVin   ml   | ETCO_2  mmHg  |
|-----|-----|-----|
|         | C20/C  | SpO_2   %   |
|-----|-----|-----|
| FIO_2  %    | sTrgFl l/min  | PULSE   bpm   |
|-----|-----|-----|

```

26.5 Chiamata infermiera

Avvertenza. L'uso della funzione chiamata infermiera non esula dalla necessità di monitorare sia il paziente che il ventilatore a intervalli regolari.

Quando collegato a un sistema di chiamata infermiera in ospedale il ventilatore genererà un segnale di attivazione con le seguenti condizioni di allarme:

Condizione 1. Qualsiasi allarme di alta priorità (Paziente e tecnico)

Condizione 2. Il guasto del sistema monitor

Condizione 3. Mancanza totale di alimentazione o arresto del ventilatore.

Quando l'allarme ad alta priorità viene cancellato, anche il segnale di attivazione per il sistema di chiamata infermiera viene cancellato.

Premendo il pulsante ON/OFF dei ventilatori si disattiva il segnale di attivazione chiamata infermiera per le condizioni 2 e 3.

Nota: Per la condizione di allarme 3 la durata del segnale di attivazione dell'allarme è di circa 2 - 9 minuti.

26.5.1 Ritardo chiamata infermiera

Il ritardo nell'attivazione dell'allarme chiamata infermiera è di 5 ms.

26.6 Ethernet

La porta ethernet non è funzionante in questa versione del software.

26.7 USB (Dati)

Il ventilatore viene fornito con una porta dati USB 2.0 bidirezionale. La porta è utilizzata nell'esportazione dei dati paziente, log eventi e foto schermate, oltre che nell'aggiornamento del software del ventilatore.

26.8 USB (alimentazione)

Il ventilatore viene fornito con una porta di alimentazione USB 2.0. La porta è utilizzata per alimentare il nebulizzatore ultrasonico alimentato con USB. La porta è attiva quando il ventilatore viene attivato.

26.9 Monitor esterno

L'uscita del monitor esterno consente al ventilatore di collegare qualsiasi monitor per uso medico che può visualizzare le uscite XGA a una risoluzione di 1024 x 768 pixel.

Nota: il monitor esterno deve essere collegato a un'uscita VGA o un'uscita DisplayPort (a seconda del modello) prima di accendere il ventilatore. All'accensione, il ventilatore controlla solo la presenza di monitor esterni.

Avvertenza. Il monitor esterno non deve essere collegato al ventilatore quando utilizzato clinicamente. Il monitor esterno deve essere utilizzato solo per dimostrazioni o per formazione.

27. Porte di ingresso (elettriche)

27.1 SpO₂ e etCO₂

Sia il dispositivo SpO₂ che etCO₂ sono parti applicate di tipo BF.

27.2 Sensore di flusso

Il sensore di flusso è una parte applicata tipo BF.

27.3 DC 24V

Questa porta serve a consentire il collegamento dell'alimentazione diretta esterna da 24 V 4 A.

Attenzione: utilizzare esclusivamente un'alimentazione per uso medico da 24 V CC con una corrente nominale di 4 A.

28. Specifiche del sensore

Nota: maggiori informazioni sulla precisione del sensore sono disponibili con le istruzioni per l'uso fornite con il sensore.

28.1 Masimo SET®

Informazioni sul paziente www.masimo.com/patents.htm

28.1.1 SpO₂ (%) funzionale

Criteri di specificazione

Intervallo di visualizzazione . . . 0,0% -100,0%

Intervallo di calibrazione 70%-100%

Calibrazione standard CO-ossimetro invasivo

Precisione senza

movimento - sensori infantili

e pediatrici (rms) ≤2,0%

Precisione senza

movimento - Sensori

neonatali (rms) ≤3,0%

Precisione da movimento

(rms) ≤3,0%

Risoluzione ≤0,1 %

Tempo di visualizzazione ≤8 secondi

Rilevamento asistolia

Tempo ≤8 secondi

Ritardo ≤10 secondi

Tempo di risposta ≤20 secondi

Aggiornamento display

Frequenza ≥ 1 Hz

Tempo medio

(secondi) 2-4, 4-6, 8, 10, 12, 14, 16

28.1.2 Frequenza pulsazioni (BPM)

Criteri di specificazione

Intervallo di visualizzazione . . . 25 BPM - 240 BPM

Intervallo di calibrazione 25 BPM - 240 BPM

Calibrazione standard ECG e simulatore paziente

Precisione senza movimento

(rms) ≤ 3,0 BPM

Precisione da movimento

(rms) ≤ 5,0 BPM

Risoluzione ≤ 1 BPM

Tempo di visualizzazione ≤8 secondi

Rilevamento asistolia

Tempo ≤8 secondi

Ritardo ≤10 secondi

Tempo di risposta ≤20 secondi

Aggiornamento display

Frequenza ≥ 1 Hz

28.1.3 Indice perfusione (%)

Criteri di specificazione

Intervallo di visualizzazione . . . 0,02% - 20,0%

Intervallo di calibrazione 0,10% - 20,0%

Calibrazione standard Simulatore paziente

Risoluzione $\leq 0,01\%$

Tempo di visualizzazione

Rilevamento asistolia

Tempo ≤ 8 secondiRitardo ≤ 10 secondiTempo di risposta ≤ 20 secondi

Aggiornamento display

Frequenza ≥ 1 Hz**28.1.3.1 Intervallo lunghezza d'onda sensore**

Intervallo lunghezza d'onda sensore

Masimo = 653-905 nm

Potenza di uscita sensore Masimo ≤ 15 mW**28.1.4 Note di precisione**

1. La tecnologia Masimo SET con i sensori Masimo è stata approvata per la precisione senza movimento negli studi del sangue umano su volontari uomini e donne in salute con pigmentazione della pelle da chiara a scura in studi sull'ipossia indotta nell'intervallo 70-100% SpO₂ rispetto a un Co-ossimetro da laboratorio e al monitor ECG. Questa variazione equivale alla deviazione standard ± 1 . Più o meno una deviazione standard abbraccia il 68% della popolazione.

2. La tecnologia Masimo SET con i sensori Masimo è stata approvata per la precisione di movimento negli studi del sangue umano su volontari uomini e donne adulti in salute con pigmentazione della pelle da chiara a scura in studi sull'ipossia indotta durante l'esecuzione di movimenti di massaggio o strofinamento, da 2 a 4 Hz con un'ampiezza di 1-2 cm e movimento non ripetitivo tra 1 e 5 Hz con un'ampiezza di 2-3 cm negli studi sull'ipossia indotta nell'intervallo di 70-100%2 rispetto a un Co-ossimetro da laboratorio e al monitor ECG. Questa variazione equivale alla deviazione standard ± 1 che abbraccia il 68% della popolazione.

3. La tecnologia Masimo SET è stata approvata per la precisione di bassa perfusione nelle principali prove da banco rispetto al simulatore Biotek Index 2™ e al simulatore Masimo con forze del segnale superiori a 0,02% e trasmissione superiore al 5% per saturazioni che vanno dal 70 al 100%. Questa variazione equivale alla deviazione standard ± 1 . Più o meno una deviazione abbraccia il 68% della popolazione.

4. La tecnologia Masimo SET con i sensori Masimo Neo è stata approvata per la precisione del movimento neonatale negli studi sul sangue umano in volontari uomini e donne sani con pigmentazione della pella da chiara a scura negli studi di ipossia indotta durante l'esecuzione di movimenti di strofinamento e massaggio, da 2 a 4 Hz con un'ampiezza di 1 - 2 cm e un movimento non ripetitivo tra 1 e 5 Hz con un'ampiezza

di 2 - 3 cm negli studi di ipossia indotta nell'intervallo di 70-100% SpO₂ rispetto a un CO-ossimetro da laboratorio e un monitor ECG. Questa variazione equivale alla deviazione standard ± 1 . Più o meno una deviazione standard abbraccia il 68% della popolazione. L'1% è stato aggiunto ai risultati da considerare per gli effetti dell'emoglobina fetale presente nei neonati.

5. La tecnologia Masimo SET con i sensori Masimo è stata approvata per la precisione della frequenza delle pulsazioni per l'intervallo di 25 -240 bpm nelle principali prove da banco rispetto a un simulatore Biotek Index 2™. Questa variazione equivale alla deviazione standard ± 1 . Più o meno una deviazione standard abbraccia il 68% della popolazione.

6. Consultare le istruzioni per l'uso del sensore (DFU) per informazioni sull'applicazione completa. Salvo diversamente specificato, riposizionare i sensori riutilizzabili almeno ogni 4 ore e i sensori adesivi almeno ogni 8 ore.

7. Precisione del sensore specificata quando utilizzato con la tecnologia Masimo utilizzando un cavo paziente Masimo per i sensori LNOP, i sensori RD SET, i sensori LNCS o i sensori M-LNCS. I numeri rappresentano i bracci (errore RMS rispetto al riferimento). Dal momento che le misurazioni del pulsossimetro a impulsi sono statisticamente distribuite, solo i due-terzi delle misurazioni sono previste rientrare in un intervallo di ± 1 bracci rispetto al valore di riferimento. Salvo se diversamente specificato, la previsione di SpO₂ è specificata dal 70% al 100%. La precisione della frequenza delle pulsazioni è specificata da 25 a 240 bpm.

8. I tipi di sensori Masimo M-LNCS, LNOP, RD SET e LNCS hanno le stesse proprietà ottiche ed elettriche e possono variare in base al tipo di applicazione (adesivo/non adesivo/hook & loop), lunghezze del cavo, posizioni del componente ottico (parte superiore o inferiore del sensore come allineato con il cavo), tipo/ dimensione materiale adesivo e tipo di connettore (LNOP spina modulare a 8 pin, spina modulare RD a 15 pin, LNCS 9 pin, basato su cavo e M-LNCS 15 pin, basato su cavo). Tutte le informazioni sulla precisione del sensore e le istruzioni sull'applicazione del sensore sono fornite con le istruzioni per l'uso del sensore associato.

28.1.5 Temperatura ambiente

28.1.5.1 Condizioni di esercizio

Luce incandescente	
Intensità	100 k Lux (luce del sole)
Luce fluorescente	
Intensità	10 k Lux
Luce fluorescente	
Frequenza	50, 60 Hz ± 1.0 Hz
Temperature ad umidità ambiente	da 5° C a 40° C
Umidità	dal 15% al 95%, senza condensa
Pressione	da 500 a 1060 mbar

28.1.5.2 Condizioni di immagazzinaggio

Temperatura ad umidità ambiente	da -40° C a 70° C
Umidità	dal 15% al 95%, senza condensa

28.1.5.3 Dichiarazione di licenza implicita

La proprietà o l'acquisto di questo apparecchio non conferisce alcuna licenza d'uso espressa o implicita all'uso del dispositivo con sensori o cavi non autorizzati che, da soli o in combinazione con questo apparecchio, rientrano nell'ambito di uno o più pazienti relativi a questo apparecchio.

28.2 MicroPod™

Informazioni sul paziente	Brevetti US: www.covidien.com/patents
Unità CO ₂	mmHg o kPa o Vol%
CO ₂ , etCO ₂ Intervallo	0-150 mmHg
CO ₂ Forma d'onda	
Risoluzione	0,1 mmHg
EtCO ₂ Risoluzione	1 mmHg
Precisione CO ₂ *	0-38 mmHg: ± 2 mmHg 39-150 mmHg: ± (5% della lettura prevista in mmHg + [0,08 x (lettura prevista in mmHg -39 mmHg)])**
Precisione in presenza di gas interferenti	La specifica di precisione è quella descritta di seguito in presenza di gas interferenti. 0-38 mmHg: ± (2 mmHg + 4% della lettura prevista in mmHg) 39-150 mmHg: ± (9% della lettura prevista in mmHg + [0,08 x (lettura prevista in mmHg -39 mmHg)])
Frequenza respiratoria Intervallo	0-150 bpm
Frequenza respiratoria Precisione	Il test di precisione è descritto nel manuale di servizio SLE6000. 0-70 bpm: ±1 bpm 71-120 bpm: ±2 bpm 121-150 bpm: ±3 bpm
Deriva della precisione di misurazione	Riguardo alla deriva, notare che la funzione di zero periodico automatica compensa le derive tra i componenti, cambia in temperatura ambiente e condizioni barometriche. Questo processo automatico elimina le variazioni che potrebbero diversamente causare la deriva della misurazione. Pertanto il modulo non mostra deriva.
Portata	50 (tolleranza -7.5, +15) ml/min, portata misurata dal volume

Tempo di fronte di salita d'onda	
Da 10% a 90%	1.72 secondi
Campionamento	
forma d'onda	20 campioni/s
Tempo di inizializzazione . . .	40 s (tipico, include tempo di accensione e inizializzazione)
* Nei casi in cui i requisiti ISO 80601-2-55 sono più rigidi della precisione indicata dalla tabella in alto, il MicroMediCO ₂ è conforme ai requisiti più rigidi.	
**Per le frequenze respiratorie superiori a 80 bpm, la precisione è 4 mmHg o ± 12 % di lettura qualunque sia maggiore) per i valori etCO ₂ che superano 18 mmHg.	
Selezione del picco	Il modulo seleziona il valore di picco etCO ₂ in una finestra di venti secondi e questa viene mostrata nel pannello valori monitorati.
Intervallo di calibrazione . . .	Calibrare inizialmente dopo 1.200 ore di funzionamento, poi dopo un anno o dopo 4.000 ore di funzionamento, a seconda di quale viene prima. La calibrazione iniziale non deve verificarsi prima di 720 ore d'uso. Se la calibrazione iniziale viene eseguita prima di 720 ore d'uso, il modulo si ripristinerà per richiedere la successiva calibrazione dopo 1200 ore, invece che dopo 4000 ore.
Assistenza	Dopo 30,000 ore di funzionamento, determinati componenti del modulo di capnografia richiedono assistenza.
Tempo di risposta del sistema etCO ₂	6,83 secondi
Compensazione	BTPS (correzione standard utilizzata dalla capnografia MicroPod™ durante le procedure di misurazione per temperatura del corpo, pressione e saturazione)

28.2.1 Limiti di allarme

etCO ₂ basso.	0-145 mmHg
etCO ₂ alto	5-150 mmHg

28.2.2 Formati di misurazione

MicroPod™ fornisce i dati CO₂ nelle seguenti unità:

- mmHg.
- Volume %
- kPA

28.2.3 Metodi di calcolo per capnografia

La capnografia è un metodo non invasivo per il monitoraggio del livello di anidride carbonica nel respiro esalato (EtCO₂) per valutare lo stato di ventilazione del paziente.

I moduli di capnografia Microstream™ utilizzano la spettroscopia a infrarossi non dispersiva (NDIR) per misurare in maniera continua il quantitativo di CO₂ durante ogni respiro, il quantitativo di CO₂ presente alla fine dell'esalazione (EtCO₂), il quantitativo di CO₂ presente durante l'inalazione (FiCO₂) e la frequenza respiratoria.

La spettroscopia a infrarossi è utilizzata per misurare la concentrazione di molecole che assorbono la luce infrarossa. Dal momento che l'assorbimento è proporzionale alla concentrazione della molecola assorbente, la concentrazione può essere determinata confrontando il suo assorbimento rispetto a quello standard.

28.2.4 Temperatura ambiente

28.2.4.1 Condizioni di esercizio

Temperatura d'esercizio . . .	da 0° C a 40° C
Pressione d'esercizio	da 57 kPa a 106 kPa (da 430 mmHg a 795 mmHg)
Altitudine d'esercizio	da -381m a 15,240 m (-1250 piedi a 50,000 piedi)
Frequenza di modifica	altitudine modifica di pressione massima o ambiente massima 500 piedi/min (152 m/min) di 2,4 mmHg/min massimo.
Umidità operativa	da 10% a 95% senza condensa

Nota: quando si utilizza il modulo con un ventilatore, nelle sovrappressioni alte vicino a 10kPa (100cmH₂O), il modulo potrebbe entrare in modalità bloccaggio per proteggere il modulo dai danni.

28.2.4.2 Condizioni di immagazzinaggio

Immagazzinaggio e trasporto	
Temperatura	da -40° C a 70° C.
Immagazzinaggio e trasporto	
Umidità	da 10% a 95% senza condensa
Immagazzinaggio e trasporto	
Pressione	da 57kPa a 106kPa (da 430 mmHg a 795 mmHg)
Immagazzinaggio e trasporto	
Altitudine	da -1250 piedi a 50,000 piedi (da -381 m a 15,240 m)

28.2.4.3 Marchi commerciali

Microstream™, MicroPod™, FilterLine™ sono marchi commerciali di un'azienda Medtronic.

29. Allarmi

Il ventilatore SLE6000 include un sistema di allarme intelligente che dà la priorità ai messaggi di allarme, serve al silenziamento di alcuni allarmi e consente 5 livelli di regolazione audio dal 20% al 100%.

29.1 Priorità allarme

I segnali di allarme generati dal sistema di allarme sono codificati con la priorità, dove il segnale di allarme ad alta priorità trasmette un livello di urgenza più elevato rispetto ai segnali di allarme di media o bassa priorità.

Il segnale di allarme di media priorità trasmette un livello di urgenza di livello più alto rispetto al segnale di allarme di bassa priorità.

Con la generazione di un allarme, viene mostrato un messaggio che indica il tipo di allarme mostrato all'utente.

Simultaneamente viene emesso un allarme sonoro del livello di priorità corretto. Quando si cambiano le modalità, per qualsiasi allarme che è stato triggerato il livello di volume di allarme è impostato al minimo, per un periodo di 10 secondi. Dopo i 10 secondi, il tono di allarme ritorna al valore impostato dall'utente.

L'operatore può disattivare la generazione del fastidio di allarmi audio per un periodo massimo di 2 minuti. L'operatore può regolare il tono di allarme.

Nota: nel caso di un guasto di alimentazione non ci sono modifiche nel funzionamento del sistema di allarme o delle impostazioni.

29.1.1 Caratteristiche di allarme

Il ventilatore produce tre tipi di segnali di allarme: priorità alta, media e bassa a seconda della condizione di allarme.

Il segnale di allarme di alta priorità è composto da 10 impulsi. Una sequenza di 5 impulsi ripetuti una volta seguiti da un intervallo di 10 secondi prima del riavvio.

Il segnale di allarme di Media priorità è composto da 3 impulsi seguiti da un intervallo di 20 secondi.

Il segnale di allarme di Bassa priorità è composto da 2 impulsi. L'allarme non è ripetuto.

29.1.2 Volume segnalatore acustico di allarme

Per impostazione volume massimo.

Allarme alta priorità: 70 dBA

Allarme media priorità: 70 dBA

Allarme bassa priorità: 70 dBA

29.1.3 Log di allarmi

Il ventilatore memorizza gli ultimi 1000 messaggi di allarme nel log di allarmi. Quando un nuovo allarme viene generato, il messaggio di allarme più vecchio viene eliminato.

Il log di allarmi viene conservato dopo lo spegnimento dell'unità o dopo la perdita totale di alimentazione.

29.2 Caratteristiche indicatori di allarme

Ogni segnale di priorità di allarme è accompagnato da un allarme visivo, dove il colore rosso è utilizzato per indicare l'allarme di alta priorità, il colore giallo è utilizzato per indicare l'allarme di media priorità e il colore ciano è utilizzato per indicare bassa priorità. Gli allarmi di alta, media e bassa priorità hanno le caratteristiche elencate in basso.

Categoria di allarme	Colore indicatore	Frequenza lampeggiante	Ciclo di lavoro
Alta priorità	Rosso	1,9 Hz	30% attivo
Media priorità	Giallo	0,5 Hz	30% attivo
Bassa priorità	Ciano	Costante (On)	100% attivo

A		Guasto hardware SpO ₂ /etCO ₂	224,
Alimentazione guasta	200,		228
	222	Guasto modulo etCO ₂ - 1	228
Alta concentrazione di ossigeno.	216	Guasto modulo etCO ₂ - 2	228
Apnea	214,	Guasto modulo etCO ₂ - 3	229
	215	Guasto modulo etCO ₂ - 4	229,
Aumento inatteso del delta P	207		230
Aumento inatteso della pressione media	206		
B		I	
Bassa concentrazione di ossigeno.	217	Impossibile calibrare il sensore di flusso.	212
Batteria scarica.	209	Indice perfusione basso (SpO ₂)	233
Battery fault (Errore batteria)	208	Inizializzazione etCO ₂	234
C		L	
Caduta inattesa del Delta P	207	La cella di misura ossigeno	
Caduta inattesa della pressione media	207	necessita di calibrazione.	216
Calibrare il sensore di flusso.	212	M	
Controllare l'uscita dei dati	218	Mancanza aria	208
E		Mancanza di alimentazione elettrica.	215
È necessaria una nuova cella		Mancanza gas	203
di misura ossigeno.	216	Mancanza ossigeno	207
Errore Alimentazione elettrica.		Mancanza totale di alimentazione	219
Riavviare il ventilatore.	200	Modalità automanutenzione etCO ₂	234
Errore Controller Hardware (72)	202	N	
Errore del sistema controller	203	Nessun modulo etCO ₂ connesso	228
Errore di alimentazione	199	Nessun modulo SpO ₂ connesso	224
Errore di calibrazione ossigeno	216	Nessun respiro etCO ₂	231
Errore di ciclo.	206	Nessun sensore SpO ₂ adesivo connesso	225
Errore di comunicazione interna		Nessun sensore SpO ₂ connesso	225
dell'interfaccia utente	199	Nessuna Linea filtro etCO ₂ connessa	229
Errore di comunicazione monitor	198	O	
Errore di comunicazione monitor isolato	210	O ₂ oltre il limite impostato	217
Errore di sistema monitor isolato	210	Oxygenie inatteso reset	218
Eeguire calibrazione etCO ₂	234	OxyGenie non disponibile.	217
Eeguire manutenzione etCO ₂	234	P	
etCO ₂ alto	231	PAW alta	204
etCO ₂ basso	231,	PEEP alta	206
	232	Perdita elevata al paziente.	213
etCO ₂ Spont alto	232	Perdita gas fresco. Verifica circuito paziente.	209
F		PIP alta	204
Frequenza pulsazioni alta	227	PIP bassa	205
Frequenza pulsazioni bassa	227	Pompa etCO ₂ Off	234
Frequenza respiratoria alta.	215	Pressione bassa	205
G		Pressione inferiore a quella ambiente - 1	201
Gas fresco bloccato. Verifica circuito paziente.	209	Pressione inferiore a quella ambiente - 2	201
Guasto al sistema di allarme	198,	Prolungata pressione positiva	203
	218,	Pulsazioni non rilevate (SpO ₂)	226
	219	R	
Guasto comunicazione interna	217	Respiro non rilevato.	214
Guasto del sensore di pressione	206	Ricerca pulsazioni	233
Guasto hardware monitor	201,	Rilevata interferenza sensore SpO ₂	226
	208	Rilevata variazione di pressione.	205
Guasto hardware SpO ₂ - 1	224		
Guasto hardware SpO ₂ - 2	224		
Guasto hardware SpO ₂ - 3	225		

S

Segnale IQ SpO2 basso	233
Sensore di flusso contaminato.	211
Sensore di flusso difettoso.	211
Sensore di flusso malfunzionante	212
Sensore di flusso non connesso.	211
Sensore di flusso non montato correttamente ...	212
Sensore O2 scollegato	215
Sensore SpO2 difettoso - 1	226
Sensore SpO2 difettoso - 2	226
Sensore SpO2 Off paziente	226
Soglia di allarme alta pressione superata.	204
Sostituire la linea filtro etCO2	229
SpO2 alto	227
SpO2 basso	227
Spurgo etCO2	234

T

Troppa luce ambiente (SpO2)	233
-----------------------------------	-----

V

Valore CO2 fuori intervallo	230
Valore CO2 non valido	230
Ventilatore fuori taratura	201
Volume corrente alto	214
Volume corrente basso	213
Volume minuto alto	213
Volume minuto basso sotto la soglia.	214

29.3 Tabella allarmi

Messaggio di allarme: Allarme Errore Sistema. Porre il ventilatore fuori uso	
Condizione di allarme: errore generatore di allarme	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 0
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: sì	Allarme silenziabile: no
Definizione: questo allarme viene generato ogni volta che il sottosistema del monitor non riesce a comunicare con il controller di allarme. Il sottosistema del monitor proverà a effettuare 5 tentativi prima di avviare l'allarme. Il registro allarmi mostrerà "0"	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme e il segnalatore acustico di backup suonerà. L'utente non può annullare il tono di allarme del segnalatore acustico di backup. Se viene generato un nuovo allarme il componente visivo dell'allarme viene solo annullato. In questa azione la priorità dell'allarme passa a 68.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Messaggio di allarme: Errore Comunicazione Monitor. Riavviare Ventilatore	
Condizione di allarme: guasto monitor	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 0
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: sì	Allarme silenziabile: no
Definizione: questo allarme viene generato ogni volta che l'interfaccia utente non riesce più a comunicare con il sottosistema del monitor.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: Passo 1. Ventilare manualmente il paziente. Passo 2. Registrare le impostazioni del ventilatore. Passo 3. Entrare in modalità Standby e poi riavviare il ventilatore. Passo 4. Rientrare nella modalità di ventilazione e ripristinare le impostazioni del ventilatore registrate prima del riavvio.	
AVVERTENZA: se a questo punto riappare il messaggio di allarme "Errore Comunicazione Monitor. Riavviare Ventilatore" trasferire il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Ventilatore di percorso per la riparazione.	
Passo 5. Se necessario, ricalibrare il sensore di flusso. Passo 6. Se necessario, accendere il monitoraggio etCO₂ / SpO₂. Passo 7. Ricollegare il paziente al ventilatore. Passo 8. Se necessario, regolare i parametri di ventilazione.	

Messaggio di allarme: Errore Interno UI. Riavviare Ventilatore	
Condizione di allarme: errore interfaccia utente (comunicazione)	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 0
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: sì	Allarme silenziabile: no
Definizione: questo allarme viene generato ogni volta che l'interfaccia utente non riesce più a comunicare con il monitor o con i sottosistemi del controller.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: Passo 1. Ventilare manualmente il paziente. Passo 2. Registrare le impostazioni del ventilatore. Passo 3. Entrare in modalità Standby e poi riavviare il ventilatore. Passo 4. Rientrare nella modalità di ventilazione e ripristinare le impostazioni del ventilatore registrate prima del riavvio.	
AVVERTENZA: se a questo punto riappare il messaggio di allarme "Errore Interno UI. Riavviare Ventilatore" trasferire il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	
Passo 5. Se necessario, ricalibrare il sensore di flusso. Passo 6. Se necessario, accendere il monitoraggio etCO₂ / SpO₂. Passo 7. Ricollegare il paziente al ventilatore. Passo 8. Se necessario, regolare i parametri di ventilazione.	

Messaggio di allarme: Errore Alimentazione elettrica	
Condizione di allarme: errore di comunicazione alimentazione	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 1
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: questo allarme viene generato ogni volta che il sottosistema del monitor non riesce più a comunicare con l'alimentazione.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: Passo 1. Premere Reset	
Nota: l'utente può premere il tasto reset fino a un massimo di 5 volte. Dopo il quinto reset viene generato un nuovo allarme "Errore Alimentazione elettrica. Riavviare ventilatore" Vedere "Messaggio di allarme: Errore Alimentazione elettrica. Riavviare il ventilatore." a pagina 198.	

Messaggio di allarme: Errore Alimentazione elettrica. Riavviare il ventilatore.	
Condizione di allarme: errore di comunicazione alimentazione 1	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 2
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: sì	Allarme silenziabile: no
Definizione: questo allarme viene generato ogni volta che l'allarme "Errore Alimentazione elettrica" viene confermato almeno 5 volte	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: Passo 1. Ventilare manualmente il paziente. Passo 2. Registrare le impostazioni del ventilatore. Passo 3. Entrare in modalità Standby e poi riavviare il ventilatore. Passo 4. Rientrare nella modalità di ventilazione e ripristinare le impostazioni del ventilatore registrate prima del riavvio.	
AVVERTENZA: se a questo punto riappare il messaggio di allarme "Errore Alimentazione elettrica Riavviare il ventilatore" trasferire il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	
Passo 5. Se necessario, ricalibrare il sensore di flusso. Passo 6. Se necessario, accendere il monitoraggio etCO₂ / SpO₂. Passo 7. Ricollegare il paziente al ventilatore. Passo 8. Se necessario, regolare i parametri di ventilazione.	

Messaggio di allarme: Errore Alimentazione elettrica. Porre il ventilatore fuori uso	
Condizione di allarme: alimentazione guasta	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 3
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: questo allarme viene generato ogni volta che l'alimentatore indica che è in uno stato di guasto. Vedere "Alimentazione guasta" tabella guasti" a pagina 218. È stato restituito un codice di guasto dal PSU Tipo PSU non corretto. Uno o più batterie sono guaste. Le batterie sono sbilanciate. Una o più batterie sono sotto 14,6 V. Una o più batterie non sono di tipo corretto.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Messaggio di allarme: pressione inferiore a quella ambientale - 2	
Condizione di allarme: Fase 2 inferiore a quella ambiente	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 4
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: l'allarme "Pressione prossimale inferiore a quella ambiente" viene generato quando la pressione prossimale scende al di sotto di -2 mbar per più di 50 ms.	
Azione del ventilatore: Azione del ventilatore: quando il sottosistema del monitor rileva la pressione prossimale al di sotto di -2 mbar per più di 50 ms istruisce il sottosistema del controller ad arrestare tutti i gas. Se il gas non viene tagliato per i prossimi 50 ms, il sottosistema del monitor interviene e taglia i gas.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito del paziente. Se l'allarme persiste, sottoporre il paziente a una forma alternativa di ventilazione. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Messaggio di allarme: pressione inferiore a quella ambientale - 1	
Condizione di allarme: Fase 1 inferiore a quella ambiente	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 5
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: l'allarme "Pressione inferiore a quella ambiente" viene generato quando la pressione prossimale scende al di sotto di -2 mbar per meno di 50 ms.	
Azione del ventilatore: quando il sottosistema del monitor rileva la pressione prossimale al di sotto di -2 mbar per meno di 50 ms istruisce il sottosistema del controller ad arrestare tutti i gas. Se il gas non viene tagliato durante i prossimi 50 ms il sottosistema del monitor interviene e taglia i gas.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito del paziente. Se l'allarme persiste, sottoporre il paziente a una forma alternativa di ventilazione. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Messaggio di allarme: Calibrazione non possibile. Porre il ventilatore fuori uso	
Condizione di allarme: guasto memoria monitor	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 6
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: i valori di calibrazione memorizzati sono stati corrotti. Questo controllo può essere effettuato solo all'avvio. I valori possono essere cancellati solo spegnendo il ventilatore.	
La natura degli allarmi può essere letta dalla scheda registro allarmi (campo Limite).	
Vedere ""Ventilatore fuori taratura" tabella guasti" a pagina 219.	
I valori di calibrazione del flusso sono stati corrotti	
I valori di calibrazione dell'ossigeno sono stati corrotti	
I valori di calibrazione di offset della pressione sono stati corrotti	
I valori di calibrazione del guadagno della pressione sono stati corrotti	
I valori di calibrazione della costante di tempo della pressione sono stati corrotti	
Impossibile inviare i dati di calibrazione al lato isolato	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Messaggio di allarme: Errore hardware Monitor. Porre il ventilatore fuori uso	
Condizione di allarme: specifica ADC VREF	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 7
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
<p>Definizione: ADC 2V5 REF è fuori dalla specifica di almeno il 20%</p> <p>Altri errori ADC sono stati restituiti nella scheda registro allarmi (campo Limite).</p> <p>I valori possono essere cancellati spegnendo il ventilatore.</p> <p>Vedere ""Guasto hardware monitor" tabella guasti" a pagina 220.</p> <p>2V5 REF (questo messaggio ha triggerato questo allarme)</p> <p>Errore attesa 8 V (questo messaggio non ha triggerato questo allarme)</p> <p>Errore segnalatore 5 V (questo messaggio non ha triggerato questo allarme)</p> <p>Errore 3V3 (questo messaggio non ha triggerato questo allarme)</p>	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Messaggio di allarme: Errore Hardware Controller. Riavviare Ventilatore	
Condizione di allarme: guasto hardware di controllo	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 8
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: sì	Allarme silenziabile: no
<p>Definizione: numerosi guasti controller sono raggruppati insieme in questo allarme. La natura degli allarmi può essere letta nella scheda registro allarmi (campo Limite). Vedere ""Guasto hardware del controller" tabella guasti" a pagina 220.</p> <p>Test automatico modulo gas fresco non riuscito</p> <p>Test automatico modulo miscelatore non riuscito</p> <p>Test automatico modulo getto respiro non riuscito</p> <p>Il controller non risponde</p> <p>Il controller è stato resettato.</p>	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
<p>Azione dell'utente:</p> <p>Passo 1. Ventilare manualmente il paziente.</p> <p>Passo 2. Registrare le impostazioni del ventilatore.</p> <p>Passo 3. Entrare in modalità Standby e poi riavviare il ventilatore.</p> <p>Passo 4. Rientrare nella modalità di ventilazione e ripristinare le impostazioni del ventilatore registrate prima del riavvio.</p>	
AVVERTENZA: se a questo punto riappare il messaggio di allarme "Errore Hardware Controller. Riavviare Ventilatore" trasferire il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	
<p>Passo 5. Se necessario, ricalibrare il sensore di flusso.</p> <p>Passo 6. Se necessario, accendere il monitoraggio etCO₂ / SpO₂.</p> <p>Passo 7. Ricollegare il paziente al ventilatore.</p> <p>Passo 8. Se necessario, regolare i parametri di ventilazione.</p>	

Messaggio di allarme: Errore sistema Controller. Riavviare ventilatore	
Condizione di allarme: l'interfaccia utente di comando non risponde	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 9
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: il sottosistema del controller invia segnali di operatività a intervalli regolari al sottosistema del monitor. Se tali segnali vengono interrotti per un periodo superiore a quello prescritto, si presume che il sottosistema del controller non funzioni correttamente e viene generato un allarme "Errore sistema Controller. Riavviare ventilatore". Qualsiasi messaggio di errore di sistema ricevuto dal controller attiverà anch'esso questo allarme.	
Azione del ventilatore: se si verifica un guasto nel sottosistema di controllo, il funzionamento di tutte le valvole viene disattivato. Senza alimentazione delle valvole, il flusso di gas fresco di 1,8 l/min di aria è disponibile per la respirazione spontanea. Il sottosistema del monitor dovrà riconoscere che il controller non risponde più alle richieste di stato ed emetterà un allarme. Se il controller si ripristina da solo, interromperà la ventilazione.	
Azione dell'utente: Passo 1. Ventilare manualmente il paziente. Passo 2. Registrare le impostazioni del ventilatore. Passo 3. Entrare in modalità Standby e poi riavviare il ventilatore. Passo 4. Rientrare nella modalità di ventilazione e ripristinare le impostazioni del ventilatore registrate prima del riavvio.	
AVVERTENZA: se a questo punto riappare il messaggio di allarme "Errore sistema Controller. Riavviare ventilatore" trasferire il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	
Passo 5. Se necessario, ricalibrare il sensore di flusso. Passo 6. Se necessario, accendere il monitoraggio etCO₂ / SpO₂. Passo 7. Ricollegare il paziente al ventilatore. Passo 8. Se necessario, regolare i parametri di ventilazione.	

Messaggio di allarme: mancanza gas	
Condizione di allarme: gas non collegato	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 10
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: questo allarme viene generato dal sottosistema del controller che indica che l'alimentazione di aria e ossigeno è scesa sotto a 2 bar.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma alternativa di ventilazione.	

Messaggio di allarme: prolungata pressione positiva	
Condizione di allarme: pressione prolungata	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità tranne terapia ad Alti flussi	Classificazione di allarme: 11
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: viene generato questo allarme se la pressione è superiore a 5 mBar oltre il livello CPAP impostato dall'utente per 4 secondi. In modalità HFO puro, questo allarme viene generato quando la media misurata è superiore a 15 mbar oltre la media rilevata o a 15 mbar oltre la soglia di allarme ricevuto.	
Azione del ventilatore: nelle modalità convenzionali, se la pressione aumenta superando 5 mbar oltre la pressione impostata dall'utente o viene riconosciuta la condizione di pressione positiva prolungata, il monitor lancerà un allarme e instruirà il controller per arrestare la ventilazione. Se il problema non si risolve, il sottosistema del monitor interviene e arresta la ventilazione.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito del paziente. Se l'allarme persiste, sottoporre il paziente a una forma alternativa di ventilazione. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Messaggio di allarme: soglia di alta pressione superata.

Condizione di allarme: alta pressione	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità tranne terapia ad Alti flussi	Classificazione di allarme: 12
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: sì	Allarme silenziabile: sì
Definizione: nelle modalità convenzionali, se la pressione massima supera 5 mbar oltre la soglia di pressione PIP alta, il monitor emetterà un allarme e istruirà l'arresto al controller. In caso di guasto, il sottosistema di monitoraggio interviene e interrompe la ventilazione.	
Azione del ventilatore: se la pressione è 5 mbar oltre la soglia PIP alta, viene inviato un comando al controller per interrompere il gas, ma mantenere la CPAP/PEEP/media. Se la pressione supera 20 mbar oltre la soglia PIP alta, il monitor deve tagliare tutto il gas.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare i parametri ventilatori o la soglia PIP alta.	

Messaggio di allarme: Paw alta

Condizione di allarme: paw alta	Tipo di allarme: paziente
Attivo in HFO, HFO+CMV & NHFOV solo.	Classificazione di allarme: 13
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: sì	Allarme silenziabile: sì
Definizione: la pressione prossimale ha superato la soglia di allarme Paw alta di non oltre 5 mbar.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare i parametri ventilatori o la soglia Paw alta.	

Messaggio di allarme: PIP alta

Condizione di allarme: PIP alta	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità tranne HFO, NHFOV e Alti flussi.	Classificazione di allarme: 14
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: sì	Allarme silenziabile: sì
Definizione: la pressione prossimale ha superato la soglia di allarme PIP alta di non oltre 5 mbar.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare i parametri ventilatori o la soglia PIP alta.	

Messaggio di allarme: CPAP alta

Condizione di allarme: CPAP alta	Tipo di allarme: paziente
Attiva in modalità CPAP solo	Classificazione di allarme: 15
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: sì	Allarme silenziabile: sì
Definizione: la pressione prossimale ha superato la soglia di allarme CPAP alta.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare i parametri ventilatori o la soglia CPAP alta.	

Messaggio di allarme: PIP bassa	
Condizione di allarme: PIP bassa	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità tranne HFO, NHFOV e Alti flussi	Classificazione di allarme: 16
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: sì	Allarme silenziabile: sì
Definizione: Per CPAP, CMV, PSV, PTV e SIMV 1. La pressione prossimale deve andare dal di sotto al di sopra della soglia di allarme PIP durante il periodo di inspirazione e deve rimanere al di sopra della soglia per il periodo di inspirazione impostato. Per NIPPV e NIPPVtr 1. L'allarme PIP bassa è disabilitato se la differenza tra la PIP e PEEP è impostata a 6mbar o meno. 2. Se la differenza tra PIP e PEEP supera gli 6 mbar si applica quanto segue a. Se RR supera 50 BPM o più l'allarme suona dopo 5 cicli del ventilatore. b. Se FF supera 50 BPM l'allarme suonerebbe dopo 2 cicli di ventilatori.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare i parametri ventilatori o la soglia PIP bassa.	

Messaggio di allarme: pressione bassa	
Condizione di allarme: pressione bassa	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 17
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: sì	Allarme silenziabile: sì
Definizione: viene generato un allarme se la pressione prossimale è al di sotto del livello di pressione PEEP bassa	
Azione del ventilatore: se la pressione prossimale è al di sotto del livello di pressione PEEP bassa impostato il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme. Se la pressione media scende sotto lo zero, il monitor instruirà il controller di arrestare la ventilazione. Se il problema non si risolve, il sottosistema del monitor interviene e interrompe la ventilazione.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare i parametri ventilatori o la soglia PEEP bassa.	

Messaggio di allarme: rilevata variazione di pressione.	
Condizione di allarme: variazione MAX di pressione	Tipo di allarme: paziente
Attivo in HFO+CMV solo	Classificazione di allarme: 18
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: sì	Allarme silenziabile: sì
Definizione: modificando l'impostazione del ventilatore, viene rilevata la pressione minima e massima durante la fase inspiratoria ed espiratoria. Per il trigger di questo allarme, le seguenti condizioni devono essere vere: Condizione 1: 1-La pressione espiratoria massima rilevata non deve essere inferiore a 10 mBar 2-La pressione massima durante la fase di inspirazione differisce dal valore rilevato di oltre 5 mBar. Condizione 2: 2-La pressione massima durante la fase di espirazione differisce dal valore rilevato di oltre 5 mBar.	
Azione del ventilatore: se le condizioni per lo scenario 1 o 2 non sono soddisfatte il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare i parametri ventilatori oppure premere Autoset.	

Messaggio di allarme: errore di ciclo.	
Condizione di allarme: errore di ciclo	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità volume.	Classificazione di allarme: 19
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: viene generato questo allarme se il volume prefissato è attivo e 2 respiri consecutivi mostrano PEEP e PIP < 3 mbar.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare i parametri ventilatori.	

Messaggio di allarme: Sensore Pressione Guasto. Porre il ventilatore fuori uso	
Condizione di allarme: deriva di pressione	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità tranne terapia ad Alti flussi	Classificazione di allarme: 20
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: viene generato questo allarme se le letture dei due trasduttori di pressione di ingresso differiscono di più di 5 mbar per oltre 0,5 secondi.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Messaggio di allarme: PEEP alta	
Condizione di allarme: PEEP troppo alta	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità tranne HFO, NHFOV e Alti flussi	Classificazione di allarme: 21
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: la pressione prossimale ha superato la soglia di allarme PEEP alta durante il ciclo espiratorio.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare i parametri ventilatori.	

Messaggio di allarme: Aumento inatteso della pressione media	
Condizione di allarme: pressione media alta	Tipo di allarme: paziente
Attivo in HFO e NHFO solo	Classificazione di allarme: 22
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: se la pressione prossimale media supera la pressione media impostata di oltre 5 mbar, viene generato questo allarme.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare i parametri ventilatori.	

Messaggio di allarme: diminuzione inattesa della pressione media

Condizione di allarme: pressione media bassa	Tipo di allarme: paziente
Attivo in HFO e NHFO solo	Classificazione di allarme: 23
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: viene generato questo allarme se la pressione prossimale media è al di sotto della pressione media impostata di oltre 5 mbar.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare i parametri ventilatori.	

Messaggio di allarme: aumento inatteso del Delta P

Condizione di allarme: aumento della pressione delta	Tipo di allarme: paziente
Attivo in HFO e NHFO solo	Classificazione di allarme: 24
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: viene generato questo allarme se il minimo e il massimo della pressione prossimale aumenta/ diminuisce di oltre 5 mbar rispetto al valore rilevato	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare i parametri ventilatori.	

Messaggio di allarme: caduta inattesa del Delta P

Condizione di allarme: caduta della pressione delta	Tipo di allarme: paziente
Attivo in HFO e NHFO solo	Classificazione di allarme: 25
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: viene generato questo allarme se la pressione prossimale scende di oltre 5 mbar rispetto al valore rilevato	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare i parametri ventilatori.	

Il messaggio di allarme classificato come 26 non è più utilizzato in questa versione del software

Messaggio di allarme: mancanza ossigeno

Condizione di allarme: O2 non collegato	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 27
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: questo allarme viene generato dal sottosistema del controller che indica che l'alimentazione di ossigeno è scesa sotto 2 bar.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme e continuerà a funzionare con l'alimentazione d'aria.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma alternativa di ventilazione.	

Messaggio di allarme: mancanza aria.	
Condizione di allarme: aria non collegata	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 28
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: questo allarme viene generato dal sottosistema del controller che indica che l'alimentazione d'aria è scesa al di sotto di 2 bar.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme e continuerà a funzionare con l'alimentazione d'ossigeno.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma alternativa di ventilazione.	

Messaggio di allarme: Errore hardware Monitor. Porre il ventilatore fuori uso	
Condizione di allarme: specifica tensione ADC	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 29
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: questo allarme viene generato ogni volta che alcuni dei binari di tensione sulla scheda del monitor sono fuori dalla specifica (calo di oltre il 20%). I codici di errore possono essere letti dalla scheda registro allarmi (campo Limite).	
Vedere ““Guasto hardware monitor” tabella guasti” a pagina 220.	
2V5 REF (questo messaggio non ha triggerato questo allarme)	
Errore attesa 8 V (questo messaggio ha triggerato questo allarme)	
Errore segnalatore 5 V (questo messaggio ha triggerato questo allarme)	
Errore 3V3 (questo messaggio ha triggerato questo allarme)	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Messaggio di allarme: Errore Batteria. Porre il ventilatore fuori uso	
Condizione di allarme: integrità batteria alimentatore	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 30
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: viene generato questo allarme se la batteria non è collegata o guasta	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme. In caso di guasto di alimentazione il ventilatore si arresterà, ma fornirà un flusso di gas fresco per assistere nella respirazione spontanea (1,8 l/min).	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Messaggio di allarme: batteria scarica.	
Condizione di allarme: alimentazione meno di 10 minuti per la scarica completa	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 31
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: viene generato questo allarme se rimangono meno di 10 minuti alla scarica completa della batteria.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme e continuerà a funzionare.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma alternativa di ventilazione.	

Messaggio di allarme: batteria scarica.	
Condizione di allarme: alimentazione batteria bassa	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 32
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: viene generato questo allarme se la capacità residua è meno del 25%.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme e continuerà a funzionare.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma alternativa di ventilazione.	

Messaggio di allarme: Blocco gas. Verifica circuito paziente.	
Condizione di allarme: allarme di blocco	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 33
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no, tranne in alti flussi	Allarme silenziabile: no
Definizione: questo allarme viene generato dal sottosistema del controller per indicare che la sezione del gas fresco del circuito paziente è bloccata.	
Azione del ventilatore: la pressione del gas fresco è costantemente monitorata dal sottosistema del controller. La lettura della pressione è inoltre continuamente richiesta dal sottosistema di monitoraggio.	
Azione dell'utente: controllare il circuito paziente.	

Messaggio di allarme: Perdita gas. Verifica circuito paziente.	
Condizione di allarme: allarme di perdita	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 34
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: questo allarme viene generato dal sottosistema del controller per indicare che la sezione del gas fresco del circuito paziente perde.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme ma le pressioni PEEP e PIP raggiungibili saranno ridotte.	
Azione dell'utente: controllare il circuito paziente.	

Messaggio di allarme: Errore Comunicazione Mon. Isolato. Riavviare ventilatore	
Condizione di allarme: errore di comunicazione seriale	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità con sensore di flusso connesso	Classificazione di allarme: 35
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: l'errore di comunicazione interno si è verificato nel sottosistema del monitor.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: Passo 1. Ventilare manualmente il paziente. Passo 2. Registrare le impostazioni del ventilatore. Passo 3. Entrare in modalità Standby e poi riavviare il ventilatore. Passo 4. Rientrare nella modalità di ventilazione e ripristinare le impostazioni del ventilatore registrate prima del riavvio.	
AVVERTENZA: se a questo punto riappare il messaggio di allarme "Errore Comunicazione Mon. Isolato. Riavviare ventilatore" trasferire il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	
Passo 5. Se necessario, ricalibrare il sensore di flusso. Passo 6. Se necessario, accendere il monitoraggio etCO₂ / SpO₂. Passo 7. Ricollegare il paziente al ventilatore. Passo 8. Se necessario, regolare i parametri di ventilazione.	

Messaggio di allarme: Errore Sistema Monitor Isolato. Riavviare Ventilatore	
Condizione di allarme: isolare l'errore di sistema	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità con sensore di flusso connesso	Classificazione di allarme: 36
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: viene generato questo allarme se i dati di configurazione nel lato isolato del sottosistema monitor.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: Passo 1. Ventilare manualmente il paziente. Passo 2. Registrare le impostazioni del ventilatore. Passo 3. Entrare in modalità Standby e poi riavviare il ventilatore. Passo 4. Rientrare nella modalità di ventilazione e ripristinare le impostazioni del ventilatore registrate prima del riavvio.	
AVVERTENZA: se a questo punto riappare il messaggio di allarme "Errore Sistema Monitor Isolato. Riavviare Ventilatore" trasferire il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	
Passo 5. Se necessario, ricalibrare il sensore di flusso. Passo 6. Se necessario, accendere il monitoraggio etCO₂ / SpO₂. Passo 7. Ricollegare il paziente al ventilatore. Passo 8. Se necessario, regolare i parametri di ventilazione.	

Messaggio di allarme: impossibile calibrare il sensore di flusso.	
Condizione di allarme: impossibilità del convertitore A/D di calibrazione flusso	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità con sensore di flusso connesso	Classificazione di allarme: 37
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: viene generato questo allarme se durante la calibrazione del flusso del sottosistema del monitor i livelli del segnale sono fuori dai limiti.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore.	

Messaggio di allarme: Sensore di flusso difettoso.	
Condizione di allarme: sensore di flusso difettoso	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità con sensore di flusso connesso	Classificazione di allarme: 38
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo allarme viene generato in caso di rottura di uno dei fili del sensore di flusso.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: sostituire il sensore di flusso	

Messaggio di allarme: Sensore di flusso contaminato.	
Condizione di allarme: il sensore di flusso è contaminato.	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità con sensore di flusso connesso	Classificazione di allarme: 39
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo allarme viene generato se il flusso misurato è superiore a 15 l/min per 3,5 secondi	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: sostituire il sensore di flusso	

Messaggio di allarme: il sensore di flusso non è connesso.	
Condizione di allarme: il sensore di flusso non è connesso.	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità con sensore di flusso connesso	Classificazione di allarme: 40
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo allarme viene generato se il sensore di flusso non è connesso o in caso di rottura di entrambi i fili.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: sostituire il sensore di flusso	

Messaggio di allarme: impossibile calibrare il sensore di flusso.

Condizione di allarme: impossibilità di calibrazione del sensore di flusso	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità con sensore di flusso connesso	Classificazione di allarme: 41
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo allarme viene generato in caso di impossibilità di calibrazione del flusso.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: sostituire il sensore di flusso. Se l'allarme persiste, sottoporre il paziente a una forma alternativa di ventilazione. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Messaggio di allarme: calibrare il sensore di flusso.

Condizione di allarme: il sensore di flusso non è calibrato	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità con sensore di flusso connesso	Classificazione di allarme: 42
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: viene generato l'allarme in alto ogni volta che il ventilatore viene acceso o alla riconnessione del sensore di flusso.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: calibrare il sensore di flusso.	

Messaggio di allarme: sensore di flusso non montato correttamente.

Condizione di allarme: sensore di flusso non montato correttamente	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità con sensore di flusso connesso tranne HFO	Classificazione di allarme: 43
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: viene generato questo allarme se il sensore di flusso viene posizionato in modo non corretto nel circuito o il cavo di collegamento viene posto a 180 gradi fuori fase rispetto a dove dovrebbe andare.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: rimontare il sensore di flusso	

Messaggio di allarme: Sensore di flusso malfunzionante

Condizione di allarme: sensore di flusso tagliato	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità con sensore di flusso connesso tranne HFO	Classificazione di allarme: 44
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo allarme viene generato se il sensore di flusso è superiore a 30 LPM per entrambi i respiri.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare i parametri ventilatori.	

Messaggio di allarme: L'interfaccia Utente si è resettato. Controllare impostazioni ventilatore	
Condizione di allarme: l'interfaccia utente deve essere ripristinata	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 45
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: viene generato se il sottosistema di interfaccia ripristina questo allarme.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: Passo 1. Registrare le impostazioni del ventilatore. Punto 2. Premere il pulsante Reset per cancellare il messaggio di allarme.	
AVVERTENZA: se l'allarme riappare sottoporre il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Messaggio di allarme: volume minuto alto	
Condizione di allarme: volume minuto alto	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità con un sensore di flusso connesso, tranne HFO+CMV. Non disponibile in modalità non invasive e in alti flussi.	Classificazione di allarme: 46
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: viene generato questo allarme se il volume minuto è superiore alla soglia di volume minuto alta impostata	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare la soglia di allarme.	

Messaggio di allarme: Elevata perdita al paziente.	
Condizione di allarme: perdita	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità con un sensore di flusso connesso, tranne HFO+CMV, modalità non invasive e alti flussi.	Classificazione di allarme: 47
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo allarme viene generato nel caso in cui la perdita paziente misurata sia superiore alla soglia di allarme impostata dall'utente	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare la soglia di allarme.	

Messaggio di allarme: volume corrente basso	
Condizione di allarme: volume corrente basso	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità con un sensore di flusso connesso, tranne modalità non invasiva e alti flussi.	Classificazione di allarme: 48
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo allarme viene generato se i volumi correnti sono superiori alla soglia selezionata dall'utente.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare la soglia di allarme.	

Messaggio di allarme: volume corrente alto	
Condizione di allarme: volume corrente alto	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità con un sensore di flusso connesso, tranne modalità non invasiva e alti flussi.	Classificazione di allarme: 49
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo allarme viene generato se i volumi correnti sono superiori alla soglia selezionata dall'utente.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare la soglia di allarme.	

Messaggio di allarme: volume minuto basso	
Condizione di allarme: volume minuto basso	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità con un sensore di flusso connesso, tranne modalità non invasiva e alti flussi.	Classificazione di allarme: 50
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo allarme viene generato se il volume minuto è inferiore alla soglia di volume minuto bassa impostata dall'utente	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare la soglia di allarme.	

Messaggio di allarme: Respiro non rilevato.	
Condizione di allarme: respiro di apnea	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità con un sensore di flusso connesso, tranne modalità non invasiva e alti flussi.	Classificazione di allarme: 51
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo allarme viene generato se il respiro non viene rilevato dopo 20 secondi dopo l'erogazione del ciclo pressorio da parte del ventilatore	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare la soglia di allarme.	

Messaggio di allarme: apnea	
Condizione di allarme: volume apnea	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità con un sensore di flusso connesso, tranne modalità non invasiva e alti flussi.	Classificazione di allarme: 52
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo allarme viene generato se il trigger di flusso non viene rilevato entro il tempo di apnea impostato dall'utente	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare la soglia di allarme.	

Messaggio di allarme: apnea	
Condizione di allarme: pressione di apnea	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità senza sensore di flusso connesso.	Classificazione di allarme: 53
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo allarme viene generato se il trigger di pressione non viene rilevato entro il tempo di apnea impostato dall'utente.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare la soglia di allarme.	

Messaggio di allarme: Frequenza respiratoria alta.	
Condizione di allarme: BPM alta	Tipo di allarme: paziente
Attiva in sezione a singolo o doppio lume invasiva CPAP, PTV, PSV, SIMV e NCPAP non invasiva. Non disponibile in alti flussi.	Classificazione di allarme: 54
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo allarme viene generato quando la BPM (FR) totale misurata è superiore alla soglia impostata dall'utente.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Controllare il circuito paziente. Regolare la soglia di allarme.	

Messaggio di allarme: Mancanza di alimentazione elettrica.	
Condizione di allarme: guasto di rete	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 55
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: basso
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo allarme viene generato quando la tensione di rete viene staccata dal ventilatore.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme e passerà alla fonte di alimentazione interna.	
Azione dell'utente: ripristinare l'alimentazione di rete. Sottoporre il paziente a una forma alternativa di ventilazione.	

Messaggi di allarme: Sensor O2 disconnesso. Riconnettere	
Condizione di allarme: cella di misura ossigeno non connessa	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 56
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: la disconnessione della cella di misura ossigeno genera questo allarme.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Messaggio di allarme: la cella di misura ossigeno necessita di calibrazione.

Condizione di allarme: la cella di misura ossigeno necessita di calibrazione	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 57
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: sì	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo allarme viene generato se in qualsiasi momento la cella di misura ossigeno è superiore al 100%	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: ricalibrare la cella di misura ossigeno. Se il messaggio persiste, sottoporre il paziente a una forma alternativa di ventilazione. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Messaggio di allarme: è necessaria una nuova cella di misura ossigeno.

Condizione di allarme: la cella di misura ossigeno deve essere sostituita	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 58
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo allarme viene generato se durante la calibrazione non è stato possibile calibrare la cella di misura ossigeno.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Effettuare la sostituzione della cella di misura ossigeno.	

Messaggio di allarme: Errore di calibrazione ossigeno

Condizione di allarme: Errore di calibrazione ossigeno	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 59
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo allarme viene generato se, durante la calibrazione dell'ossigeno al 100%, la cella di ossigeno non rileva ossigeno al 100%.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore.	

Messaggio di allarme: Alta concentrazione di ossigeno.

Condizione di allarme: alta concentrazione di ossigeno	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 60
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo messaggio viene generato se l'ossigeno fornito è superiore al livello di ossigeno impostato dall'utente oltre il 5%.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Ricalibrare la cella di misura ossigeno. Se il messaggio persiste, sottoporre il paziente a una forma alternativa di ventilazione. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Messaggio di allarme: Bassa concentrazione di ossigeno.	
Condizione di allarme: bassa concentrazione di ossigeno	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 61
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: questo messaggio viene generato se l'ossigeno fornito è inferiore al livello di ossigeno impostato dall'utente oltre il 5%.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: controllare il paziente. Ricalibrare la cella di misura ossigeno. Se il messaggio persiste, sottoporre il paziente a una forma alternativa di ventilazione. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Messaggio di allarme: O2 > N%	
Condizione di allarme: O2 superiore alla percentuale impostata	Tipo di allarme: tecnico
Attiva solo in modalità OxyGenie®	Classificazione di allarme: 62
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: quando OxyGenie® è attivo l'utente può impostare un livello di ossigeno fornito oltre il quale si desidera essere informati, predefinito di 60, il ritardo di allarme è lo stesso del ritardo di allarme SpO2. N = percentuale impostata dall'utente.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente:: controllare il paziente per la modifica della condizione sottostante che causa una maggiore richiesta di ossigeno, considerando la regolazione dei parametri del ventilatore. Controllare il circuito paziente per le perdite.	

Messaggio di allarme: Guasto comunicazione interna. Rimuovere il ventilatore dall'uso.	
Condizione di allarme: è possibile visualizzare la congestione	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 63
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: questo allarme viene generato se i dati non possono essere inviati al sottosistema dell'interfaccia utente.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore.	

Messaggio di allarme: OxyGenie inatteso	
Condizione di allarme: errore PLCL	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 64
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: il sottosistema PCLC serve a inviare segnali di operatività a intervalli regolari al monitor. Se tali segnali vengono interrotti per un periodo superiore a quello prescritto, si presume che il sottosistema PCLC non funzioni correttamente.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: è necessaria la titolazione/regolazione manuale dell'ossigeno. Portare il ventilatore in assistenza se necessario	

Messaggio di allarme: Controllo uscita dati.	
Condizione di allarme: guasto hardware MO	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 65
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: no
Definizione: ESMO non risponde. Il sottosistema ESMO serve a inviare segnali di operatività a intervalli regolari al monitor. Se tali segnali vengono interrotti per un periodo superiore a quello prescritto, si presume che il sottosistema ESMO non funzioni correttamente.	
Azione del ventilatore: il ventilatore visualizzerà questo messaggio di allarme. Premendo il tasto reset il messaggio di allarme diventa un messaggio di stato che rimane visibile mentre l'ESMO non risponde.	
Azione dell'utente: Con un dispositivo di monitoraggio esterno collegato. Premere il pulsante di reset e controllare che i monitor esterni stiano ancora ricevendo dati. Se non si ricevono dati, scollegare il dispositivo di monitoraggio. La funzionalità di ventilazione non è influenzata. Se il messaggio di stato non si auto-annulla e rimane presente fino alla fine della sessione del paziente, portare il ventilatore in assistenza. Senza un dispositivo di monitoraggio esterno collegato. Premere il pulsante di reset. La funzionalità di ventilazione non è influenzata. Se il messaggio di stato non si auto-annulla e rimane presente fino alla fine della sessione del paziente, portare il ventilatore in assistenza.	

Allarmi sensore esterno
Tutti gli allarmi del sensore esterno (etCO ₂ e SpO ₂) sono classificati 66 quando attivi. Vedere "Allarmi sensore" a pagina 221.

Messaggio di allarme: Oxygenie inatteso reset	
Condizione di allarme: il PCLC si è resettato	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità quando è presente la licenza Auto-O₂	Classificazione di allarme: 67
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Definizione: l'IU controlla lo stato del PCLC, se il PCLC ripristina l'IU lo segnalerà, il PCLC sarà in modalità manuale al ripristino	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: OxyGenie® è stato impostato in manuale a causa del ripristino, riattivare OxyGenie® per procedere con la regolazione automatica di O₂. Prima di riattivare OxyGenie®, verificare che l'impostazione O₂ rifletta la condizione clinica corrente del paziente per garantire che l'algoritmo di controllo risponda appropriatamente. Se l'allarme persiste, è necessaria la titolazione/regolazione manuale dell'ossigeno e portare il ventilatore in assistenza se necessario	

Messaggio di allarme: Allarme Errore Sistema. Porre il ventilatore fuori uso	
Condizione di allarme: errore generatore di allarme	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 68
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: sì	Allarme silenziabile: no
Definizione: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme e il segnalatore acustico di backup suonerà. L'utente non può annullare il tono di allarme del segnalatore acustico di backup. Se viene generato un nuovo allarme il componente visivo dell'allarme viene solo annullato.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Messaggio di allarme: Allarme Errore Sistema. Porre il ventilatore fuori uso	
Condizione di allarme: guasto segnalatore acustico di backup	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità	Classificazione di allarme: 69
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: sì	Allarme silenziabile: no
Definizione: questo allarme viene generato ogni qual volta l'IU rileva un problema nell'altoparlante di backup. L'allarme può essere cancellato solo spegnendo il ventilatore.	
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma di ventilazione alternativa. Porre fuori uso il ventilatore. Portare il ventilatore in assistenza.	

Suono di allarme: mancanza totale di alimentazione	
Condizione di allarme: mancanza totale di alimentazione	Tipo di allarme: tecnico
-	Classificazione di allarme: -
Tipo di allarme: solo sonoro	Priorità allarme: alta
Definizione: quando la fonte di alimentazione interna si scarica viene emesso questo allarme.	
Azione del ventilatore: il ventilatore emetterà questo allarme sonoro fino a quando l'unità non viene spenta o l'alimentazione non si scarica completamente.	
Azione dell'utente: sottoporre il paziente a una forma alternativa di ventilazione.	

29.4 “Alimentazione guasta” tabella guasti

N° allarme visualizzato	Una o più batterie non sono di tipo corretto.	Una o più batterie sono sotto 14,6 V.	Le batterie sono sbilanciate	Uno o più batterie sono guaste.	Tipo PSU non corretto	È stato restituito un codice di guasto dal PSU
1						X
2					X	
3					X	X
4				X		
5				X		X
6				X	X	
7				X	X	X
8			X			
9			X			X
10			X		X	
11			X		X	X
12			X	X		
13			X	X		X
14			X	X	X	
15			X	X	X	X
16		X				
17	X					X
18	X				X	
19		X			X	X
20		X		X		
21		X		X		X
22		X		X	X	
23		X		X	X	X
24		X	X			
25		X	X			X
26		X	X		X	
27		X	X		X	X
28		X	X	X		
29		X	X	X		X
30		X	X	X	X	
31		X	X	X	X	X

N° allarme visualizzato	Una o più batterie non sono di tipo corretto.	Una o più batterie sono sotto 14,6 V.	Le batterie sono sbilanciate	Uno o più batterie sono guaste.	Tipo PSU non corretto	È stato restituito un codice di guasto dal PSU
32	X					
33	X					X
34	X				X	
35	X				X	X
36	X			X		
37	X			X		X
38	X			X	X	
39	X			X	X	X
40	X		X			
41	X		X			X
42	X		X		X	
43	X		X		X	X
44	X		X	X		
45	X		X	X		X
46	X		X	X	X	
47	X		X	X	X	X
48	X	X				
49	X	X				X
50	X	X			X	
51	X	X			X	X
52	X	X		X		
53	X	X		X		X
54	X	X		X	X	
55	X	X		X	X	X
56	X	X	X			
57	X	X	X			X
58	X	X	X		X	
59	X	X	X		X	X
60	X	X	X	X		
61	X	X	X	X		X
62	X	X	X	X	X	
63	X	X	X	X	X	X

29.5 “Ventilatore fuori taratura” tabella guasti

N° allarme visualizzato	Impossibile inviare i dati di calibrazione al lato isolato	I valori di calibrazione della costante di tempo della pressione sono stati corretti	I valori di calibrazione del guadagno della pressione sono stati corretti	I valori di calibrazione di offset della pressione sono stati corretti	I valori di calibrazione dell'ossigeno sono stati corretti	I valori di calibrazione del flusso sono stati corretti
1						X
2					X	
3					X	X
4				X		
5				X		X
6				X	X	
7				X	X	X
8			X			
9			X			X
10			X		X	
11			X		X	X
12			X	X		
13			X	X		X
14			X	X	X	
15			X	X	X	X
16		X				
17	X					X
18	X				X	
19		X			X	X
20		X		X		
21		X		X		X
22		X		X	X	
23		X		X	X	X
24		X	X			
25		X	X			X
26		X	X		X	
27		X	X		X	X
28		X	X	X		
29		X	X	X		X
30		X	X	X	X	

N° allarme visualizzato	Impossibile inviare i dati di calibrazione al lato isolato	I valori di calibrazione della costante di tempo della pressione sono stati corretti	I valori di calibrazione del guadagno della pressione sono stati corretti	I valori di calibrazione di offset della pressione sono stati corretti	I valori di calibrazione dell'ossigeno sono stati corretti	I valori di calibrazione del flusso sono stati corretti
31		X	X	X	X	X
32	X					
33	X					X
34	X				X	
35	X				X	X
36	X			X		
37	X			X		X
38	X			X	X	
39	X			X	X	X
40	X		X			
41	X		X			X
42	X		X		X	
43	X		X		X	X
44	X		X	X		
45	X		X	X		X
46	X		X	X	X	
47	X		X	X	X	X
48	X	X				
49	X	X				X
50	X	X			X	
51	X	X			X	X
52	X	X		X		
53	X	X		X		X
54	X	X		X	X	
55	X	X		X	X	X
56	X	X	X			
57	X	X	X			X
58	X	X	X		X	
59	X	X	X		X	X
60	X	X	X	X		
61	X	X	X	X		X
62	X	X	X	X	X	
63	X	X	X	X	X	X

**29.6 "Guasto hardware del controller"
tabella guasti**

N° allarme visualizzato	Reset controller	Il controller non risponde	Modulo getto respiro	Modulo miscelatore	Modulo gas fresco
1					X
2				X	
3				X	X
4			X		
5			X		X
6			X	X	
7			X	X	X
8		X			
9		X			X
10		X		X	
11		X		X	X
12		X	X		
13		X	X		X
14		X	X	X	
15		X	X	X	X
16	X				
17	X				X
18	X			X	
19	X			X	X
20	X		X		
21	X		X		X
22	X		X	X	
23	X		X	X	X
24	X	X			
25	X	X			X
26	X	X		X	
27	X	X		X	X
28	X	X	X		
29	X	X	X		X
30	X	X	X	X	
31	X	X	X	X	X

29.7 "Guasto hardware monitor" tabella guasti

N° allarme visualizzato	Errore 3V3	Errore attesa 8 V	Errore attesa 8 V	Errore VREF
1				X
2			X	
3			X	X
4		X		
5		X		X
6		X	X	
7		X	X	X
8	X			
9	X			X
10	X		X	
11	X		X	X
12	X	X		
13	X	X		X
14	X	X	X	
15	X	X	X	X

30. Allarmi sensore

30.1 Priorità allarme

Le proprietà standard per i sensori esterni quando entrambi i sensori etCO₂ e SpO₂ sono collegati.

Quando un allarme viene presentato all'utente (in base alle loro rispettive priorità) da ogni sensore esterno.

Le priorità sono come segue:

Priorità 1. SpO₂ allarme di sistema

Priorità 2. SpO₂ allarme paziente

Priorità 3. etCO₂ allarme di sistema

Priorità 4. etCO₂ allarme paziente

In generale un allarme SpO₂ ha una priorità superiore a quella dell'allarme etCO₂.

Tuttavia, nelle seguenti condizioni l'allarme etCO₂ assume una priorità superiore a quella dell'allarme spO₂.

Priorità 1. etCO₂ l'allarme paziente è attivo

Priorità 2. SpO₂ l'allarme di sistema è attivo

Priorità 3. etCO₂ l'allarme di sistema non è attivo

30.1.1 Messaggi di stato

Viene presentato solo un messaggio di stato da ogni sensore con la seguente priorità:

Priorità 1. Allarme SpO₂

Priorità 2. Allarme etCO₂

Priorità 3. Stato SpO₂

Priorità 4. Stato etCO₂

Se l'allarme etCO₂ ha una priorità superiore a quella dell'allarme SpO₂ la priorità diventa:

Priorità 1. Allarme etCO₂

Priorità 2. Allarme SpO₂

Priorità 3. Stato etCO₂

Priorità 4. Stato SpO₂

30.2 Monitoraggio SpO₂ (allarmi di sistema)

Messaggio di allarme: Guasto hardware SpO₂/etCO₂	
Condizione di allarme: errore di comunicazione	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 1
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: rimuovere i sensori SpO ₂ /etCO ₂ oppure premere il pulsante "Continua senza sensori esterni".	

Messaggio di allarme: Nessun modulo SpO₂ connesso	
Condizione di allarme: modulo disconnesso	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 2
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: collegare il sensore SpO ₂ o spegnere il monitoraggio SpO ₂ .	

Messaggio di allarme: guasto hardware SpO₂ - 1	
Condizione di allarme: guasto hardware/ errore hardware	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 3
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: sostituire il cavo sensore oppure rimuovere il cavo sensore SpO ₂ e spegnere il monitoraggio SpO ₂ oppure premere il pulsante "Continua senza sensore SpO ₂ ".	

Messaggio di allarme: guasto hardware SpO₂ - 2	
Condizione di allarme: modalità demo	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 4
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: sostituire il cavo sensore oppure rimuovere il cavo sensore SpO ₂ e spegnere il monitoraggio SpO ₂ oppure premere il pulsante "Continua senza sensore SpO ₂ ".	

Messaggio di allarme: guasto hardware SpO2 - 3	
Condizione di allarme: ripristino modulo SpO2	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 5
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: sostituire il cavo sensore oppure rimuovere il cavo sensore SpO2 e spegnere il monitoraggio SpO2 oppure premere il pulsante "Continua senza sensore SpO2".	

Messaggio di allarme: Nessun sensore SpO2 connesso	
Condizione di allarme: nessun sensore connesso	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 6
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: collegare il sensore SpO2 o spegnere il monitoraggio SpO2.	

Messaggio di allarme: Nessun cavo SpO2 connesso	
Condizione di allarme: nessun cavo connesso	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 7
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: collegare il sensore SpO2 o spegnere il monitoraggio SpO2.	

Messaggio di allarme: Nessun sensore SpO2 adesivo connesso	
Condizione di allarme: nessun sensore adesivo connesso	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 8
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: collegare il sensore Adesivo SpO2 o spegnere il monitoraggio SpO2.	

Messaggio di allarme: sensoreSpO2 difettoso - 1

Condizione di allarme: sensore difettoso	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 9
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: sostituire il sensore SpO2	

Messaggio di allarme: sensoreSpO2 difettoso - 2

Condizione di allarme: sensore non riconosciuto	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 10
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: sostituire il sensore SpO2	

Messaggio di allarme: Sensore SpO2 Off paziente

Condizione di allarme: Sensore off	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 11
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: controllare il sensore	

Messaggio di allarme: Rilevata interferenza sensore SpO2

Condizione di allarme: Rilevata interferenza	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 12
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: controllare il sensore	

Messaggio di allarme: Pulsazioni non rilevate (SpO2)

Condizione di allarme: Pulsazioni non rilevate	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 14
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: controllare il sensore	

30.3 Monitoraggio SpO₂ (allarmi paziente)

Messaggio di allarme: SpO2 alto	
Condizione di allarme: SpO2 alto	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 1
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e lampeggia il valore SpO2 nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: Controllare il paziente/Controllare i parametri di ventilazione	

Messaggio di allarme: SpO2 basso	
Condizione di allarme: SpO2 basso	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 2
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e lampeggia il valore SpO2 nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: Controllare il paziente/Controllare i parametri di ventilazione	

Messaggio di allarme: Frequenza pulsazioni alta	
Condizione di allarme: frequenza pulsazioni alta	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 3
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e lampeggia il valore PR nella barra dei titoli della forma d'onda.	
Azione dell'utente: Controllare il paziente/Controllare i parametri di ventilazione	

Messaggio di allarme: frequenza pulsazioni bassa	
Condizione di allarme: frequenza pulsazioni bassa	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 4
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e lampeggia il valore PR nella barra dei titoli della forma d'onda.	
Azione dell'utente: Controllare il paziente/Controllare i parametri di ventilazione	

30.4 Monitoraggio EtCO₂ (allarmi di sistema)

Messaggio di allarme: Guasto hardware SpO₂/etCO₂	
Condizione di allarme: errore di comunicazione	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 1
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: rimuovere i sensori SpO ₂ /etCO ₂ .	

Messaggio di allarme: Nessun modulo etCO₂ connesso	
Condizione di allarme: disconnessione modulo	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 2
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: collegare il sensore etCO ₂ o spegnere il monitoraggio etCO ₂ .	

Messaggio di allarme: guasto modulo etCO₂ - 1	
Condizione di allarme: malfunzionamento del modulo	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 3
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: sostituire il modulo sensore oppure rimuovere il modulo SpO ₂ e FilterLine™ e spegnere il monitoraggio etCO ₂ oppure premere il pulsante "Continua senza sensore etCO ₂ ".	

Messaggio di allarme: guasto modulo etCO₂ - 2	
Condizione di allarme: modalità non valida	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 4
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: sostituire il modulo del sensore o rimuovere il modulo etCO ₂ e FilterLine™ e spegnere il monitoraggio etCO ₂ .	

Messaggio di allarme: guasto modulo etCO2 - 3	
Condizione di allarme: ripristino modulo	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 5
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: sostituire il modulo del sensore o rimuovere il modulo etCO2 e FilterLine™ e spegnere il monitoraggio etCO2.	

Messaggio di allarme: Nessuna Linea filtro etCO2 connessa	
Condizione di allarme: FilterLine™ non connessa	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 6
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: collegare FilterLine™ oppure spegnere il monitoraggio etCO2 oppure premere il pulsante "Continua senza il sensore etCO2".	

Messaggio di allarme: Sostituire la linea filtro etCO2	
Condizione di allarme: occlusione della linea di ingresso del gas	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 7
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: sostituire la linea del filtro™	

Messaggio di allarme: Guasto modulo etCO2 - 4	
Condizione di allarme: Temperatura fuori range	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 8
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: sostituire il modulo sensore oppure rimuovere il modulo SpO2 e FilterLine™ e spegnere il monitoraggio etCO2 oppure premere il pulsante "Continua senza sensore etCO2".	

Messaggio di allarme: Guasto modulo etCO2 - 5

Condizione di allarme: controllare il flusso	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 9
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: sostituire il modulo sensore oppure rimuovere il modulo SpO2 e FilterLine™ e spegnere il monitoraggio etCO2 oppure premere il pulsante "Continua senza sensore etCO2".	

Messaggio di allarme: valore CO2 fuori intervallo

Condizione di allarme: valore CO2 fuori intervallo	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 10
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: sostituire il modulo del sensore o rimuovere il modulo etCO2 e FilterLine™ e spegnere il monitoraggio etCO2.	

Messaggio di allarme: Valore CO2 non valido

Condizione di allarme: valore CO2 non valido	Tipo di allarme: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 11
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: sostituire il modulo del sensore o rimuovere il modulo etCO2 e FilterLine™ e spegnere il monitoraggio etCO2.	

30.5 Monitoraggio EtCO₂ (allarmi paziente)

Messaggio di allarme: Nessun respiro etCO₂	
Condizione di allarme: nessun respiro	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 1
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: alta
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: Controllare il paziente, Controllare la linea del filtro™. Controllare i parametri di ventilazione.	

Messaggio di allarme: etCO₂ alto	
Condizione di allarme: allarme etCO₂ alto	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 2
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: Il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e lampeggia il valore etCO ₂ nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: Controllare il paziente, Controllare i parametri di ventilazione.	

Messaggio di allarme: etCO₂ basso	
Condizione di allarme: allarme etCO₂ basso	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 3
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: Il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e lampeggia il valore etCO ₂ nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: Controllare il paziente, Controllare i parametri di ventilazione.	

Messaggio di allarme: CO₂ alto	
Condizione di allarme: allarme CO₂ alto	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 4
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: Il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e lampeggia il valore etCO ₂ nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: Controllare il paziente, Controllare i parametri di ventilazione.	

Messaggio di allarme: CO2 basso	
Condizione di allarme: allarme CO2 basso	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 5
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: Il ventilatore mostra questo messaggio di allarme e lampeggia il valore etCO2 nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: Controllare il paziente, Controllare i parametri di ventilazione.	

Messaggio di allarme: etCO2 Spont alto	
Condizione di allarme: allarme etCO2 Spont alto	Tipo di allarme: paziente
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di allarme: 6
Tipo di allarme: visivo e acustico	Priorità allarme: media
Blocco: no	Allarme silenziabile: sì
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio di allarme.	
Azione dell'utente: Controllare il paziente, Controllare i parametri di ventilazione.	

31. Messaggi di stato del sensore

31.1 Messaggi di stato SpO₂

Messaggio di stato: Troppa luce ambiente (SpO₂)	
Condizione: troppa luce ambiente	Tipo di messaggio: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di messaggio: 1
Tipo di messaggio: visivo	Priorità del messaggio: bassa
Blocco: no	Messaggio silenziabile: N/A
Azione del ventilatore: il ventilatore mostrerà questo messaggio.	
Azione dell'utente: controllare il sensore e ridurre la luce ambiente	

Messaggio di stato: Indice perfusione basso (SpO₂)	
Condizione: Indice perfusione basso	Tipo di messaggio: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di messaggio: 2
Tipo di messaggio: visivo	Priorità del messaggio: bassa
Blocco: no	Messaggio silenziabile: N/A
Azione del ventilatore: Il ventilatore mostra questo messaggio e lampeggia il valore PI nel display della forma d'onda.	
Azione dell'utente: Controllare il sensore, Controllare il paziente, Controllare i parametri di ventilazione.	

Messaggio di stato: Ricerca pulsazioni	
Condizione: Ricerca pulsazioni	Tipo di messaggio: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di messaggio: 3
Tipo di messaggio: visivo	Priorità del messaggio: bassa
Blocco: no	Messaggio silenziabile: N/A
Azione del ventilatore: Il ventilatore mostra questo messaggio e lampeggia il valore SpO ₂ nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: Controllare il sensore, Controllare il paziente, Controllare i parametri di ventilazione.	

Messaggio di stato: Segnale IQ SpO₂ basso	
Condizione: Segnale IQ basso per più di 30 secondi	Tipo di messaggio: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di messaggio: 4
Tipo di allarme: visivo	Priorità del messaggio: bassa
Blocco: no	Messaggio silenziabile: N/A
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: controllare il sensore	

31.2 Messaggi di stato EtCO₂

Messaggio di stato: inizializzazione etCO2	
Condizione: avvio	Tipo di messaggio: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di messaggio: 1
Tipo di messaggio: visivo	Priorità del messaggio: bassa
Blocco: no	Messaggio silenziabile: N/A
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: Consentire l'avvio del modulo sensore.	

Messaggio di stato: Spurgo etCO2	
Condizione: spurgo attivo	Tipo di messaggio: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di messaggio: 2
Tipo di messaggio: visivo	Priorità del messaggio: bassa
Blocco: no	Messaggio silenziabile: N/A
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: consentire il completamento del ciclo di spurgo.	

Messaggio di stato: Modalità automanutenzione etCO2	
Condizione: modalità automanutenzione	Tipo di messaggio: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di messaggio: 3
Tipo di messaggio: visivo	Priorità del messaggio: bassa
Blocco: no	Messaggio silenziabile: N/A
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: consentire il completamento della modalità automanutenzione.	

Messaggio di stato: Pompa etCO2 OFF	
Condizione: Pompa off	Tipo di messaggio: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di messaggio: 4
Tipo di messaggio: visivo e acustico	Priorità del messaggio: bassa
Blocco: no	Messaggio silenziabile: N/A
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: accendere la pompa se necessario.	

Messaggio di stato: Eseguire calibrazione etCO2	
Condizione: eseguire calibrazione	Tipo di messaggio: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di messaggio: 5
Tipo di messaggio: visivo	Priorità del messaggio: bassa
Blocco: no	Messaggio silenziabile: N/A
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: nessuna	

Messaggio di stato: Eseguire manutenzione etCO2	
Condizione: eseguire manutenzione	Tipo di messaggio: tecnico
Attivo in tutte le modalità: sì quando il sensore è connesso	Classificazione di messaggio: 6
Tipo di messaggio: visivo	Priorità del messaggio: bassa
Blocco: no	Messaggio silenziabile: N/A
Azione del ventilatore: il ventilatore mostra questo messaggio di e mostra i trattini nel display del parametro monitorato.	
Azione dell'utente: nessuna	

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

32. Pulizia e disinfezione

Le istruzioni per la pulizia e la disinfezione sono per le superficie esterne di SLE6000 e i componenti rimovibili di SLE6000 che devono essere puliti e disinfettati dopo l'uso per ogni paziente.

Nota: tutti gli altri accessori non elencati in questa sezione, possono essere puliti in conformità con le linee guida del singolo ospedale.

Nota: per il modulo etCO₂ MicroPod™ e il cavo uSpO₂ (Masimo SET®) fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il rispettivo dispositivo.

I componenti che sono nel percorso del gas e che possono contaminarsi sono:

Blocco di esalazione
 Silenziatore
 Porte del getto di gas
 Valvola di occlusione


La superficie esterna del ventilatore include la superficie posteriore del ventilatore, lo schermo, la piastra di metallo sul fondo del ventilatore, il coperchio in metallo e la struttura.

I componenti rimovibili sono: il blocco di esalazione e il silenziatore.


32.1 Istruzioni

Prima di pulire o disinfettare la superficie esterna del ventilatore, eseguire le operazioni seguenti.


- 1 Disconnettere il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione elettrica di rete.
- 2 Rimuovere il circuito paziente e i filtri batterici. Smaltire gli articoli monouso in conformità alle linee guida dell'ente ospedaliero competente. Trattare gli articoli riutilizzabili in conformità alle linee guida dell'ente ospedaliero competente e alle istruzioni dei rispettivi fabbricanti.
- 3 Disconnettere le alimentazioni gas dalle prese a muro.
- 4 Disconnettere i tubi dell'aria e dell'ossigeno dal ventilatore e tappare le porte di ingresso.
- 5 Aprire il lembo laterale.

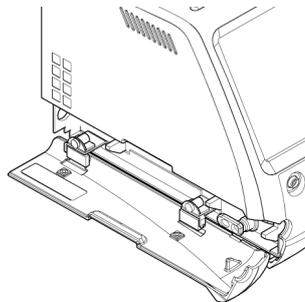


- 6 Sbloccare il blocco di esalazione ruotando il morsetto di 90 gradi finché non è orizzontale.

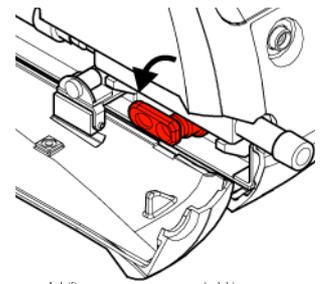

- 7 Estrarre delicatamente il blocco di esalazione e il silenziatore dalle porte gas.

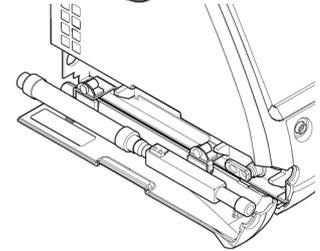

- 8 Separare il silenziatore e il blocco di esalazione.

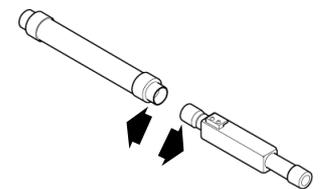

32.2 Istruzioni di pulizia della superficie esterna

- 1 Procurarsi tre panni puliti, monouso, assorbenti e che non rilasciano pelucchi.
- 2 Preparare una soluzione detergente multiuso/acqua calda in un contenitore pulito.
- 3 Pulire la superficie esterna del ventilatore utilizzando la soluzione detergente multiuso/acqua calda con il primo panno.
- 4 Se il detergente è stato utilizzato per la fase 3, rimuovere il detergente dalla superficie esterna del ventilatore utilizzando il secondo panno solo con acqua.
- 5 Pulire la superficie esterna del ventilatore con il terzo panno.

32.3 Istruzioni per la disinfezione della superficie esterna

- 1 Procurarsi due panni puliti, monouso, assorbenti e che non rilasciano pelucchi.
- 2 Versare l'alcool (70% isopropanolo) in un contenitore.
- 3 Inumidire uno dei panni con alcool (70% isopropanolo).
- 4 Pulire la superficie esterna del ventilatore con un panno bagnato d'alcool.
- 5 Pulire la superficie esterna del ventilatore con il secondo panno.

OPPURE

- 6 Pulire la superficie esterna del ventilatore con alcool (70% isopropanolo).
- 7 Lasciare asciugare.

32.4 Istruzioni di pulizia del blocco di esalazione

Note: per l'uso di sistemi di lavaggio automatici seguire le linee guida ospedaliere.

- 1 Preparare una soluzione detergente multiuso/acqua calda in un contenitore pulito.
- 2 Lavare il blocco di esalazione nella soluzione detergente multiuso/acqua calda.
- 3 Sciacquare con acqua sterile.
- 4 Lasciare asciugare.
- 5 Verificare che la sfera della valvola di scarico della pressione si muova quando il blocco di esalazione viene mosso. In caso contrario, lavarlo nuovamente e assicurarsi di eliminare i residui che potrebbero essere attaccati alle sfere in posizione.

32.5 Istruzioni di disinfezione del blocco di esalazione

- 1 Versare l'alcool (70% isopropanolo) in un contenitore, abbastanza pieno da immergere il blocco di esalazione all'interno.
- 2 Immergere il blocco di esalazione nell'alcool (70% isopropanolo) per 30 secondi.
- 3 Lasciare asciugare per un'ora.
- 4 Sterilizzare in autoclave con vapore saturo secco puro a 134°C a 320 kPa con un tempo di attesa minimo di 3 minuti o 121°C a 210 kPa con un tempo di attesa minimo di 15 minuti.


32.6 Istruzioni di disinfezione del silenziatore autoclavabile

- 1 Sterilizzare in autoclave con vapore saturo secco puro a 134°C a 320 kPa con un tempo di attesa minimo di 3 minuti o 121°C a 210 kPa con un tempo di attesa minimo di 15 minuti.

Nota: il silenziatore può essere sterilizzato in autoclave fino a 25 volte. Indicare sul silenziatore con un evidenziatore autoclavabile il numero di cicli di sterilizzazione completati.


32.7 Disinfezione delle porte del getto di gas

- 1 Procurarsi due panni puliti, monouso, assorbenti e che non rilasciano pelucchi.
- 2 Versare l'alcool (70% isopropanolo) in un contenitore.
- 3 Inumidire uno dei panni con alcool (70% isopropanolo).
- 4 Strofinare le due porte del getto di gas con un panno bagnato in alcool.
- 5 Asciugare utilizzando il secondo panno.

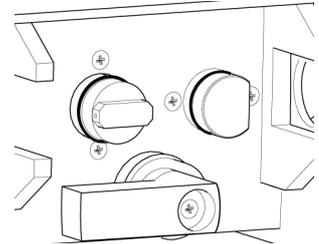


32.8 Valvola di occlusione

Se la valvola di occlusione che è montata internamente risulta contaminata, potrà essere pulita esclusivamente da un tecnico dell'assistenza dal momento che è necessario lo smontaggio del ventilatore.

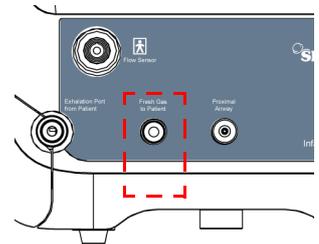

32.9 Pulizia del filtro di ingresso dell'aria principale.

- 1 Rimuovere la protezione del filtro della ventola (1). Non sono richiesti strumenti.

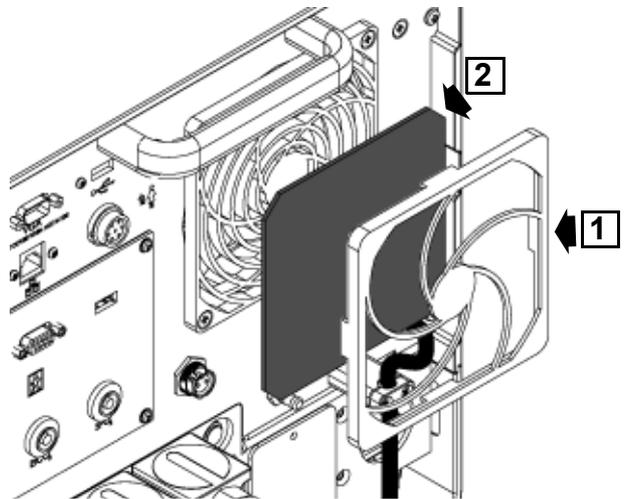

- 2 Rimuovere il filtro (2).
- 3 Lavare il filtro (2) con acqua pulita

Avvertenza. Non torcere o deformare il filtro perché questo potrebbe causare allentamenti di forma.

- 4 Asciugare il filtro (2) con le tovaglette di carta fino a rimuovere tutta l'umidità.
- 5 Sostituire il filtro (2) e la protezione del filtro (1).

33. Compliance elettromagnetica

Nota: le caratteristiche delle emissioni di questa apparecchiatura la rendono idonea per l'uso nelle aree industriali e gli ospedali (CISPR 11 classe A). Se utilizzata in un ambiente residenziale (per il quale CISPR 11 classe B è normalmente richiesto) questa apparecchiatura potrebbe non offrire una adeguata protezione ai servizi di comunicazione di radiofrequenza. L'utente potrebbe aver bisogno di prendere misure di riduzione del rischio, come il riposizionamento o riorientamento dell'apparecchiatura.

L'SLE6000 è stato testato in conformità alla norma IEC 60601-1-2:2015 in merito ai disturbi elettromagnetici senza deviazioni.

Sulla base dell'ambiente dichiarato, il ventilatore è stato classificato come Gruppo 1, Classe A.

33.1 Livelli di compliance sul test delle emissioni

CISPR16-2-1:2008 +A1:2010 +A2:2013

Tensioni di disturbo del terminale di alimentazione

- 240 Vac a 50Hz
- 110 Vac a 60Hz
- 100 Vac a 60Hz

CISPR16-2-3 :2010 +A1:2010

Disturbi delle radiazioni elettromagnetiche - campo elettrico

- Da 30 MHz a 1 GHz - Verticale - 240Vac 50Hz
- Da 30 MHz a 1 GHz - Orizzontale - 240Vac 50Hz
- Da 30 MHz a 1 GHz - Verticale - 110Vac 60Hz
- Da 30 MHz a 1 GHz - Orizzontale - 110Vac 60Hz
- Da 30 MHz a 1 GHz - Verticale - 100Vac 60Hz
- Da 30 MHz a 1 GHz - Orizzontale - 100Vac 60Hz

CEI61000-3-2:2014

Emissioni di corrente armonica

- 230 Vac a 50Hz
- 110 Vac a 60Hz
- 100 Vac a 60Hz

CEI61000-3-3:2013

Fluttuazioni di tensione e flicker

- 230 Vac a 50Hz
- 110 Vac a 50Hz
- 100 Vac a 50Hz

33.2 Livelli di compliance sui test di immunità

CEI61000-4-2:2008

Scariche elettrostatiche

- Scarico d'aria a 8kV e 15 kV
- Scarico a contatto a 8kV
- Scarico indiretto 8kV

IEC61000-4-3:2006 +A1:2007 +A2:2010

Campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati

- 80 - 2700 MHz in tutti i piani

Campi di prossimità dalle apparecchiature di radiofrequenza

- TETRA 400 (380-390 MHz)
- GMRS 460 e FRS460 (430-470 MHz)
- Bande LTE 13 e 17 (704-787 MHz)
- GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Banda 5 (800-960 MHz)
- GSM1800, CDMA 1900, DECT, LTE Bande 1, 3, 4 & 15, UMTS (1700-1990 MHz)
- Bluetooth, WLAN 802.11b/g/n, RFID 2450, LTE Banda 7 (2400-2570 MHz)
- WLAN 802.11a/n (5100-5700 MHz)

CEI61000-4-4:2012

Transistori elettrici veloci (burst)

- Ingresso CA da 2 kV 240Vac 50Hz
- Ingresso CA da 2 kV 110Vac 60Hz
- Ingresso CA da 2 kV 100Vac 60Hz

CEI61000-4-5:2014

Sovraccarico

- Ingresso CA 240Vac 50Hz
- Ingresso CA 110Vac 60Hz
- Ingresso CA 100Vac 60Hz

CEI61000-4-6:2013

Disturbi di conduzione indotti dai campi a radiofrequenza

- 3 Vrms 240Vac 50Hz
- 3 Vrms 110Vac 60Hz

CEI61000-4-8:2009

Campi magnetici a frequenza di rete

- 30 A/m 240Vac 50Hz
- 30 A/m 110Vac 60Hz

CEI61000-4-11:2004

Cali di tensione e brevi interruzioni

- Ingresso CA 240Vac 50Hz
- Ingresso CA 110Vac 60Hz
- Ingresso CA 100Vac 60Hz

33.3 Avvertenze - EMC


1. L'uso di questa apparecchiatura adiacente o impilata in altre apparecchiature deve essere evitato perché potrebbe causare un funzionamento improprio. Se tale uso è necessario, osservare questa apparecchiatura e le altre per verificare che funzionino normalmente.
2. L'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore di questa apparecchiatura potrebbe produrre un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica di questa apparecchiatura e quindi un funzionamento improprio.
3. Le apparecchiature di comunicazione RF portatili (incluse le periferiche come cavi di antenna e antenne esterne) devono essere utilizzate a una distanza di non oltre 30 cm verso qualsiasi parte di SLE6000, inclusi i cavi specificati dal produttore. Diversamente, potrebbe verificarsi una riduzione delle prestazioni per queste apparecchiature.

33.4 Avvisi - EMC

1. Utilizzare solo i cavi indicati nel capitolo '45. Parti consumabili e accessori' a pagina 280 per il collegamento agli accessori e ai trasduttori.




34. Schema dell'unità pneumatica

Di seguito viene raffigurata una rappresentazione schematica dell'unità pneumatica del ventilatore.

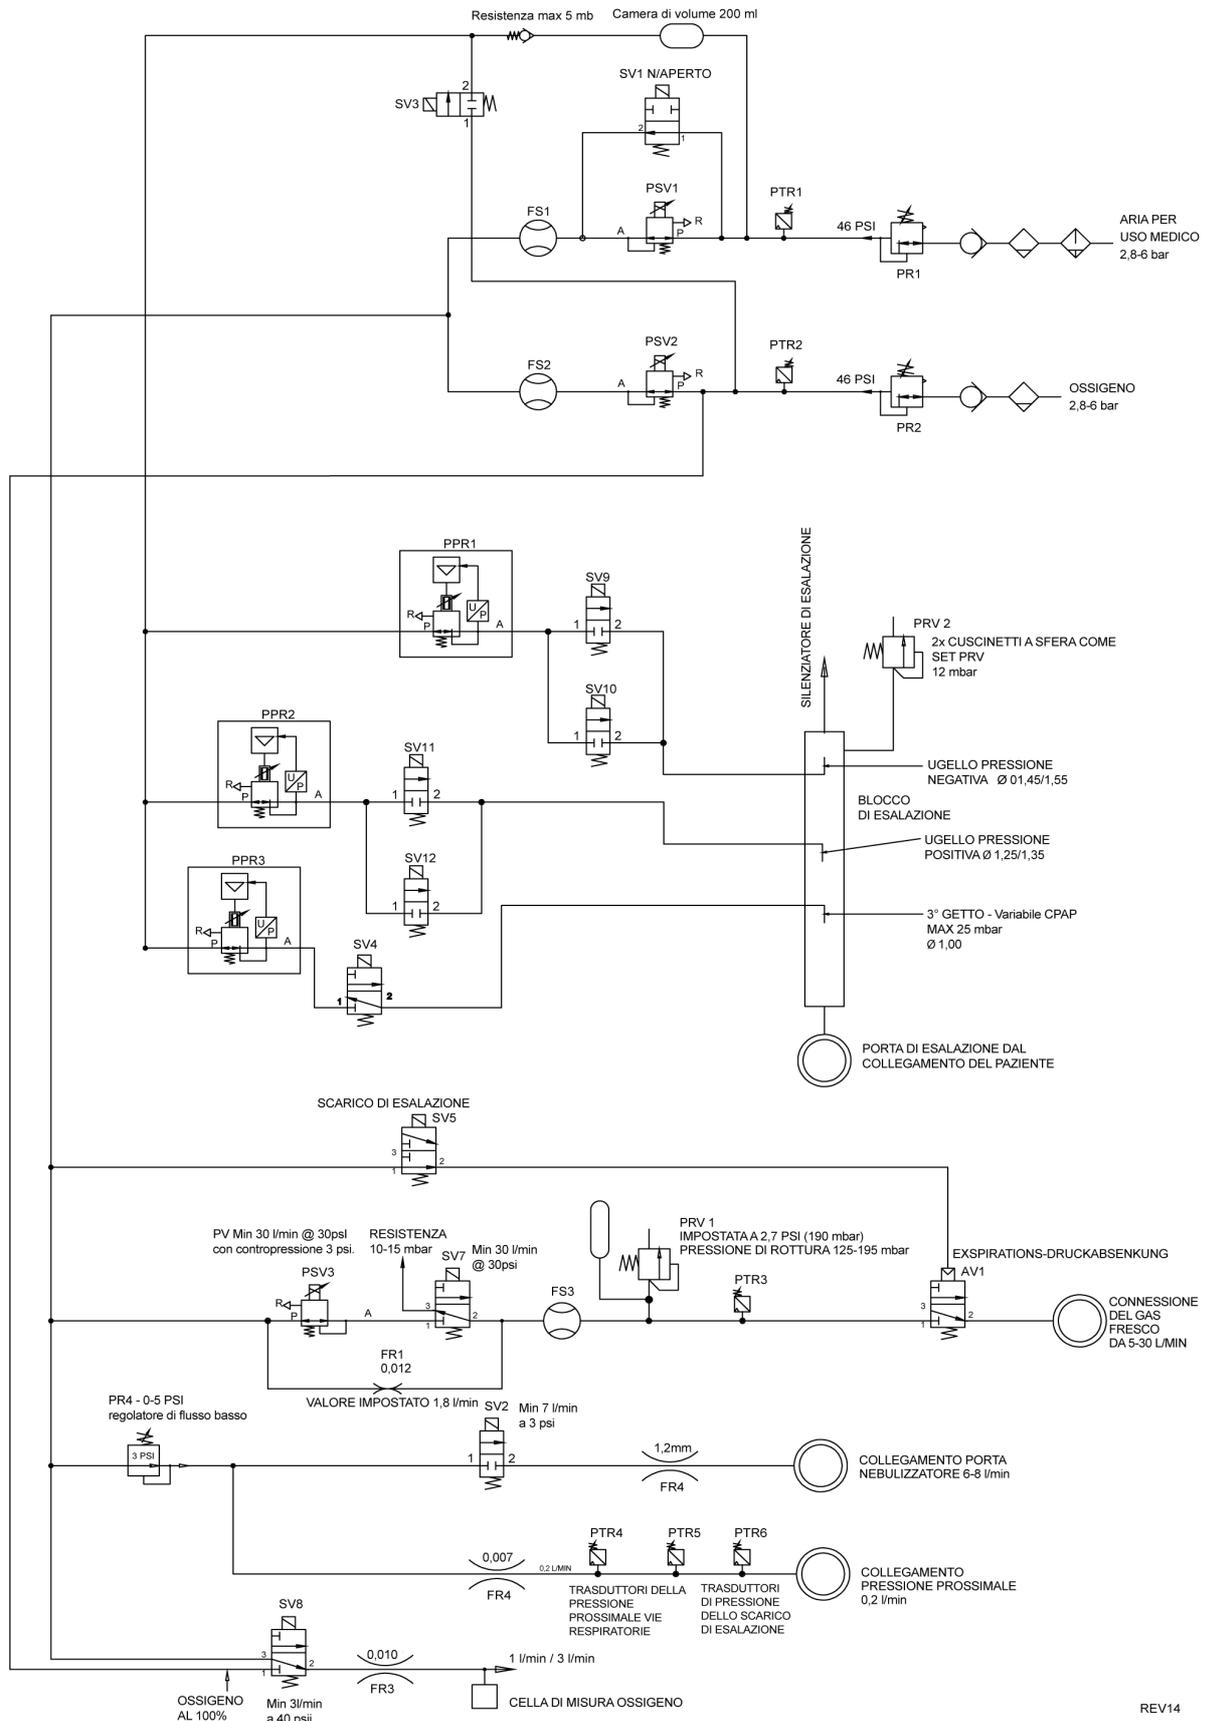

REV14

34.1 Diagrammi pneumatici circuito paziente

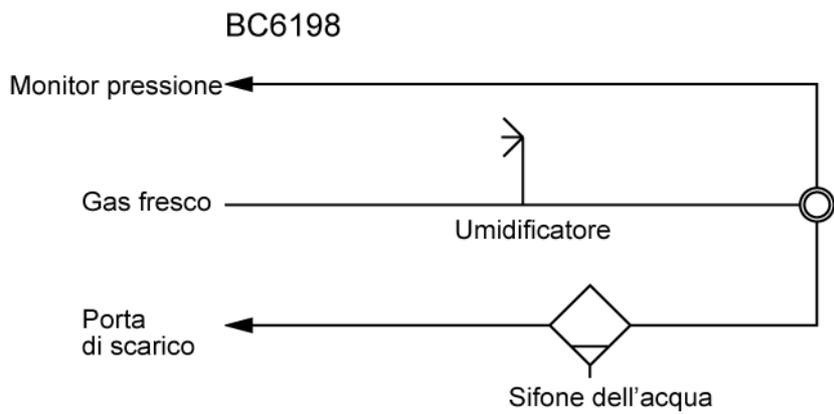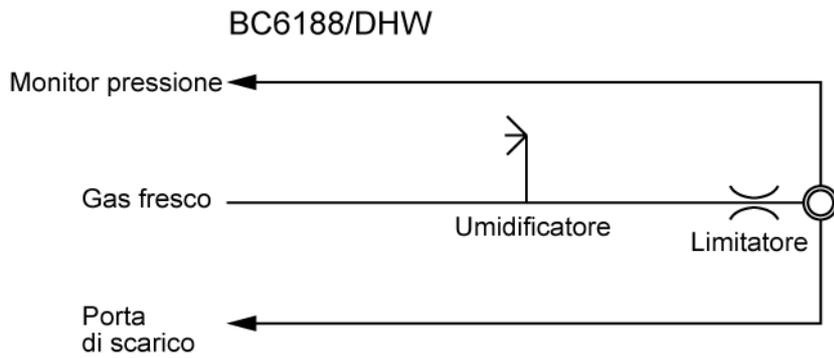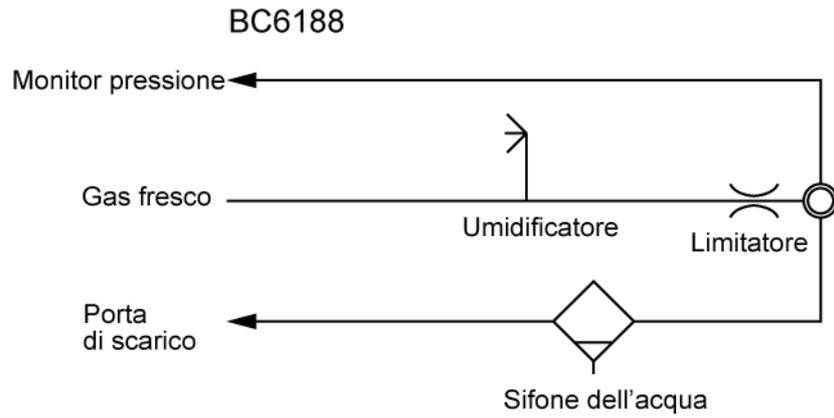

35. Identificazione della versione software

In basso il grafico che consente all'utente di identificare la versione software installata sul ventilatore.

Versione del sistema	V2.0.90	V2.0.92
Sottosistemi		
Software GUI	2.0.31	2.0.32
Preferenze operatore	2.0.10	2.0.13
UI BIOS	V3.23#4	V3.23#4
MMS software	2.0.4	2.0.4
MMS hardware	2 o C5	2 o C5
PCLC software	2.0.19	2.0.19
Controller software	217	217
Controller hardware	3	3
Monitor – SW isolato	112	112
Monitor – Non isolato	219	223
Monitor hardware	3	3
ESMO Software MO	2.0.11	2.0.12
ESMO Software ES	2.0.6	2.0.6
ESMO Hardware	3,4	3,4
PSU Software	1.0.3	1.0.3
PSU Hardware	4,1	4,1
Allarme, software monitor	1.4.0	1.4.0
Allarme, software UI	1.4.0	1.4.0
Lingue	2.0.25	2.0.25
Versione del sistema operativo	2.0.1	2.0.2
Aggiornamento di sistema	2.0.8	2.1.2
Utilità tecnica	2.0.14	2.0.16

Avviso. Se l'utente scopre una mancata corrispondenza delle versioni del sottosistema, non utilizzare il ventilatore e rivolgersi a un tecnico qualificato.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

Risoluzione dei problemi



36. Tabella di individuazione e soluzione dei problemi

36.1 Problemi correlati alla ventilazione

Avvertenza: in tutte le condizioni di allarme, controllare innanzi tutto il paziente.

Sintomo	Possibile causa	Rimedio
Messaggio di allarme: Blocco gas. Verifica circuito paziente.	Tubo di alimentazione gas fresco bloccato o attorcigliato.	Controllare la linea di alimentazione gas e il resto del circuito paziente. Circuito da 10mm montato, ma modalità invasiva del ventilatore impostata a 15mm dal circuito paziente.
Messaggio di allarme: Perdita gas. Verifica circuito paziente.	Perdita di gas nel circuito paziente.	Controllare la linea di alimentazione gas e il resto del circuito paziente, nonché il sifone dell'acqua. Circuito da 15 mm montato, ma modalità invasiva del ventilatore impostata a 10 mm dal circuito paziente.
Messaggio di allarme: Continuing positive pressure (Prolungata pressione positiva)	Compressione della linea prossimale vie respiratorie.	Rimuovere la compressione.
Messaggio di allarme: soglia di alta pressione superata.	La forma d'onda ha superato la soglia allarme di massima pressione.	Controllare le pressioni del ventilatore. Controllare il circuito paziente.
Messaggio di allarme: Cycle Fail (Errore di ciclo)	La forma d'onda ha superato la soglia allarme di errore di ciclo.	Controllare le pressioni del ventilatore. Controllare il circuito paziente e il sifone dell'acqua.
Messaggio di allarme: Low Pressure (Pressione bassa)	La forma d'onda ha superato la soglia di allarme pressione bassa.	Controllare le pressioni del ventilatore. Controllare il circuito paziente e il sifone dell'acqua. Regolare la soglia di allarme.
Messaggio di allarme: Aumento inatteso della pressione media.	La pressione media è aumentata di oltre 5 mbar.	Controllare le pressioni del ventilatore. Controllare il circuito paziente. Premere Autoset per le nuove soglie di allarme.
Messaggio di allarme: Caduta inattesa della pressione media.	La pressione media è diminuita di oltre 5 mbar.	Controllare le pressioni del ventilatore. Controllare il circuito paziente e il sifone dell'acqua. Premere Autoset per le nuove soglie di allarme.
Messaggio di allarme: Aumento inatteso del delta P.	La pressione massima è aumentata di oltre 5 mbar.	Controllare le pressioni del ventilatore. Controllare il circuito paziente. Premere Autoset per le nuove soglie di allarme.

Sintomo	Possibile causa	Rimedio
Messaggio di allarme: Diminuzione inattesa del Delta P.	La pressione massima è diminuita di oltre 5 mbar.	Controllare le pressioni del ventilatore. Controllare il circuito paziente e il sifone dell'acqua. Premere Autoset per le nuove soglie di allarme.
Messaggio di allarme: Sensore di flusso contaminato.	Il sensore di flusso è incrostatato di secrezioni.	Rimuovere il sensore dal circuito paziente. Montare un nuovo sensore di flusso e calibrarlo. Reinserire il sensore nel circuito paziente. Se non sono disponibili sensori di ricambio, premere Continua senza misura flusso e impostare il trigger di sensibilità respiro.
Messaggio di allarme: volume minuto alto	L'andamento del volume minuto ha superato la soglia di allarme alto volume minuto.	Controllare le pressioni del ventilatore. Controllare il circuito paziente. Impostare la nuova soglia di allarme.
Messaggio di allarme: volume minuto basso	L'andamento del volume minuto ha superato la soglia di allarme Volume minuto basso.	Controllare le pressioni del ventilatore. Controllare il circuito paziente. Impostare la nuova soglia di allarme.
Messaggio di allarme: High Patient Leak (Perdita gas elevata al paziente)	La percentuale calcolata di perdita al paziente ha superato la soglia di allarme.	Controllare il circuito paziente. Impostare la nuova soglia di allarme.
Messaggio di allarme: Low Tidal Volume (Volume corrente basso)	L'andamento della forma d'onda del volume corrente ha superato la soglia di allarme volume corrente basso.	Controllare il paziente. Controllare il circuito paziente e il sifone dell'acqua. Impostare la nuova soglia di allarme.
Messaggio di allarme: Apnea (Apnea)	Un respiro non è stato rilevato dal ventilatore.	Impostare la nuova soglia di rilevazione respiro o la sensibilità del trigger respiratorio. Controllare il circuito paziente.
Messaggio di allarme: Breath Not Detected (Respiro non rilevato)	Tubo endotracheale bloccato o disconnesso.	Verificare l'immissione dell'aria al paziente. Controllare il circuito paziente.
La modalità di anteprima si annulla.	La modalità di anteprima si annulla dopo 120 secondi se non si preme alcun pulsante.	Riselezionare la modalità di anteprima.

36.2 Problemi correlati al ventilatore

Avvertenza: in tutte le condizioni di allarme, controllare innanzi tutto il paziente.

Sintomo	Possibile causa	Rimedio
All'accensione, lo schermo del ventilatore rimane vuoto. La luce del pulsante Power è verde.	Errore del display.	Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
Schermo del ventilatore vuoto con generazione del segnale di allarme. Il ventilatore continua a ventilare.	Errore del display.	Spostare il paziente su una forma alternativa di ventilazione, quindi porre fuori uso il ventilatore. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
Schermo del ventilatore vuoto. Il pulsante Power è Off . Generazione di un segnale di allarme continuo.	Mancanza completa di alimentazione elettrica.	Spostare il paziente su una forma alternativa di ventilazione, quindi porre fuori uso il ventilatore.
I pulsanti del touchscreen non funzionano come previsto.	Il touchscreen viene toccato in due punti. Touchscreen non allineato.	Toccare il touchscreen soltanto in un punto. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
I pulsanti del touchscreen non funzionano.	Problema del touchscreen.	Spostare il paziente su una forma alternativa di ventilazione, quindi porre fuori uso il ventilatore. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
Allarme di mancanza completa di alimentazione elettrica attivo (soltanto acustico) dopo lo spegnimento del ventilatore	Pulsante Power non premuto nuovamente allo spegnimento.	Premere nuovamente il pulsante per annullare l'allarme.
Messaggio di allarme: mancanza gas.	Alimentazioni aria e ossigeno non connesse al ventilatore. Mancanza alimentazione aria e ossigeno.	Controllare le alimentazioni/connessioni di aria e ossigeno. Se generato quando collegato a un paziente, spostare il paziente su una forma alternativa di ventilazione.
Allarme perdita di gas con CPAP/PEEP/Media a zero e PIP/Delta P a zero. Messaggio di allarme: Perdita gas fresco. Verifica circuito paziente.	Mancanza alimentazione aria e ossigeno.	Se generato quando collegato a un paziente, spostare il paziente su una forma alternativa di ventilazione. Controllare le alimentazioni/connessioni di aria e ossigeno.

Sintomo	Possibile causa	Rimedio
Allarme di pressione bassa con CPAP/PEEP/ Media a zero e PIP/Delta P a zero. Messaggio di allarme: Low Pressure (Pressione bassa)	Mancanza alimentazione aria e ossigeno.	Se generato quando collegato a un paziente, spostare il paziente su una forma alternativa di ventilazione. Controllare le alimentazioni/conessioni di aria e ossigeno.
Messaggio di allarme: No O2 Supply (Mancanza ossigeno)	Alimentazione ossigeno non connessa al ventilatore. Mancanza alimentazione ossigeno.	Controllare l'alimentazione/le connessioni dell'ossigeno. Se generato quando collegato a un paziente, spostare il paziente su una forma alternativa di ventilazione.
Allarme mancanza aria. Messaggio di allarme: No Air Supply (Mancanza aria)	Alimentazione aria non connessa al ventilatore. Mancanza alimentazione aria.	Controllare l'alimentazione/le connessioni dell'aria. Se generato quando collegato a un paziente, spostare il paziente su una forma alternativa di ventilazione.
Allarme errore batteria. Messaggio di allarme: Battery Fault (Errore batteria)	La batteria interna si è guastata oppure si è sviluppato un guasto nell'alimentazione elettrica.	Porre fuori uso il ventilatore. Prendere nota del messaggio di allarme e rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
Allarme batteria scarica. Messaggio di allarme: Battery Low (Batteria scarica) (Media priorità)	La batteria ha raggiunto il livello di carica al 25%.	Ripristinare l'alimentazione elettrica di rete. Se non è possibile ripristinare l'alimentazione elettrica di rete, spostare il paziente su una forma alternativa di ventilazione. Prendere nota del messaggio di allarme e rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
Allarme batteria scarica. Messaggio di allarme: Battery Low (Batteria scarica) (Alta priorità)	La batteria ha raggiunto il funzionamento di 10 minuti.	Ripristinare l'alimentazione elettrica di rete. Se non è possibile ripristinare l'alimentazione elettrica di rete, spostare il paziente su una forma alternativa di ventilazione. Prendere nota del messaggio di allarme e rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
Allarme deriva di sensore pressione. Messaggio di allarme: Guasto del sensore di pressione. Porre fuori uso il ventilatore.	Un trasduttore di sensore di pressione non ha superato un controllo di sistema interno.	Porre fuori uso il ventilatore. Se generato quando collegato a un paziente, spostare il paziente su una forma alternativa di ventilazione Prendere nota del messaggio di allarme e rivolgersi a personale di assistenza qualificato.

Sintomo	Possibile causa	Rimedio
Messaggio di allarme: sensore di flusso difettoso.	Si è rotto un filo riscaldato del sensore di flusso.	<p>Rimuovere il sensore dal circuito paziente. Eliminare il sensore di flusso. Montare un nuovo sensore di flusso e ricalibrare.</p> <p>Reinserire il sensore nel circuito paziente.</p> <p>Se non sono disponibili sensori di ricambio, premere Continua senza misura flusso e impostare il trigger di sensibilità respiro.</p> <p>Se il messaggio persiste, spostare il paziente su una forma alternativa di ventilazione, quindi porre fuori uso il ventilatore.</p> <p>Prendere nota del messaggio di allarme e rivolgersi a personale di assistenza qualificato.</p>
Messaggio di allarme: connettere il sensore di flusso.	<p>Cavo del sensore di flusso non connesso al ventilatore.</p> <p>Se il sensore è connesso, sono rotti entrambi i fili riscaldati.</p>	<p>Connettere il cavo del sensore di flusso e ricalibrare il sensore di flusso. Reinserire il sensore nel circuito paziente. In caso di utilizzo senza sensore, premere Continua senza misura flusso e impostare il trigger di sensibilità respiro.</p> <p>Rimuovere il sensore dal circuito paziente. Eliminare il sensore di flusso. Montare un nuovo sensore di flusso e ricalibrare.</p> <p>Reinserire il sensore nel circuito paziente. Se non sono disponibili sensori di ricambio, premere Continua senza misura flusso e impostare il trigger di sensibilità respiro.</p>
Messaggio di allarme: Calibrate Flow Sensor (Calibrare il sensore di flusso)	Nuovo sensore connesso al ventilatore.	Eseguire la routine di calibrazione. Montare il sensore nel circuito paziente.
Messaggio di allarme: L'interfaccia Utente si è resettato. Controllare impostazioni ventilatore	Reset dell'hardware interno.	<p>Porre fuori uso il ventilatore.</p> <p>Se generato quando collegato a un paziente, spostare il paziente su una forma alternativa di ventilazione</p> <p>Prendere nota del messaggio di allarme e rivolgersi a personale di assistenza qualificato.</p>
Messaggio di allarme: Sensor O2 disconnesso. Riconnettere	La cella del sensore di misura ossigeno si è disconnessa.	<p>Spostare il paziente su una forma alternativa di ventilazione, quindi porre fuori uso il ventilatore.</p> <p>Prendere nota del messaggio di allarme e rivolgersi a personale di assistenza qualificato.</p>

Sintomo	Possibile causa	Rimedio
Allarme Calibrare la cella di misura ossigeno. Messaggio di allarme: la cella di ossigeno necessita di calibrazione.	Il sensore di ossigeno ha registrato una concentrazione di ossigeno >100%.	Ricalibrare il sensore O2. Se il sensore è difettoso, verrà generato un nuovo allarme cella di misura ossigeno. Se appare questo messaggio, spostare il paziente su una forma alternativa di ventilazione, quindi porre fuori uso il ventilatore. Prendere nota del messaggio di allarme e rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
Errore di calibrazione ossigeno. Messaggio di allarme: Errore nella calibrazione O2	Durante la calibrazione del sensore dell'ossigeno, il ventilatore non è riuscito a raggiungere una lettura di ossigeno del 100%.	Spostare il paziente su una forma alternativa di ventilazione, quindi porre fuori uso il ventilatore. Prendere nota del messaggio di allarme e rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
Allarme errore di comunicazione monitor/ display. Messaggio di allarme: Guasto comunicazione interna. Porre fuori uso il ventilatore.	Si è sviluppato un guasto software/ hardware all'interno del ventilatore.	Spostare il paziente su una forma alternativa di ventilazione, quindi porre fuori uso il ventilatore. Prendere nota del messaggio di allarme e rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
Allarme pressione massima o minima con interruzione del gas. Picco di pressione uguale o superiore a 20 mbar seguito da mancanza di gas. Messaggio di allarme: Soglia di allarme alta pressione o bassa pressione superata.	Si è sviluppato un guasto hardware all'interno dell'unità pneumatica del ventilatore.	a) Controllare che le soglie di allarme siano impostate correttamente. b) Premere il pulsante Reset per riavviare la ventilazione. Se viene generato un picco di pressione, il ventilatore taglia di nuovo tutti i gas. c) Spostare immediatamente il paziente su una forma alternativa di ventilazione. d) Porre il ventilatore fuori uso e rivolgersi a personale di assistenza qualificato.

36.3 Problemi correlati al sensore

Avvertenza: in tutte le condizioni di allarme, controllare innanzi tutto il paziente.

Sensore etCO2

Sintomo	Possibile causa	Rimedio
Messaggio di allarme: sostituire la linea filtro etCO2	Linea filtro bloccata	Scollegare e quindi ricollegare la linea filtro™. Se il messaggio continua ad essere visualizzato, scollegare e sostituire la linea filtro™. Una volta che la linea filtro™ funzionante è collegata al modulo, la pompa riprenderà automaticamente il funzionamento.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

PPM e verifiche funzionali



37. Manutenzione preventiva programmata (PPM)

Avvertenza. La manutenzione preventiva programmata di questo ventilatore deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico ospedaliero addestrato da SLE o da un tecnico dell'assistenza SLE.

37.1 Pianificazione PPM

Anno	Usare la PPM Kit A	Usare la PPM kit B*
1	A	
2	A	
3	A	
4	A	
5	A	
6	A	B*
7	A	
8	A	
9	A	
10	A	

*Nota: il Kit B verrà utilizzato per 6 anni o 30.000 ore, a seconda di quale condizione si presenti prima. Il tempo in ore deve essere osservato dal contaore orario montato sul retro della struttura pneumatica.

Il contaore registra solo l'ora in cui il ventilatore è in funzione, ovvero acceso.

37.2 Kit PPM

Il ventilatore SLE6000 ha due kit PPM, A & B.

37.2.1 Kit A

Il kit contiene quanto segue.

Cella del sensore di misura ossigeno	Q.tà 1
Filtro conico	Q.tà 2
Valvola duckbill	Q.tà 2
Guarnizione Duckbill	Q.tà 2
"O" ring	Q.tà 2
"O" ring blocco orifizio	Q.tà 2
Filtri antiparticolato 5µm	Q.tà 2

37.2.2 Kit B

Kit valvola proporzionale (3 valvole) Q.tà 1

Gruppo valvola alta velocità Q.tà 1

Ogni kit PPM richiederà l'installazione dei pezzi in alto e la ricalibrazione.

37.3 Numeri pezzi kit

Kit A N9610/A

Kit B N9610/B

Nota: è disponibile un manuale di manutenzione per l'uso da parte di tecnici qualificati addestrati da SLE su questo prodotto.


Il manuale di manutenzione contiene l'elenco dei pezzi illustrati, diagrammi di circuito, diagrammi pneumatici e procedura di calibrazione per il ventilatore.

Contattare SLE o il distributore per ulteriori informazioni.

37.4 Sostituzione cavo di alimentazione elettrica di rete

Avvertenza. La sostituzione del cavo di alimentazione elettrica di rete deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico ospedaliero addestrato da SLE o da un tecnico dell'assistenza SLE.

Rimuovere le due viti (A) per rilasciare il morsetto (B).

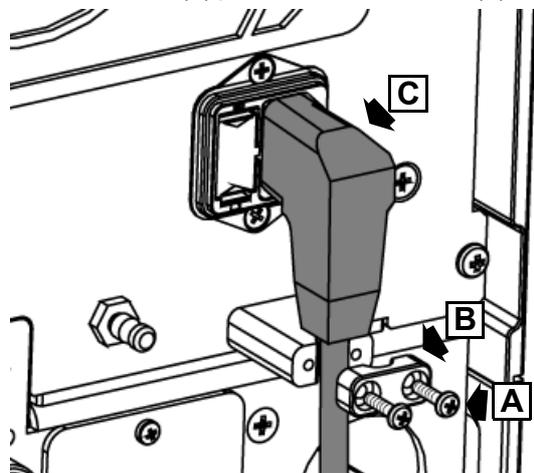

Rimuovere il cavo di alimentazione elettrica di rete (C).

Sostituire solo il cavo con uno dei seguenti cavi disponibili da SLE:

Cavo di alimentazione elettrica di rete lungo 3 M UK spina 3 pin. P/N°:M0255/095

Cavo di alimentazione elettrica di rete 3 M lungo spina Shuko. P/N°:M0255/096

Cavo di alimentazione elettrica di rete 3 M lungo spina NEMA. P/N°:M0255/097

37.5 MicroPod™ PPM

La calibrazione deve essere effettuata dopo le prime 1.200 ore d'uso e in seguito a questa una volta l'anno od ogni 4.000 ore di funzionamento, a seconda di quale condizione si verifica prima.

Dopo 30.000 ore di funzionamento, determinati componenti del modulo di capnografia richiedono assistenza. L'assistenza può essere effettuata esclusivamente da parte di un tecnico formato. Consultare SLE o il distributore per maggiori informazioni.

Il ventilatore mostrerà dalla scheda del sensore etCO₂ le seguenti informazioni:

Data dell'ultima calibrazione
Data della prossima calibrazione
Data della prossima manutenzione

Nota: è disponibile un manuale di manutenzione per l'uso da parte di tecnici qualificati addestrati da SLE su questo prodotto.

Ordinare SM38 numero 5 o superiore

Il manuale di assistenza contiene la procedura di calibrazione per MicroPod™.

La calibrazione di MicroPod™ richiede l'uso di un gas di calibrazione.

Contattare SLE o il rappresentante per ulteriori informazioni.

38. Verifica funzionale del ventilatore

Il test funzionale può essere effettuato se l'utente desidera verificare il funzionamento degli allarmi o le prestazioni base del ventilatore.

Il test funzionale viene suddiviso in due sezioni, test di allarme e test di prestazioni.

38.1 Test di allarme

La routine del test di allarme consente all'utente di testare le prestazioni essenziali dei seguenti allarmi:



Tipo di allarme	Messaggio di allarme
Alta concentrazione di ossigeno	Alto livello di ossigeno
Bassa concentrazione di ossigeno	Basso livello di ossigeno
Allarme PEEP	CPAP a alto/PEEP a alto
Allarme di ostruzione	Gas fresco bloccato
Allarme di occlusione parziale	Prolungata pressione positiva
Allarme volume scaduto	Volume corrente oltre la soglia alta
Allarme volume basso	Volume minuto sotto la soglia bassa
Allarme mancanza di alimentazione elettrica	Mancanza di alimentazione elettrica
Allarme perdita di alimentazione del gas	Mancanza aria Mancanza ossigeno
Allarme alta pressione	Soglia alta pressione superata

- 1 Utilizzare la configurazione standard del ventilatore come descritto in "Configurazione base del ventilatore" a pagina 42.
- 2 Collegare un circuito paziente completo e un polmone di prova.

Avvertenza: il circuito paziente utilizzato per il test funzionale non deve essere utilizzato per la ventilazione del paziente.

- 3 Selezionare ed entrare nella modalità CMV.
- 4 Assicurarsi che il sistema dell'ossigeno abbia completato la calibrazione.

38.1.1 Alta concentrazione di ossigeno/Bassa concentrazione di ossigeno/Test di allarme perdita di alimentazione del gas

- 1 Impostare il controllo O₂ al 21%.
- 2 Scollegare l'alimentazione d'aria. (Il ventilatore adesso passerà al 100% ossigeno).
- 3 L'allarme perdita di alimentazione d'aria eseguirà

il trigger (Messaggio "Mancanza aria").

- 4 Consentire che il valore misurato O2 raggiunga il 100%.
- 5 Ricollegare l'alimentazione d'aria.
- 6 Sarà triggerato l'allarme Alta concentrazione di ossigeno (Messaggio "Alto livello di ossigeno").
- 7 Impostare il controllo O2 al 25%.
- 8 Scollegare l'alimentazione d'ossigeno. (Il ventilatore adesso passerà al 100% aria).
- 9 L'allarme perdita di alimentazione d'ossigeno sarà triggerato (Messaggio "Mancanza d'ossigeno").
- 10 Scollegare l'alimentazione d'aria
- 11 L'allarme perdita di alimentazione gas sarà triggerato (Messaggio "Mancanza gas").
- 12 Ricollegare entrambi i gas.

38.1.2 Allarme di ostruzione - Gas fresco bloccato

- 1 Se ancora in modalità CMV, rimuovere la linea di alimentazione inspiratoria e ostruire la porta "Gas fresco al paziente".
- 2 Premere il pulsante reset fino a quando non viene visualizzato l'allarme "Gas fresco bloccato".
- 3 Ricollegare la linea di alimentazione inspiratoria e ripristinare tutti i messaggi di allarme.

38.1.3 Allarme di occlusione parziale - Prolungata pressione positiva

- 1 Cambiare modalità in CPAP
- 2 Restringere delicatamente il tubo della sezione di esalazione per incrementare la pressione misurata proprio sotto la soglia di allarme PIP alta. Assicurarsi che la forma d'onda della pressione non attraversi la soglia di allarme PIP alta.
- 3 L'allarme di occlusione parziale adesso verrà triggerato (Messaggio "Prolungata pressione positiva") e i gas saranno tagliati.

Nota: l'allarme CPAP a alto sarà triggerato per primo, ma poi verrà ignorato dall'allarme Prolungata pressione positiva

- 4 Rilasciare il blocco dal tubo della sezione di esalazione.

38.1.4 Allarme alta pressione - Soglia alta pressione superata

- 1 Bloccare la linea prossimale via respiratoria creando una piegatura sulla linea.
- 2 La forma d'onda della pressione deve aumentare oltre la soglia di allarme PIP alta.
- 3 L'allarme di alta pressione adesso verrà triggerato, (Messaggio "Soglia di alta pressione superata").

38.1.5 Allarme volume scaduto - Volume corrente oltre/sotto la soglia

- 1 Cambiare modalità in HFO
- 2 Impostare ΔP a 80 mbar.
- 3 Aprire il pannello degli allarmi.
- 4 Ridurre la soglia di allarme Vte superiore al di sotto del valore misurato.
- 5 Attendere circa 20 secondi e l'allarme volume scaduto alto sarà triggerato, (Messaggio "Volume corrente oltre la soglia alta").
- 6 Riportare la soglia di allarme alta a 30 ml.
- 7 Ripristinare i messaggi di allarme.
- 8 Incrementare la soglia di allarme Vte inferiore oltre il valore misurato.
- 9 Attendere circa 20 secondi e l'allarme volume scaduto basso sarà triggerato, (Messaggio "Volume corrente sotto la soglia bassa").
- 10 Riportare la soglia di allarme bassa a 0 ml.
- 11 Ripristinare i messaggi di allarme.

38.1.6 Allarme Volume - Volume minuto sopra/ sotto la soglia

- 1 Ridurre la soglia di allarme Vmin superiore al di sotto del valore misurato.
- 2 Attendere circa 20 secondi e l'allarme volume scaduto alto sarà triggerato, (Messaggio "Volume minuto oltre la soglia alta").
- 3 Riportare la soglia di allarme alta a 18 l.
- 4 Incrementare la soglia di allarme Vmin inferiore oltre il valore misurato.
- 5 Attendere circa 20 secondi e l'allarme volume scaduto basso sarà triggerato, (Messaggio "Volume minuto sotto la soglia bassa").
- 6 Riportare la soglia di allarme bassa a 0 l.

38.1.7 Allarme mancanza di alimentazione elettrica - Mancanza di alimentazione e verifica batteria

- 1 Scollegare l'alimentazione elettrica di rete rimuovendo la spina dalla presa.
- 2 L'allarme guasto di alimentazione elettrica, (Messaggio "Mancanza di alimentazione elettrica").
- 3 Verificare che il simbolo CA non sia più presente, simbolo ubicato accanto all'icona batteria.
- 4 Ricollegare l'alimentazione elettrica di rete inserendo la spina nella presa.
- 5 Il messaggio di allarme verrà annullato.
- 6 Verificare che il simbolo CA sia presente, simbolo ubicato accanto all'icona batteria.

- 7 Assicurarsi che il ventilatore continui a funzionare normalmente.
- 8 Assicurarsi che sia visualizzata la percentuale della batteria.
- 9 Cambiare modalità in CMV

38.2 Test di prestazioni.

Il test di prestazioni è diviso in due fasi, convenzionale e oscillatoria.

38.2.1 Convenzionale



- 1 Rimuovere il sensore di flusso dal collettore endotracheale e occludere il collettore endotracheale.
- 2 Scollegare il sensore di flusso e premere "Continuare senza sensore di flusso".
- 3 Impostare quanto segue:
RR 30 BPM
Ti 1 secondo
PEEP 0 mbar
PIP 15 mbar
- 4 Confermare che la PIP misurata sia 15 mbar \pm 1 mbar.
- 5 Confermare che la PEEP misurata sia 0 mbar \pm 1 mbar.

38.2.2 Oscillatoria



- 1 Cambiare modalità in HFO
- 2 Impostare quanto segue:
Frequenza 5 Hz
Rapporto I:E 1:1
MAP 0 mbar
 Δ P 20 mbar
- 3 Confermare che la MAP misurata sia 0 mbar \pm 1 mbar.
- 4 Impostare la Δ P a 150 mbar
- 5 Confermare che la MAP misurata sia 0 mbar \pm 5 mbar.
- 6 Impostare la Δ P a 180 mbar
- 7 Confermare che la Δ P misurata sia >150 mbar.
- 8 Confermare che la MAP misurata sia 0 mbar \pm 12 mbar.
- 9 Mettere il ventilatore in attesa
- 10 Rimuovere il circuito di prova.
- 11 La verifica funzionale adesso è completa.

Avvertenza: se uno dei test in alto ha esito negativo, non utilizzare il ventilatore, ma sottoporlo a manutenzione rivolgendosi al personale di assistenza qualificato per la riparazione/ricalibrazione.

39. Verifica funzionale del sensore esterno

39.1 Masimo SET®



- 1 Utilizzare la configurazione standard del ventilatore come descritto in "Configurazione base del ventilatore" a pagina 42.
- 2 Collegare un circuito paziente completo e un polmone di prova.

Avvertenza: il circuito paziente utilizzato per il test funzionale non deve essere utilizzato per la ventilazione del paziente.

- 3 Non collegare un sensore di flusso.

39.1.1 Verifica funzionale Masimo SET®

Nota: per verificare gli allarmi l'utente avrà uno dei seguenti sensori Masimo Inf-3 o Masimo Neo-3 o Masimo NeoPt-3.

- 1 Configurare il sensore Masimo come descritto nella sezione '16.2 Collegamento Masimo SET®' a pagina 99.
- 2 Dalla scheda Sensore "Strumenti" premere il pulsante SpO₂.
- 3 Attivare il monitoraggio SpO₂.
- 4 Selezionare la modalità CMV.
- 5 Premere il pulsante "Continuare senza misura di flusso".
- 6 Ripristinare tutti i messaggi di allarme.
- 7 Premere il pulsante "Allarme" e selezionare la scheda "Corrente".
- 8 Sarà visualizzato il messaggio "Sensore paziente off".
- 9 Scollegare il sensore dal cavo dell'adattatore.
- 10 Comparire l'allarme "Nessun sensore SpO₂ connesso".
- 11 Ricollegare il sensore e il messaggio ritornerà a "Sensore paziente off".

39.1.2 Allarmi Masimo SET® SpO₂ e PR

- 1 L'utente dovrà applicare il sensore selezionato a un dito.
- 2 Attendere che il ventilatore mostri la lettura SpO₂ misurata.
- 3 Entrare nel pannello degli allarmi.
- 4 Incrementare la soglia di allarme SpO₂ basso oltre il valore SpO₂ misurato.
- 5 Attendere l'attivazione dell'allarme SpO₂ basso.

- 6 Ripristinare la Soglia bassa sotto al valore misurato.
- 7 Ridurre la soglia di allarme SpO₂ alta oltre il valore SpO₂ misurato.
- 8 Attendere l'attivazione dell'allarme SpO₂ alto.
- 9 Ripristinare la Soglia bassa sotto al valore misurato.
- 10 Ripristinare tutti i messaggi di allarme.
- 11 Premere il pulsante "Grafico".
- 12 Selezionare "Forme d'onda" e premere Modifica.
- 13 Impostare la forma d'onda SpO₂ su ON e premere il pulsante conferma.
- 14 Incrementare la soglia di allarme PR bassa oltre il valore PR misurato mostrato nella barra dei titoli della forma d'onda.
- 15 Attendere l'attivazione dell'allarme PR bassa.
- 16 Ripristinare la Soglia bassa sotto al valore misurato.
- 17 Ridurre la soglia di allarme PR alta oltre il valore PR misurato.
- 18 Attendere l'attivazione dell'allarme PR alto.
- 19 Ripristinare la Soglia bassa sotto al valore misurato.
- 20 La verifica degli allarmi SpO₂ adesso è completa.

39.2 MicroPod™



- 1 Utilizzare la configurazione standard del ventilatore come descritto in "Configurazione base del ventilatore" a pagina 42.
- 2 Collegare un circuito paziente completo e un polmone di prova.

Avvertenza: il circuito paziente utilizzato per il test funzionale non deve essere utilizzato per la ventilazione del paziente.

- 3 Non collegare un sensore di flusso.

39.2.1 Verifica funzionale di MicroPod™

Nota: per verificare gli allarmi l'utente darà all'utente una linea filtro™ compatibile.

- 1 Configurare MicroPod™ come descritto nella sezione '16.11 Monitoraggio EtCO₂ (MicroPod™)' a pagina 104.
- 2 Dalla scheda sensore "Strumenti" premere il pulsante etCO₂.
- 3 Attivare il monitoraggio etCO₂.
- 4 Selezionare la modalità CMV.
- 5 Premere il pulsante "Continuare senza misura di flusso".
- 6 Ripristinare tutti i messaggi di allarme.
- 7 Premere il pulsante "Allarme" e selezionare la scheda "Corrente".
- 8 Sarà visualizzato il messaggio "Sensore paziente off".
- 9 Scollegare il sensore dal cavo dell'adattatore.
- 10 Compare l'allarme "Nessun sensore SpO₂ connesso".
- 11 Ricollegare il sensore e il messaggio ritornerà a "Sensore paziente off".

39.2.2 Allarme MicroPod™ etCO₂

- 1 L'utente dovrà soffiare nella linea del filtro.
- 2 Continuare a soffiare fino a quando il ventilatore non mostra la lettura etCO₂ misurata.
- 3 Entrare nel pannello degli allarmi.
- 4 Incrementare la soglia di allarme etCO₂ basso oltre il valore etCO₂ misurato.
- 5 Attendere l'attivazione dell'allarme etCO₂ basso.
- 6 Ripristinare la Soglia bassa sotto al valore misurato.
- 7 Ridurre la soglia di allarme etCO₂ alto oltre il valore etCO₂ misurato.
- 8 Attendere l'attivazione dell'allarme etCO₂ alto.

- 9 Ripristinare la Soglia bassa sotto al valore misurato.
- 10 Ripristinare tutti i messaggi di allarme.
- 11 La verifica dell'allarme etCO₂ adesso è completa.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Istruzioni di installazione

“Disimballaggio.” a pagina 260

“Montaggio Medicart” a pagina 261

“Disimballaggio del ventilatore” a pagina 262

“Montaggio del ventilatore su Medicart” a pagina 263

“Collegamento del cavo di alimentazione elettrica” a pagina 264

“Test funzionale sull'uso preliminare.” a pagina 264

“Configurazione del ventilatore” a pagina 264



40. Istruzioni di installazione

Le seguenti istruzioni di installazione consentono all'utente di montare il ventilatore e di sottoporlo alle verifiche funzionali.

Avvertenze:

Il ventilatore deve essere avviato esclusivamente dal personale di assistenza qualificato.

Avvertenze:

Il cartone di spedizione completo del carrello del ventilatore pesa circa 60 kg. e sono necessarie 2 persone per il sollevamento.

Il cartone del ventilatore pesa circa 25 kg e la rimozione dal cartone di spedizione richiede 2 persone per il sollevamento.

Il ventilatore pesa 22 kg \pm 0,5 kg. Se il ventilatore non viene correttamente fissato al carrello, è possibile che cada durante il trasporto.

Il mancato fissaggio al ventilatore del cavo di ingresso per l'alimentazione di rete può causare la disconnessione dalla rete elettrica durante l'uso.

Il mancato fissaggio del cavo di alimentazione di rete o del ventilatore, pone la macchina in uno stato non sicuro e il ventilatore non dovrà essere utilizzato fino a quando questi due elementi non saranno rettificati.

Il seguente è l'ordine per l'installazione.

- A. Disimballaggio.
- B. Montaggio carrello.
- C. Montaggio ventilatore.
- D. Configurazione ventilatore.

Nota: il ventilatore viene fornito con la procedura di avviamento presente nella scatola degli accessori.

40.0.1 Strumenti richiesti per il montaggio del carrello


Chiave a brugola A/F da 5 mm	Q.tà 1
Chiave a brugola A/F da 3mm	Q.tà 1
Cacciavite Pozidrive	Q.tà 1

40.1 Disimballaggio.

1. Posizionare il cartone di spedizione su una superficie piatta accessibile da tutti i lati.



2. Aprire la parte superiore del cartone di spedizione e rimuovere i nastri di imballaggio (A, B & C), questo consente di accedere alla maniglia di sollevamento per il cartone del ventilatore.

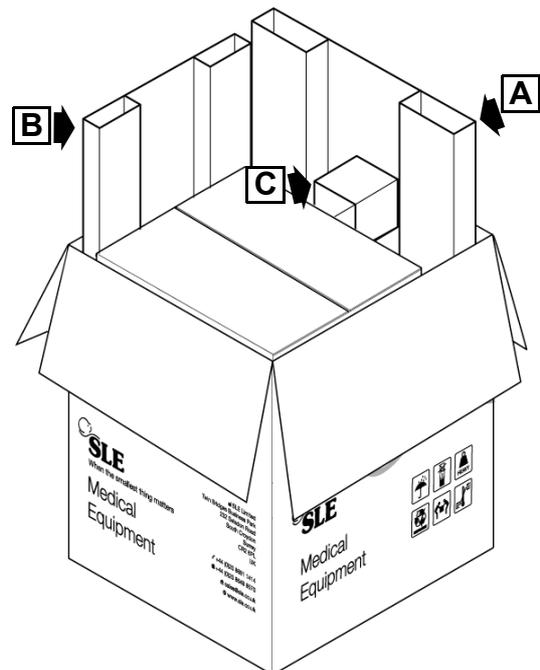

Nota: il nastro dell'imballaggio (C) può essere sostituito dalla base del riscaldatore per umidificatore.


Nota: le custodie accessorie possono essere inserite negli spazi.

3. Rimuovere il cartone del ventilatore utilizzando le maniglie di sollevamento.



Nota: per questa operazione di sollevamento dai punti D e E sono necessarie due persone.

4. Rimuovere il cartone Medicart dalla base della scatola.

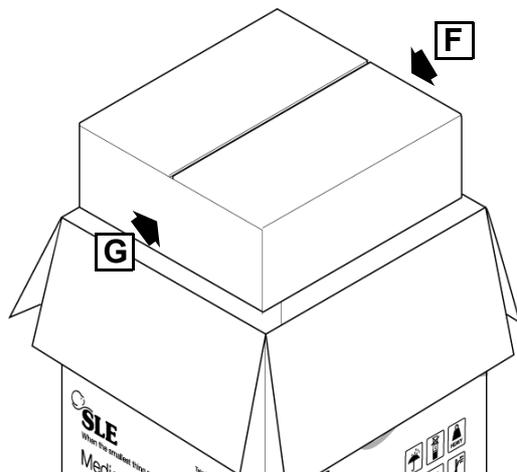

Nota: per questa operazione di sollevamento dai punti F e G sono necessarie due persone.

5. Il passaggio successivo è il montaggio di Medicart.


40.2 Montaggio Medicart

40.2.1 Contenuto del kit Medicart

Montaggio piastra superiore	Q.tà 1
Colonna di supporto.....	Q.tà 1
Piastra base con ruote.....	Q.tà 1
Gancio poggiatubo.....	Q.tà 1
Supporto umidificatore.....	Q.tà 1
Viti a testa tonda M6	Q.tà 6
Rondelle.....	Q.tà 6
Viti a testa svasata M6.....	Q.tà 10


40.2.2 Montaggio

1. Collegare la colonna di supporto alla base della ruota usando 6 viti a testa tonda e una rondella elastica. **Assicurarsi che il supporto del carrello (A) sia rivolto verso le ruote di bloccaggio (B) della base.**

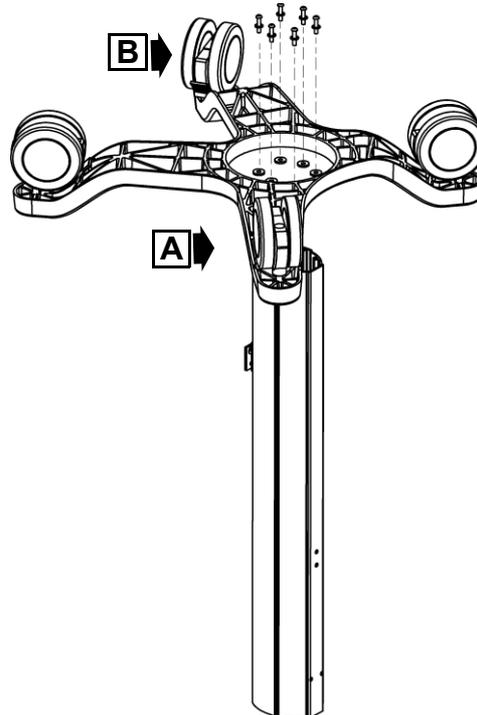


Nota: questa operazione di montaggio richiede la presenza di due persone.

2. Ruotare la base e la colonna e bloccare le ruote anteriori. Collegare la piastra superiore (C) alla colonna centrale utilizzando 6 x M6 viti a testa svasata (D).

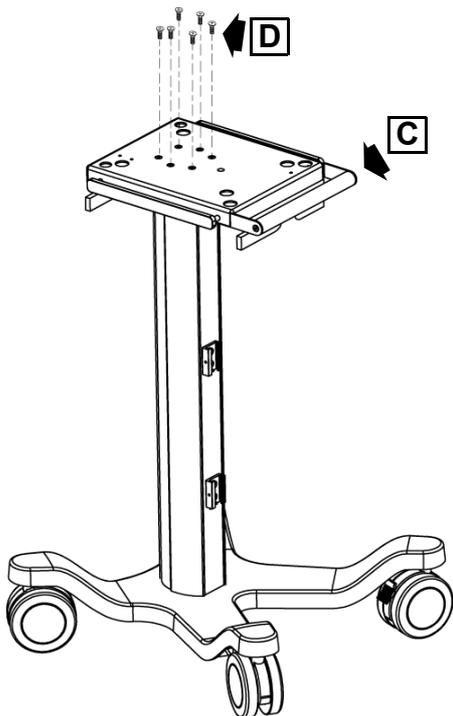

3. Collegare il gancio (E) alla colonna con 2 x M6 viti a testa svasata. Far scorrere il carrello (F) nel supporto accessorio inferiore. Viene fornita una vite opzionale per il bloccaggio.

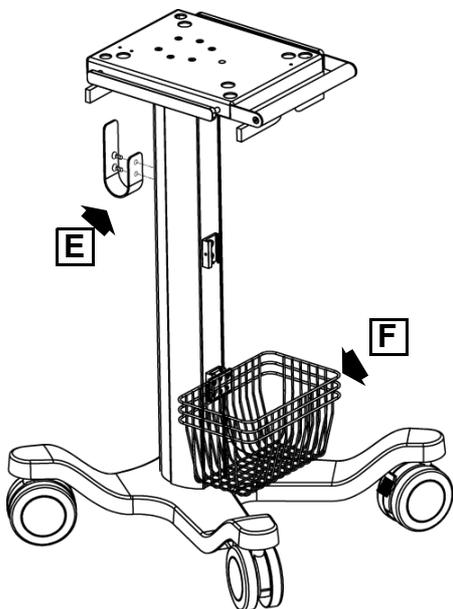


40.3 Disimballaggio del ventilatore

1. Posizionare il cartone del ventilatore su una superficie stabile piatta.




2. Rimuovere il nastro di imballaggio che fissa i lembi superiori e aprirli completamente.


3. Rimuovere gli accessori (H) presenti all'interno delle due tasche dell'inserito grande.

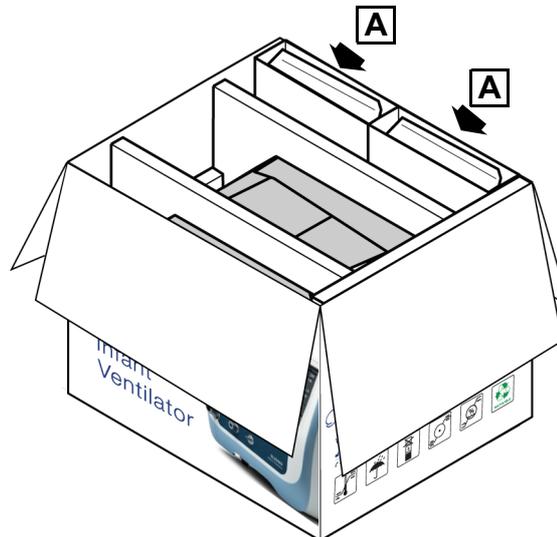


4. Rimuovere l'inserto in schiuma superiore (B) e i due inserti in cartone (C & D).

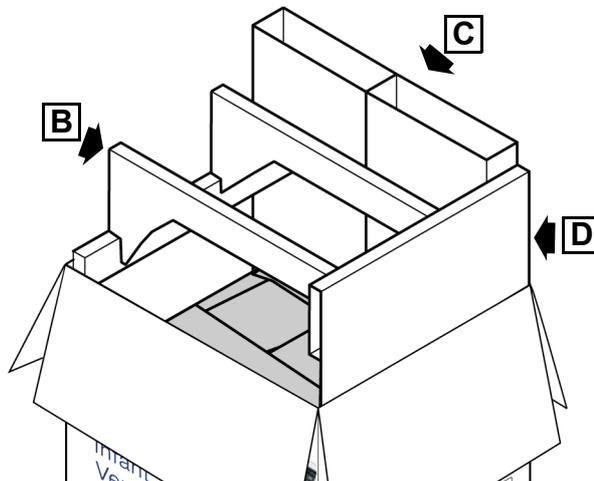

5. Sollevare il ventilatore dalla base in schiuma utilizzando il punto di sollevamento posteriore (E) e il punto di sollevamento anteriore (F). Il punto di sollevamento anteriore (F) è la presa nella parte anteriore del ventilatore che è parzialmente coperta dalla schiuma di supporto.

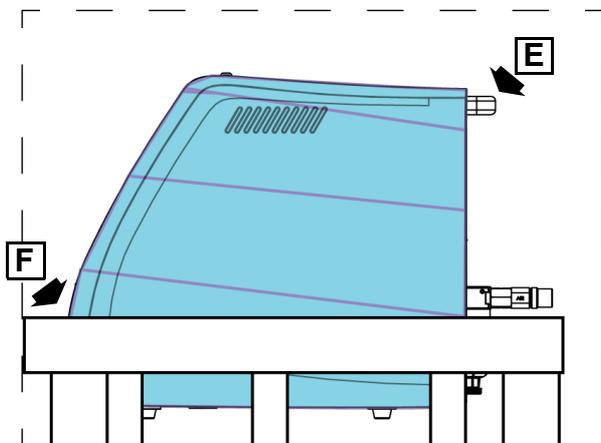

6. Posizionare il ventilatore su una superficie piana stabile e rimuovere la pellicola protettiva. Rimuovere i due coperchi protettivi rossi (L).

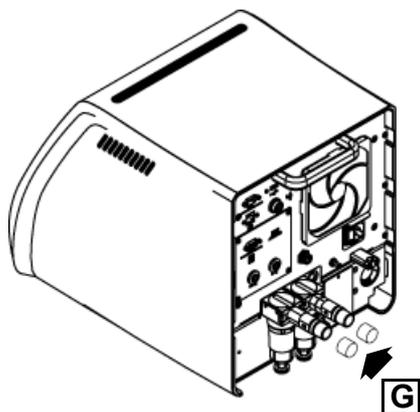


Il ventilatore adesso è pronto per essere montato su Medcart. Se il ventilatore non deve essere montato su Medcart, passare alla sezione 40.6 "Collegamento del cavo di alimentazione elettrica".

Nota: conservare l'imballo per uso futuro.

40.4 Punti di sollevamento del ventilatore


I seguenti sono i punti di sollevamento per il ventilatore.

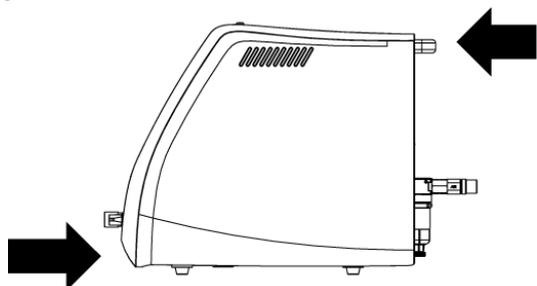

La presa anteriore e la maniglia posteriore.

40.5 Montaggio del ventilatore su Medcart


Posizionare il ventilatore su Medcart.

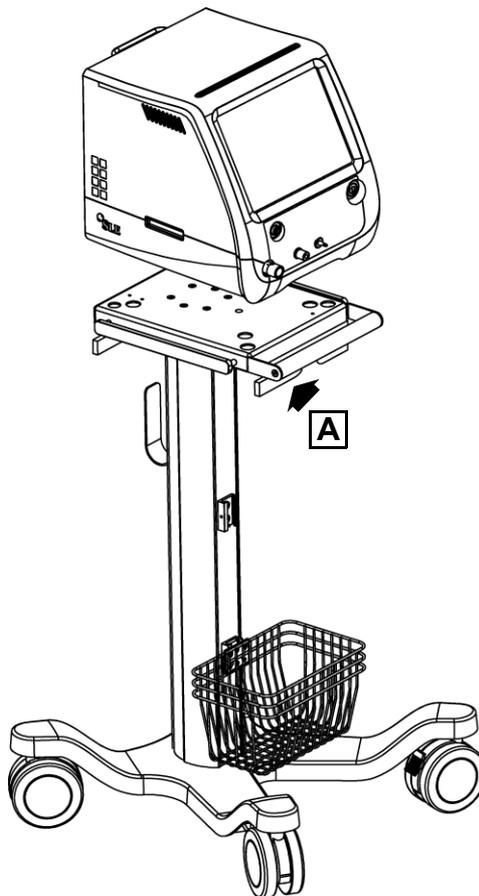

Assicurarsi che tutti i piedi sporgano dai fori del vassoio base. Fissare il ventilatore utilizzando la vite prigioniero (M) ubicata sotto la piastra base.

40.6 Collegamento del cavo di alimentazione elettrica


Il cavo di alimentazione elettrica deve essere fissato mediante il morsetto collegato.

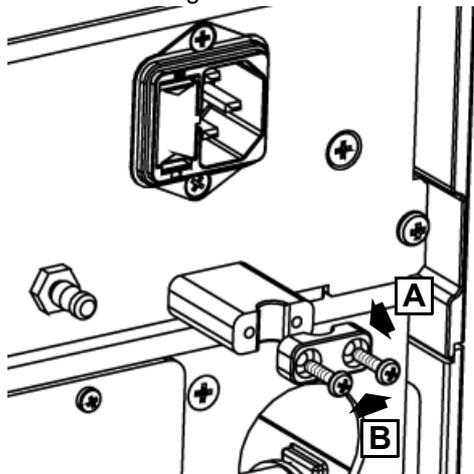

Nota: il cavo di alimentazione elettrica è presente nel pacchetto degli accessori fornito con il ventilatore

Rimuovere il morsetto del cavo (A) togliendo le due viti (B).

Inserire il cavo di alimentazione di rete (P) nella presa di ingresso.

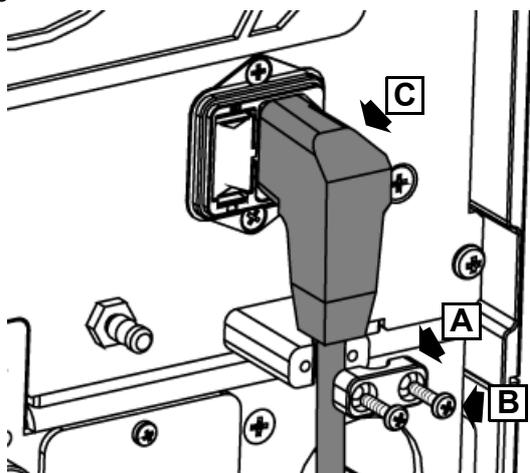

Fissare il cavo rimontando il morsetto (N) e utilizzando le due viti (O).

40.7 Test funzionale sull'uso preliminare.

Eeguire "Configurazione base del ventilatore" a pagina 42 e il "Test funzionale (Doppio lume invasivo)" a pagina 45.

40.8 Configurazione del ventilatore

Il ventilatore viene fornito con le impostazioni di fabbrica elencate nella specifica tecnica. L'utente può configurare il ventilatore impostando le funzioni definite dall'utente dall'applicazione delle preferenze operatore. **Vedere "Preferenze operatore" a pagina 266.**

Preferenze operatore

“Accesso alle preferenze operatore” a pagina 266

“Scheda Parametri” a pagina 266

“Scheda Ventilazione” a pagina 267

“Scheda Allarmi” a pagina 267

“Scheda Interfaccia” a pagina 268

“Scheda Regionale” a pagina 268

“Scheda Salva / Esci” a pagina 268



41. Preferenze operatore


In questa sezione vengono descritte tutte le funzioni dell'interfaccia delle preferenze operatore.

Nota: le preferenze operatore possono essere selezionate solo dalla "modalità Attesa".

41.1 Accesso alle preferenze operatore

Per accedere alle preferenze utente selezionare "Strumenti" o "Calibrazione/Strumenti" > "Sistema" > "Preferenze operatore".

Sarà visualizzato il tastierino numerico delle preferenze operatore.

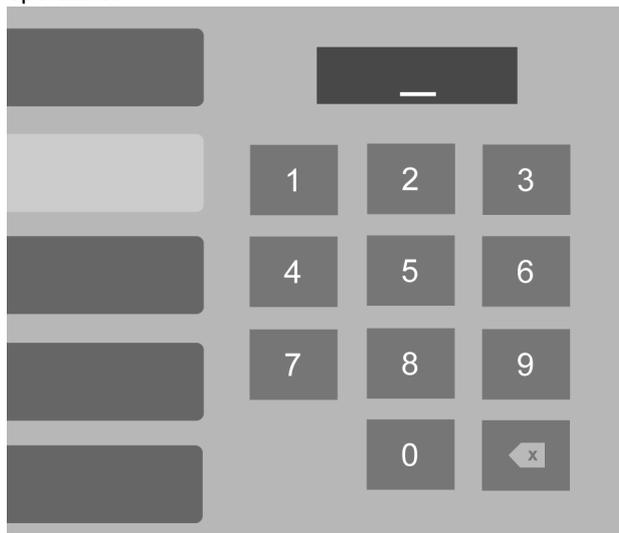

Inserire il codice predefinito di 0420 e premere il pulsante Conferma. All'utente verrà presentata la scheda "Parametri" delle preferenze operatore come predefinita.

41.1.1 Scheda Parametri

Da questa scheda, l'utente può selezionare i seguenti:

Parametri - Impostazione valori utente predefiniti per accensione.

Ventilazione - Impostazione delle impostazioni predefinite di ventilazione

Allarmi - Impostazione dei valori predefiniti di allarme.

Interfaccia - Impostazione dei valori predefiniti di interfaccia.

Regionale - Impostazione di Lingua e unità.

Salva/Esci - Salvare le impostazioni e ripristinare i valori di fabbrica.

41.1.1.1 Parametri

Da questo pannello è possibile impostare le seguenti.

Ventilazione predefinita all'avvio.

RR (BPM) Range da 1 a 150 BPM¹
Valore predefinito 30 BPM

Per. Insp. (Secondi) Range da 0,1 a 3 secondi²
Valore predefinito 0,4 secondi

PIP (mbar) Range da 0 a 65 mbar³
Valore predefinito 15 mbar

PEEP (mbar) Range da 0 a 35 mbar⁴
Valore predefinito 4 mbar

O2% Range 21 - 100 %
Predefinito 21%

VTe da raggiungere (ml) Range da 2 a 300 ml
Valore predefinito 3 ml

Rapporto I:E: 1:1 / 1:2 / 1:3
Valore predefinito 1:1

Sensibilità trigger (l/min) da 0,2 a 20 l/min
Valore predefinito 0,6 l/min

FR supporto apnea (BPM) da 1 a 150 BPM
Valore predefinito 40 mbar

MAP (mbar): da 2 a 45 mbar
Valore predefinito 5 mbar

Frequenza (Hz): da 3 a 20 Hz
Valore predefinito 10 Hz

Intervallo stabilito SpO₂ 90-94%
Predefinito 91-95%
92-96%
94-98%

Nota¹: questo parametro è limitato dal Ti impostato.


Nota²: questo parametro è limitato dalla FR impostata.

Nota³: questo parametro è limitato dalla PEEP impostata.

Nota⁴: questo parametro è limitato dalla PIP impostata.

41.1.2 Scheda Ventilazione

La scheda ventilazione imposta la preferenza per le funzioni disponibili in modalità ventilatoria.

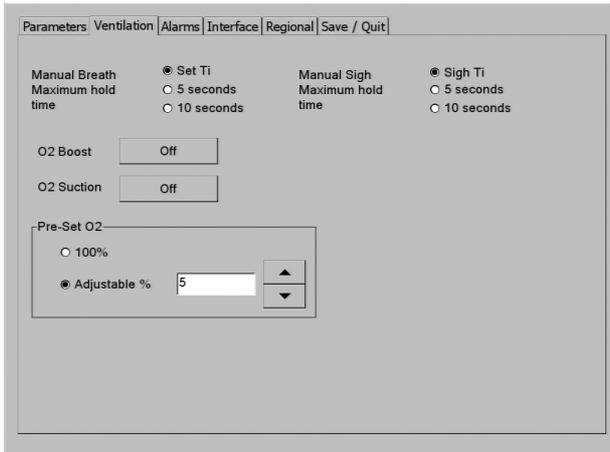

Pausa massima respiro manuale - Imposta Per. Insp., 5 secondi e 10 secondi. (Ti predefinita impostata)

Pausa massima sigh manuale - Imposta Per. Insp., 5 secondi e 10 secondi. (Ti predefinita impostata)

Aumento O₂⁵ - ON o OFF (OFF predefinito)


Aspirazione O₂⁵ - ON o OFF (OFF predefinito)

Pre-imposta O₂ per Aumento O₂ o Aspirazione O₂ - 100% o regolabile dall'1 al 10% (Predefinita 5%)

Nota⁵: è possibile abilitare solo una funzione. Se l'utente attiva una funzione e prova ad attivare l'altra, la prima funzione attiva viene automaticamente spenta.

41.1.3 Scheda Allarmi

La scheda allarme imposta le preferenze per i limiti predefiniti per gli allarmi disponibili in modalità ventilatoria.

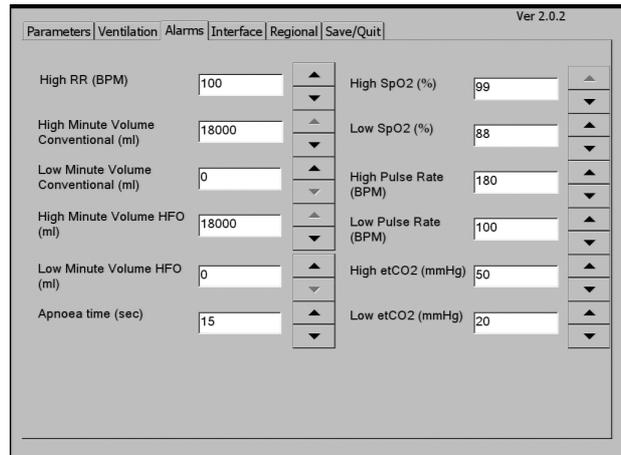

FR alta (BPM) - Range da 0 a 150 BPM (Predefinito 100 BPM)

Volume minuto alto Convenzionale (ml) - Valore predefinito 18000 ml

Volume minuto basso in convenzionale (ml) - Valore predefinito 0 ml

Volume minuto alto HFO (ml) - Valore predefinito 18000 ml

Volume minuto basso HFO (ml) - Valore predefinito 0 ml

Periodo di apnea (sec) - Range da 5 a 60 sec (Predefinito 15 sec)

SpO₂ alto - Intervallo da 6 a 99 % (Predefinito 99%) limitato dal valore SpO₂ basso.

SpO₂ basso - Intervallo da 5 a 98 % (Predefinito 89%) limitato dal valore SpO₂ alto.

Frequenza pulsazioni alta (BPM) Intervallo da 31 a 235 BPM (Predefinito 180 BPM) limitato dal valore Frequenza pulsazioni bassa.


Frequenza pulsazioni bassa (BPM) Intervallo da 30 a 234 BPM (Predefinito 100 BPM) limitato dal valore Frequenza pulsazioni alta.

etCO₂ alto (mmHg) Intervallo da 10 a 95 mmHg (Predefinito 50 mmHg) limitato dal valore etCO₂ basso.

etCO₂ basso (mmHg) Intervallo da 5 a 90 mmHg (predefinito 20 mmHg) limitato dal valore etCO₂ alto.

41.1.4 Scheda Interfaccia

La scheda Interfaccia imposta le preferenze dell'interfaccia operatore per le funzioni disponibili in modalità ventilatoria.

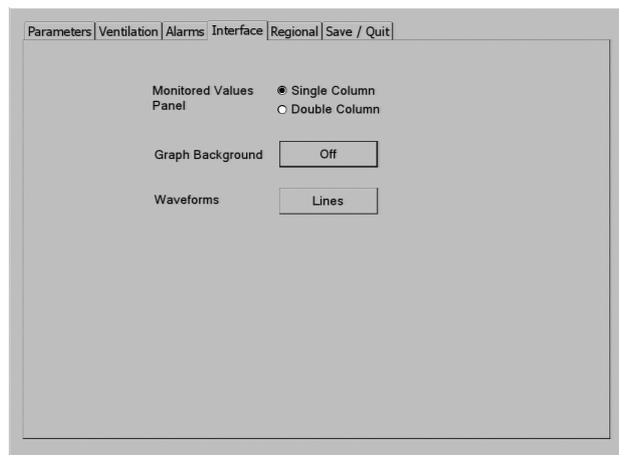


Valori monitorati pannello Colonna singola o Colonna doppia (Colonna singola predefinita)

Sfondo grafico - OFF o ON (OFF predefinito)

Forme d'onda - Linee o riempite (linee predefinite)

41.1.5 Scheda Regionale

La scheda Interfaccia imposta le preferenze dell'interfaccia operatore per le funzioni disponibili in modalità ventilatoria.

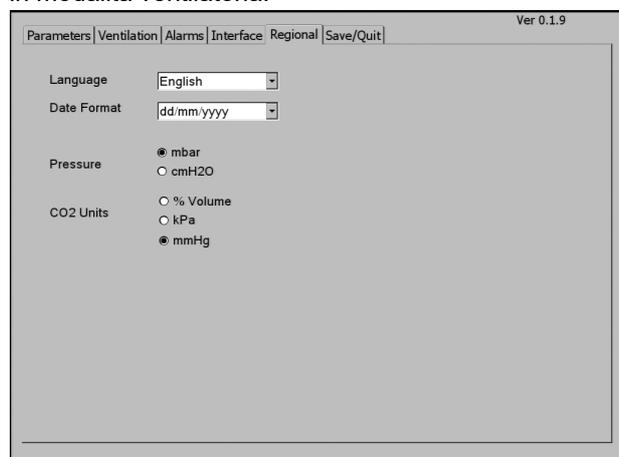

Lingua - Inglese (inglese predefinito)

Lingue disponibili:

- francese
- spagnolo
- tedesco
- italiano
- olandese
- polacco
- russo
- portoghese
- turco
- giapponese
- greco

- cinese
- ucraino
- svedese

Nota: solo per la lingua cinese se selezionata una nuova funzione diventa disponibile. La nuova funzione è per disabilitare il pulsante "Continuare senza misura di flusso" per la condizione di allarme "il sensore di flusso non è connesso".


Formato data - gg/mm/aaaa o mm/gg/aaaa (Predefinito gg/mm/aaaa)

Pressione - mbar o cmH2O (mbar predefinito)

Unità CO2 - Volume %, kPa o mmHg.

41.1.6 Scheda Salva / Esci

La scheda Salva / Esci consente all'utente di salvare o eliminare le modifiche alle preferenze operatore.

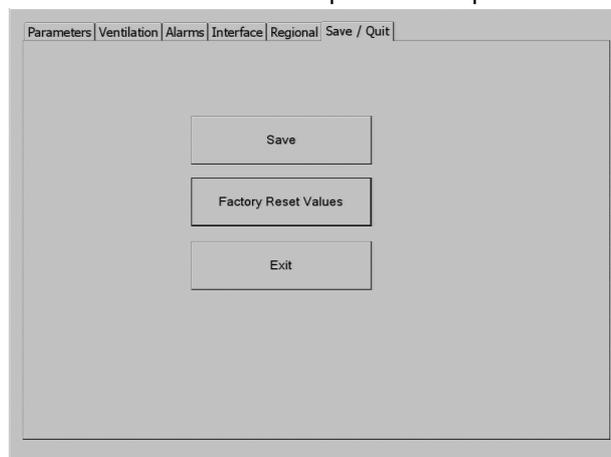

All'utente vengono presentate tre opzioni.

- Salva
- Ripristino valori di fabbrica
- Esci

Premendo Salva verranno registrate le modifiche nella memoria di sistema. Premere OK per ritornare al menu principale.

Premendo Ripristino valori di fabbrica ripristinerà il ventilatore ai valori di fabbrica, ma non registra le modifiche nella memoria di sistema. L'utente deve premere il pulsante OK o SALVA per registrare le modifiche nella memoria di sistema.

Premendo ESCI terminerà la sessione delle preferenze operatore. L'utente dovrà premere il pulsante power per 15 secondi per il ciclo.

Attenzione. Premendo il pulsante esci senza salvare, verranno eliminate tutte le modifiche effettuate in questa sessione. L'utente non avrà quindi la possibilità di riavviare e ripetere il processo.

Software log di eventi e pazienti



42. Software Log viewer eventi e pazienti SLE 6000

Attenzione: il software dati eventi e pazienti SLE 6000 è pensato esclusivamente per scopi di ricerca. Il software log di eventi e pazienti SLE 6000 non deve essere utilizzato per scopi clinici, tra cui la diagnosi o il monitoraggio del paziente.

Attenzione: assicurarsi che i dati di ventilazione esportati siano protetti in conformità con le leggi e le normative locali. Fare riferimento ai controlli e ai processi istituzionali per archiviare, salvaguardare e proteggere i dati e i file esportati sulla ventilazione.

42.1 Requisiti minimi di sistema

Sistema operativo	Windows 7
CPU.....	Pentium o compatibile, 300 MHz
Memoria	128 MB
Disco fisso.....	2 GB
Supporto.....	CD-ROM o porta USB
Display	Super VGA (800 × 600)
Dispositivi di ingresso.....	Tastiera, mouse
.Net Framework.....	versione 3.5


42.1.1 Requisiti chiavetta memoria

Tipo	USB 2
Dimensioni	minime 1 Gb

42.2 Installazione del software

Inserire la chiavetta di memoria USB SLE fornita con il ventilatore nel computer host.

Quando compare la finestra AutoPlay, selezionare "Apri cartella per visualizzare i file".

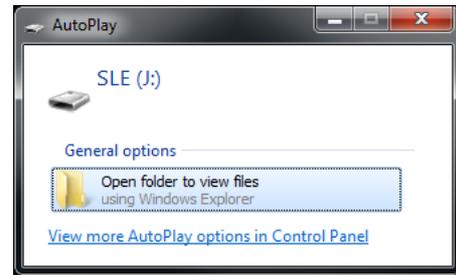

Aprire la cartella Setup Wizard.

Selezionare il file "SetupLogViewer.msi".

Fare clic con il tasto destro per la configurazione guidata "SetupLogViewer.msi" e selezionare "Installa".

Si apre la Set up wizard per il Log Viewer. Premere "Avanti" nella set up wizard

Premere "Avanti" nella finestra di dialogo Seleziona cartella di installazione

Premere "Avanti" nella finestra di dialogo Conferma installazione

Chiudere il programma di installazione

Una scorciatoia "Log Viewer" viene automaticamente installata sul desktop dell'operatore.


42.3 Download dei Dati paziente o del log di eventi

Il processo di download dei file di log è lo stesso per Dati pazienti o Eventi.


Il processo Dati Pazienti è mostrato in basso.

Accendere il ventilatore e attendere che entri in modalità Attesa.


Inserire una chiavetta di memoria USB nella porta dati sul retro del ventilatore.

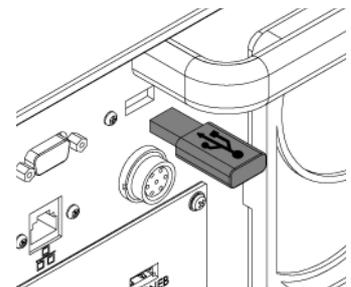


Attivare la scheda Strumenti (1) e selezionare la scheda Dati (2).

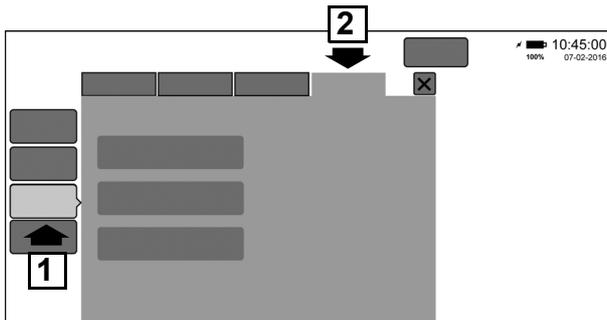


Selezionare il pulsante Dati paziente

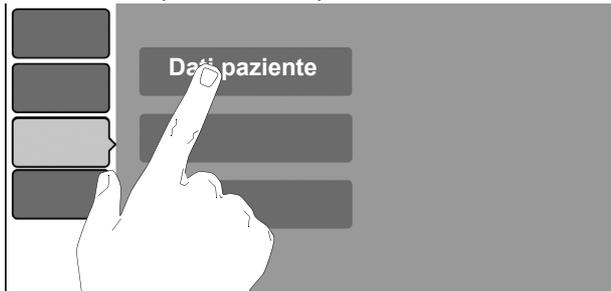

Selezionando il pulsante Dati paziente, il pulsante "Avvia esportazione" diventa attivo. Premere il pulsante per avviare l'esportazione nella memoria USB.

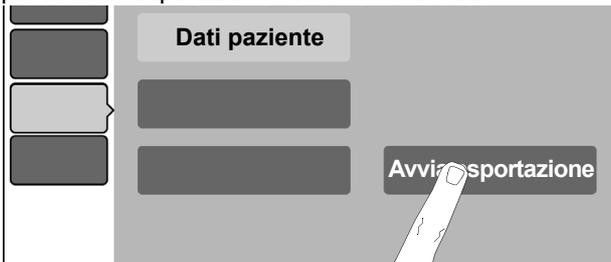

Il ventilatore mostrerà una barra di avanzamento durante il processo di esportazione, oltre al pulsante annulla che consente all'utente di terminare il processo di esportazione.

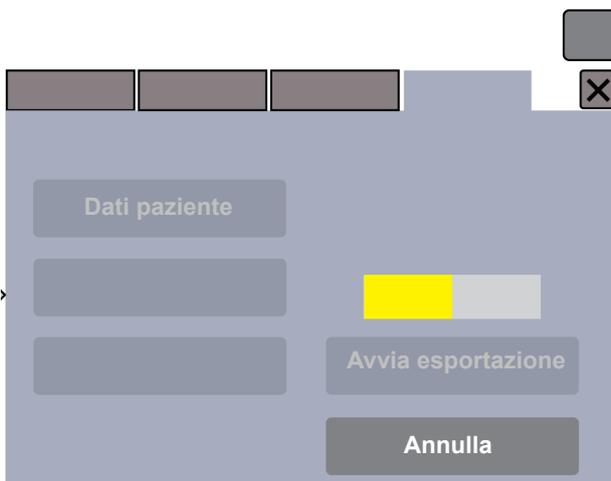

Una volta terminato, il ventilatore indicherà che l'esportazione dei dati era OK.

Rimuovere la memoria USB dal ventilatore.

42.4 Esporta formati di file

SLE6000 crea una cartella con un numero identificativo che è univoco per il ventilatore.

Esempio: ID ventilatore 1001453795

All'interno della cartella, l'utente troverà numerosi file.

Ogni file ha un prefisso con la data seguito da un codice seriale e dal tipo di file.

Esempio: 16_03_31_192222_Realtimelog.dat

Dati paziente genera 3 file:

1. 16_03_31_192222_Realtimelog.dat
2. 16_03_31_192225_AlarmsLog.txt
3. 16_03_31_192335_TrendsDataLog.dat

Il log eventi genera 2 file:

1. 16_03_31_192345_SystemLog.evt
2. 16_03_31_192225_DebugLog.evt

Nota: il ventilatore non sovrascrive i file esistenti, ma crea nuovi file con un codice seriale diverso.

Il ventilatore controlla che la memoria USB abbia uno spazio sufficiente per i nuovi file di esportazione. Se lo spazio libero non è sufficiente, il ventilatore mostrerà il seguente messaggio. "la chiavetta USB non ha spazio sufficiente. Spazio libero disponibile necessario, minimo XMB".

Nota: se l'utente esporta anche le foto schermata queste saranno posizionate nella stessa cartella.

Nome file:

16_04_01_193759_ScreenCapture_01.bmp

42.4.1 Tipi di file

Il ventilatore crea tre tipi di file, .dat .evt e .txt. I file .dat e .evt possono essere letti solo dal software di visualizzazione fornito. Il file .txt può essere letto dalla maggior parte dei programmi di testo o di calcolo.

42.4.1.1 Realtimelog

Tipo di file: 16_03_31_192222_Realtimelog.dat

Il Realtimelog memorizza i dati delle forme d'onda in tempo reale per pressione, flusso, volume e CO2 (CO2 non implementato in questa versione del software).

42.4.1.2 AlarmsLog

Tipo di file: 16_03_31_192225_AlarmsLog.txt

AlarmsLog memorizza tutte le condizioni di allarme.

42.4.1.3 TrendsDataLog

Tipo di file:16_03_31_192335_TrendsDataLog.dat

Il TrendsDataL contiene i seguenti dati sull'andamento

- 1) PIP
- 2) PEEP
- 3) MAP
- 4) CPAP
- 5) DeltaP
- 6) Vte
- 7) Vte Spont
- 8) Vmin
- 9) %VminSpont
- 10) RR
- 11) RR Spont
- 12) Triggers
- 13) CO₂
- 14) SpO₂
- 15) Resistenza
- 16) Compliance
- 17) DCO₂
- 18) Frequenza pulsazioni
- 19) SIQ
- 20) O₂ di riferimento
- 21) Impostazione FiO₂
- 22) O₂ corrente misurata

42.4.1.4 SystemLog

Tipo di file:16_03_31_192345_SystemLog.evt

SystemLog memorizza tutte le interazioni dell'utente con il ventilatore.

Incluso l'Interv. Stab. SpO.

42.4.1.5 DebugLog


Tipo di file:16_03_31_192225_DebugLog.evt

DebugLog memorizza tutti i messaggi software. Questa funzione è solo per il personale di servizio.

42.4.1.6 Record log

Ogni log può memorizzare 64.000 record a parte AlarmsLog che è limitato a 1000. Quando il log si riempie, l'elemento più vecchio inserito viene eliminato e tutti quelli correnti vengono spostati in basso per lasciare spazio a quello nuovo.

42.5 Funzioni Log Viewer

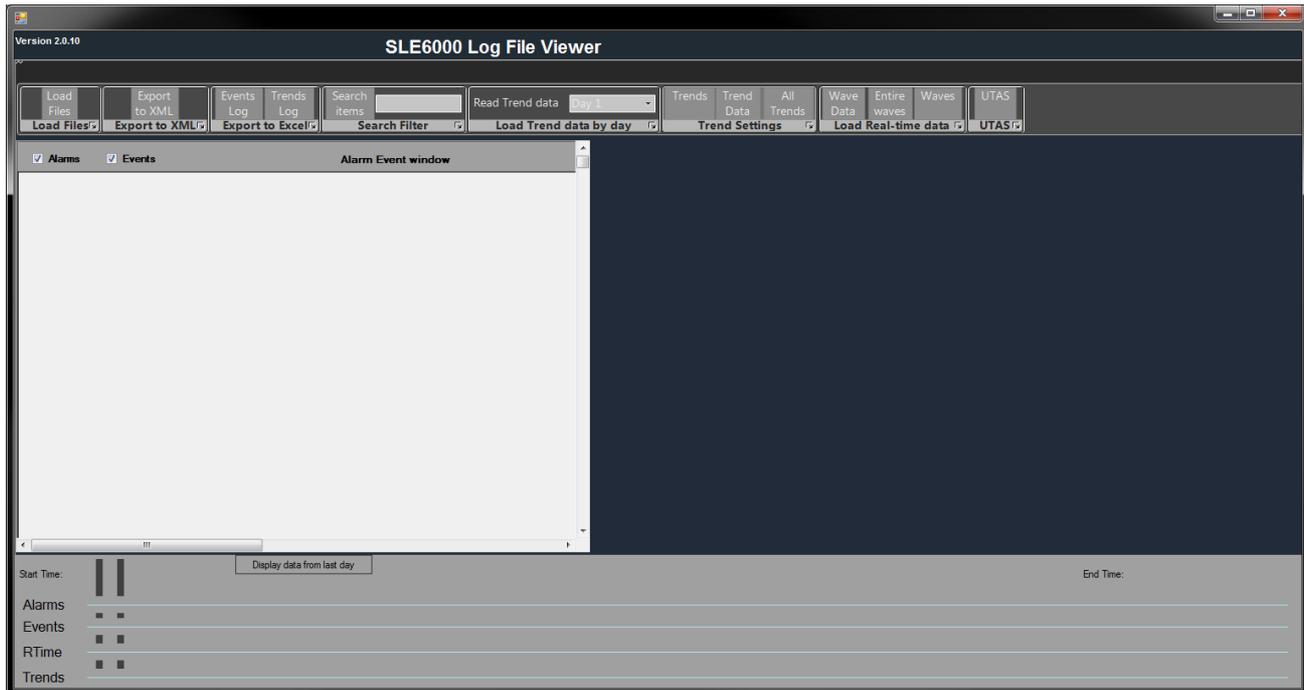


42.5.1 Carica file

Questo pulsante è utilizzato per caricare il registro eventi allarmi ("SystemLog.evt"), il log allarmi ("AlarmsLog.txt") e il log Andamenti ("TrendsDataLog.dat").



Premere il pulsante "Carica file" e selezionare i file da aprire. Per selezionare più file, premere il pulsante "Ctrl" sulla tastiera e selezionare tutti i tre file (SystemLog.evt, AlarmsLog.txt e TrendsDataLog.dat) da aprire.

Nel giro di 30 - 60 sec saranno caricati gli eventi e gli allarmi e visualizzati nella "finestra Evento allarmi" (finestra sul lato sinistro dell'applicazione).

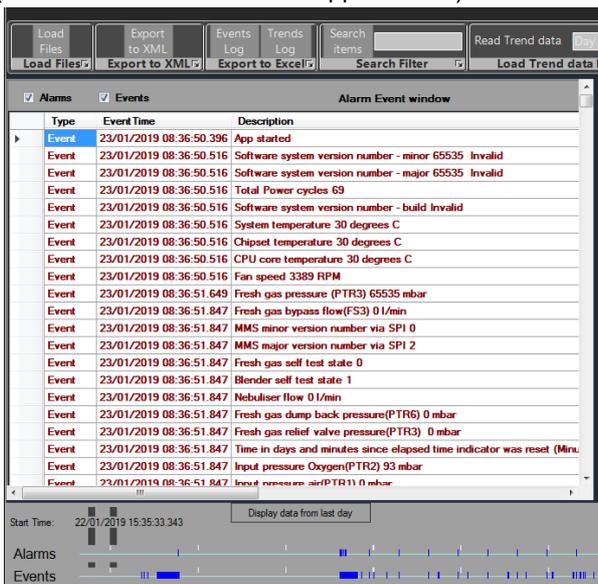

Inoltre le spunte di ora di inizio, ora di fine e orario saranno contrassegnate nel Calendario (che è nella parte bassa dell'applicazione).

Le spunte di data e ora saranno contrassegnate per Allarmi, Eventi e Trend nel colore blu scuro

42.5.2 Esporta in XML

Questa funzione salva gli Allarmi e gli Eventi come file XML.




Premere il pulsante "Esporta in XML". Fornire un nome e salvare come (*.xml)

42.5.3 Esporta in Excel

42.5.3.1 Registro Eventi Allarmi / Trend

Premere il pulsante "Registro eventi allarmi" o "Registro Trend" per salvare i dati come file Excel.



Nota: per modificare la seconda colonna nel foglio di excel e mostrare la data e ora corretti, sarà necessario modificare il formato predefinito della colonna excel.

Effettuare le seguenti operazioni nell'excel esportato.

Scegliere tutta la seconda colonna "EventTim" (cliccare una cella nella seconda colonna e premere Ctrl+ barra spaziatrice)

Fare clic con il tasto destro e selezionare "Formato celle".

Scegliere "Personalizzato" e digitare "gg/mm/aaaa hh:mm:ss.000" nel campo "Tipo" del foglio excel e premere "OK".

42.5.4 Filtro di ricerca


Questa funzione serve a cercare le voci nella finestra Evento allarme.



Digitare (per ad es.: "PIP") nella casella di testo del filtro di ricerca. Premere il pulsante "Cerca voci". Tutte le voci con il testo "PIP" saranno mostrate nella finestra Evento allarme

42.5.5 Carica dati andamento per giorno

L'applicazione Log Viewer è pronta per la lettura e per



visualizzare i dati di Trend, una volta che le spunte di data e ora sono contrassegnate nel Calendario per i Trend.

Scegliere qualsiasi data premendo la casella a discesa "Leggi dati trend" (ad es.: Giorno 14) oppure digitare manualmente il giorno come "Giorno 14"


Attendere circa 60 s (potrebbe impiegare più tempo a seconda delle dimensioni dei dati caricati. I dati di trend sono registrati ogni secondo per l'intera giornata. Quando il cursore di attesa passa al cursore mouse predefinito, la finestra "Trend / tempo reale" si aprirà sulla destra dell'applicazione con i dati Trend per il giorno scelto (ad es.: Giorno 14).

Per aprire un altro giorno dei dati trend, ripetere i passaggi in alto.

42.5.6 Impostazioni Trend

42.5.6.1 Pulsante Trend

Premere il pulsante "Trend" nel pannello "Impostazioni Trend.



Verrà mostrato il pannello di modifica Trend; dove è possibile selezionare fino a 6 parametri trend premendo la casella a discesa.

Parametri predefiniti:

- Display 1: O2
- Display 2: MAP
- Display 3: Vmin
- Display 4: SpO2
- Display 5: PEEP
- Display 6: PIP

Premere il pulsante "OK" nel pannello di modifica Trend. La visualizzazione della forma d'onda Trend potrebbe richiedere qualche secondo

Premendo l'icona play "▶" nella barra del menu, si riproduce la forma d'onda trend.

La velocità della forma d'onda del trend non può essere regolata scorrendo la barra "Velocità riproduzione" nel menu.

La riproduzione Forme d'onda può essere arrestata in qualsiasi momento premendo l'icona "I"

È possibile scorrere le forme d'onda alla data e ora desiderate regolando la barra di scorrimento "Posizione".

La schermata Forme d'onda può essere nascosta premendo il pulsante "Nascondi trend" nell'angolo in basso a destra

Il pulsante "Nascondi trend" sarà disponibile quando vengono mostrate le forme d'onda del trend.

42.5.6.2 Pulsante Dati andamento

Se dopo aver visualizzando i trend ed essere ritornati alla vista dati, questo pulsante rivisualizza i dati andamento nella tabella numerica se non visibile.

42.5.7 Tutti i trend

Il pulsante "Tutti i trend" nel pannello impostazioni Trend carica fino a 14 giorni i trend e li esporta in excel con un clic (rimuovendo in questo modo il processo manuale di selezione di ogni giorno del trend, il caricamento dei dati e quindi l'esportazione in excel.

Attenzione: l'esportazione di tutti i trend può impiegare molto tempo da pochi secondi a 30 minuti o più (a seconda di quanto veloce il ventilatore funzionava)

42.5.8 Carica dati in tempo reale

42.5.8.1 Dati d'onda

Il pulsante Dati onda caricherà la data in tempo reale utilizzando una velocità di 30 secondi.



42.5.8.2 Curve intere

Il pulsante Dati curva caricherà la data in tempo reale utilizzando una velocità di 50 millisecondi.

Attenzione: il caricamento di un'intera curva impiegherà circa 10 minuti.

42.5.8.3 Curve

Verrà mostrato il pannello di modifica curve; dove è possibile selezionare fino a 6 forme d'onda premendo la casella a discesa.

Parametri predefiniti:

- Display 1: curva di pressione
- Display 2: curva di flusso
- Display 3: curva di volume
- Display 4: curva EtCO₂
- Display 5: curva SpO₂
- Display 6: Off

Premere il pulsante "OK" nel pannello di modifica Curva.

Premendo l'icona play "▶" nella barra del menu, si riproduce la forma d'onda trend.


La velocità della forma d'onda del trend non può essere regolata scorrendo la barra "Velocità riproduzione" nel menu.

42.5.9 Opzione "UTAS"

Questa è una funzione protetta da password per uso generico.



42.5.10 Calendario

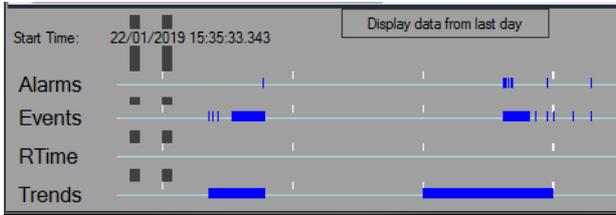

Alla fine dell'applicazione, c'è una barra che mostra l'Ora di inizio e l'ora di Fine dei dati esportati (che è di 14 giorni di dati).

Ci sono due linee verticali nel calendario (chiamato cursore sinistro e cursore destro)

I dati Allarmi, Eventi e Trend saranno mostrati in blu scuro nel calendario, in modo che l'utente possa trascinare questi cursori in blu. Allarmi ed Eventi (e andamenti se caricati) saranno aggiornati automaticamente in base alle posizioni del cursore sinistro e destro.

La prima volta, fare clic sul cursore sinistro e trascinarlo.

42.5.11 Mostra dati ultimo giorno

Premere questo pulsante in Calendario per mostrare eventi, allarmi e trend nell'ultimo giorno (14 giorno).

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

43. Formazione (utente)

SLE fornisce corsi di formazione per gli utenti per il ventilatore infantile SLE6000.

Formazione utente finale

SLE, o il loro distributore, offre il supporto clinico a tutti gli utenti dei ventilatori SLE. Tutto questo sempre con la coordinazione dello Specialista di vendite locale o il Distributore per garantire l'ottimizzazione del tempo. Nel corso dell'installazione del ventilatore, uno specialista garantirà che gli utenti riceveranno una formazione approfondita sui prodotti SLE.

Formazione continua

Una volta che il ventilatore è stato installato e messo in servizio, SLE o il personale del supporto clinico del Distributore, sarà disponibile nella NICU, con il personale medico e infermieristico, per rispondere alle domande che potrebbero sorgere e offrire ulteriore supporto.

Specialista in workshop in vivo

SLE supporta seminari di ventilazione guidati da medici; i seminari sono pensati per Neonatologi e Intensivisti Pediatrici.

In alcuni paesi SLE sponsorizzerà un esperto clinico per la presentazione di un seminario utilizzando un polmone animale preparato per dimostrare come si recluta un polmone. Questo di solito è mirato a Aiuto medici, Medici interni e personale infermieristico senior.

Inoltre, SLE esegue ogni anno una serie di workshop di ventilazione in vivo in tutto il mondo. Questi corsi sono pensati per i medici e si focalizzano sulle strategie protettive dei polmoni. Utilizzando un modello in vivo, questi seminari sono partecipativi e includono sia la ventilazione convenzionale che l'oscillazione ad alta frequenza.

Contattare SLE Ltd.

Chiedere della "formazione utente finale"

Telefono: **+44 (0)20 8681 1414**

Fax: **+44 (0)20 8649 8570**

E-mail: **sales@sle.co.uk**

44. Formazione (assistenza)

SLE fornisce corsi di formazione di assistenza per il ventilatore infantile SLE6000.

I corsi coprono l'assistenza e la manutenzione dell'hardware e del software del ventilatore infantile SLE6000.

Contattare SLE Ltd.

Chiedere della "Formazione per assistenza"

Telefono: **+44 (0)20 8681 1414**

Fax: **+44 (0)20 8649 8570**




E-mail: **service@sle.co.uk**

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Parti consumabili e accessori










45. Parti consumabili e accessori






Parti consumabili	Immagine	Codice
Circuito paziente da 10 mm (monouso). Confezione da 15		BC6188/15
Circuito paziente da 10 mm (monouso) Cavo riscaldato doppio con camera. Scatola di 7		BC6188/DHW/07
Circuito paziente da 10 mm (monouso) Cavo riscaldato doppio senza camera. Scatola di 15		BC6288/DHW/15
Kit adattatore ossido nitrico (monouso) per l'uso con circuiti paziente con prefisso BC		BC6110/KIT/5
Gruppo tubo di scarico doppio per lo scarico dell'ossido nitrico		N4110/10
Sensore di flusso (autoclavabile).		N5402-REV2
Sensore di flusso (sterile monouso). Confezione da 5		N5302/05
Sensore di flusso (sterile monouso). Confezione da 50		N5302/50
Silenziatore (Monouso) Confezione da 20		N2186/SU/20
Silenziatore (Monouso) Confezione da 50		N2186/SU/50

Avvertenza. L'uso di cavi diversi da quelli elencati in basso potrebbe produrre un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica

Accessori	Immagine	Codice
Configurazione centrale SLE6000 Modulo software		Z6000/COR
Modulo software SLE6000 HFOV (incluso HFOV VTV)		Z6000/HFO
Modulo software NIV a singolo lume SLE6000		Z6000/SLN
Modulo software per terapia con ossigeno SLE6000		Z6000/O2T
Modulo software SLE6000 VTV (ventilazione convenzionale)		Z6000/VTV
Modulo software di monitoraggio SLE6000 ETCO2		Z6000/ETC
Modulo software di monitoraggio SLE6000 Masimo SpO ₂		Z6000/SPO
Modulo software SLE6000 NIPPV Tr.		Z6000/NIP
SLE6000 OxyGenie® O ₂ Modulo software a circuito chiuso		Z6000/CLP
Cavo di connessione del sensore di flusso con rivestimento antimicrobico. 1,5 m		N6656
Cavo SLE uSpO ₂ (Masimo SET) (Cavo da 1,8 m) e kit confezione campione sensore LNCS		L6000/SP2/KIT
MicroPod™ Microstream™ modulo etCO ₂		LETC2/RS03000
Kit di montaggio MicroPod™ (Vesa)		LETC2/9279
Kit di montaggio MicroPod™ (Clip)		LETC2/9283
Kit software di calibrazione MicroPod (cavo di collegamento LEMO 1 m)		LETC2/9348
Cavo di alimentazione di rete (1,5 m) UK spina a 3 pin e connettore IEC a 90°		M0255/095
Cavo di alimentazione di rete (1,5 m) spina Shuko (europea) e connettore IEC a 90°		M0255/096
Cavo di alimentazione di rete (1,5 m) Nema North American) spina e connettore IEC a 90°		M0255/097
Cavo RS232 (2 m)		L6000/232/001
Cavo video VGA (maschio a maschio) 2 m		L6000/VGA/001
Cavo chiamata infermiera (3 m interamente collegato)		L6000/NCW/001
Cavo chiamata infermiera (3 m normalmente aperto)		L6000/NCO/001
Cavo chiamata infermiera (3 m normalmente chiuso)		L6000/NCC/001
Cavo di ingresso CC (2 m)		L6000/0DC/001

Accessori

Accessori	Immagine	Codice
<p>Blocco di esalazione di ricambio.</p>		<p>N6622</p>
<p>Silenziatore (sterilizzabile in autoclave)</p>		<p>N2186/01</p>
<p>Gruppo sifone ossigeno</p>		<p>L6000/XWT</p>
<p>Tubo O₂, lunghezza 3 metri - dado 90° NIST alla sonda BS. Tubo colore bianco.</p>		<p>N2035/RAC/001</p>
<p>Tubo dell'aria, lunghezza 3 metri - dado 90° NIST alla sonda BS. Tubo colore nero.</p>		<p>N2199/RAC/001</p>
<p>Tubo O₂, lunghezza 3 metri - DISS maschio a DISS femmina a 90°. Tubo colore bianco</p>		<p>N2035/RDS/001</p>
<p>Tubo dell'aria, lunghezza 3 metri - DISS femmina a DISS maschio a 90°. Tubo colore nero</p>		<p>N2199/RDS/001</p>

Accessori	Immagine	Codice
<p>Tubo O₂, lunghezza 4,3 metri - DISS maschio a DISS femmina a 90°. Tubo colore verde</p>		N2035/RAD/GRN
<p>Tubo dell'aria, lunghezza 4,3 metri - DISS femmina a DISS femmina a 90°. Tubo colore giallo</p>		N2199/RAD/YEL
<p>Base per riscaldatore umidificatore MR850. (230V) Solo per UK.</p>		N3850/00
<p>Base per riscaldatore umidificatore MR850. (230V)</p>		N3850/01
<p>Adattatore riscaldatore per l'uso con circuiti paziente e camere monouso e base per riscaldatore umidificatore MR850.</p>		N5600
<p>Adattatore riscaldatore doppio per l'uso con circuiti paziente e camere monouso e base per riscaldatore umidificatore MR850.</p>		N5601
<p>Adattatore riscaldatore MR858 per l'uso con circuiti paziente e camere riutilizzabili e base per riscaldatore umidificatore MR850.</p>		N3858
<p>Sonda di temperatura doppia MR860 (per umidificatore F&P serie 850).</p>		N3860
<p>Polmone di prova.</p>		N6647

Accessori	Immagine	Codice
Medicart con due ruote bloccabili, cesto, gancio poggiatubo e supporto.		N6690
Starter Kit controller USB Aerogen Solo - UK		L1025/SLU/0UK
Starter Kit controller USB Aerogen Solo - Nord Europa		L1025/SLU/0NE
Starter Kit controller USB Aerogen Solo - Europa centrale		L1025/SLU/0CE
Starter Kit controller USB Aerogen Solo - Europa dell'est		L1025/SLU/0EE
Starter Kit controller USB Aerogen Solo - Europa del Sud		L1025/SLU/0SE
Starter Kit controller USB Aerogen Solo - Scandinavia		L1025/SLU/0SC
Starter Kit controller USB Aerogen Solo - Russia e Paesi Baltici		L1025/SLU/0RB
Braccio per circuito paziente.		N6627/212
Istruzioni per l'uso per SLE6000. (inglese)		UM165/UK
Istruzioni per l'uso per SLE6000. (francese)		UM165/FR
Istruzioni per l'uso per SLE6000. (spagnolo)		UM165/ES
Istruzioni per l'uso per SLE6000. (tedesco)		UM165/DE
Istruzioni per l'uso per SLE6000. (Italiano)		UM165/IT
Istruzioni per l'uso per SLE6000. (turco)		UM165/TR
Istruzioni per l'uso per SLE6000. (polacco)		UM165/PL
Istruzioni per l'uso per SLE6000. (portoghese)		UM165/PT
Istruzioni per l'uso per SLE6000. (olandese)		UM165/NL
Istruzioni per l'uso per SLE6000. (russo)		UM165/RU
Istruzioni per l'uso per SLE6000. (ucraino)		UM165/UA
Istruzioni per l'uso per SLE6000. (greco)		UM165/GR
Istruzioni per l'uso per SLE6000. (svedese)		UM165/SE
Istruzioni per l'uso per SLE6000. (cinese)		UM165/CN
Istruzioni per l'uso per SLE6000. (giapponese)		UM165/JP
Manuale di assistenza per SLE6000 (solo inglese)		SM38



46. Glossario

ASCII	L'American Standard Code for Information Interchange è il formato più comune per i file di testo in informatica. Non adatto a lingue contenenti caratteri accentati o speciali, ma appropriato per caratteri numerici.
O ₂	Ossigeno
°C	Gradi Celsius
°F	Gradi Fahrenheit
»	Uguale circa a
bar	Unità di pressione barometrica
BPM	Respiri al minuto
BTPS	Temperatura corporea e pressione saturata
C20/C	Rapporto della compliance durante l'ultimo 20% del ciclo respiratorio raffrontata all'intero ciclo
cm	Centimetro
cmH ₂ O	Centimetri d'acqua
CMV	Ventilazione obbligatoria continua
Compl. o C	Conformità
CPAP	Pressione positiva continua delle vie respiratorie
CPU	Unità di elaborazione centrale
DCO ₂	Coefficiente di trasporto del gas, basato sul volume corrente e sulla frequenza.
DHW	Cavo riscaldato doppio
dP	Pressione Delta
DPI	Punti per pollice
EMC	Compatibilità elettromagnetica
ES	Sensore esterno
ESMO	Sensore esterno e monitor
ET	Endotracheale
etCO ₂	CO ₂ corrente finale
GHz	Gigahertz
GMDN	Nomenclatura globale per dispositivo medico.

HFOV	Ventilazione ad alta frequenza oscillatoria
HFNC	Cannula nasale alto flusso
Hz	Hertz (cicli al secondo)
I:E	Rapporto inspirazione/espiazione
Tempo insp	Tempo inspiratorio
ISM	Industriale, scientifico e medico
kg	Chilogrammo
kHz	Kilohertz
LED	Diodo ad emissione luminosa
LF	Bassa frequenza
l/min	Litro al minuto
mbar	Millibar
MHz	Megahertz
MMS	Sistema di gestione messaggistica
ml	Millilitri
ms	Millisecondo
P media	Pressione media
NEEP	Pressione negativa espiratoria finale
NIPPV	Ventilazione pressione positiva intermittente nasale
NCPAP	Pressione positiva continua delle respiratorie per via nasale
NHFO	Oscillazione ad alta frequenza nasale
MAP	Pressione media vie respiratorie
MO	Uscita monitor
O ₂ %	Percentuale di ossigeno
PCLC	Controller a circuito chiuso fisiologico
PEEP	Pressione positiva espiratoria finale
PIP	Massima pressione inspiratoria
POST	Accensione per test automatico
PPM	Manutenzione preventiva programmata
PR	Frequenza pulsazioni
psi	Libbre per pollice quadrato
PSU	Unità di alimentazione
PTV	Ventilazione triggerata dal paziente
RF	Frequenza radio

RR	Frequenza respiratoria
Resistenza o R	Resistenza
RS232C	RS232 è uno standard consolidato per la comunicazione di dati seriali a bassa velocità; "C" sta a indicare la versione corrente.
SaO ₂	Ossigeno arterioso saturo
SIMV	Ventilazione obbligatoria intermittente sincronizzata
SIQ	Identificazione e qualità del segnale
SpO ₂	Saturazione di ossigeno nei capillari periferici
STPD	Standard di temperatura e pressione a secco.
Ti (T insp)	Tempo inspiratorio
VTV	Ventilazione a volume prefissato
tcPCO ₂	Anidride carbonica transcutanea
tcPO ₂	Ossigeno transcutaneo
UI	Interfaccia utente
USB	Bus seriale universale
VLBW	Peso molto basso alla nascita
VGA	Matrice grafica video
Cont. vol.	Controllo volume
V esp (ml)	Controllo volume espirato in millilitri
V insp (ml)	Volume inspirato in millilitri
Vmin (l)	Volume minuto in litri
Vt	Volume corrente
Vte	Volume corrente espiratorio


47. Marchi e simboli SLE6000
47.1 Descrizione dei marchi del ventilatore

	Simbolo di avvertenza generale
	Simbolo di avviso
	Avvertenza, elettricità
	Fare riferimento al manuale/ opuscolo di istruzioni
	Simbolo parte applicata tipo BF
	Simbolo infermiera
	Porta Ethernet
	Porta VGA
	Porta Display

	Porta USB
	Simbolo per equipotenzialità
	Icona corrente diretta
	Peso dispositivo
	On/Off
	Marchio CE e numero organismo notificato
	Numero seriale
	Produttore
	Data di fabbricazione
	Simbolo WEEE

47.2 Descrizione dei marchi opzionali

.Ubicati lateralmente sul ventilatore

	Specifica software centrale e numero versione software opzionale.
	Opzione software ventilazione HFO. HFOV, HFOV+CMV e nHFOV
	Ventilazione a volume prefissato, software opzionale.
	Software opzionale non invasivo. nCPAP e DuoPAP
	Software opzionale non invasivo. NIPPV Tr.
	Monitoraggio Masimo SpO ₂ software opzionale.
	Monitoraggio Microstream™ etCO ₂ software opzionale.

47.3 Descrizione dei marchi di interfaccia.





	Simbolo di avvertenza
	Icona alimentazione di rete
	Icona corrente diretta
	Icona batteria 100%
	Icona batteria 0%
	Simbolo fusibile
	Audio in pausa
	Limite allarme superiore
	Limite allarme inferiore

	Foto schermata
	Indietro
	Chiudi
	Scorri su
	Scorri giù
	Ingrandisci (Zoom)
	Riduci (Zoom)
	Scorri a sinistra (Cursore)
	Scorri a destra (Cursore)

	Scorri a sinistra (Scorri)
	Scorri a destra (Scorri)
	HFO in fase di espirazione solo.
	HFO in fase di inspirazione ed espirazione.
	Schermata bloccata
	Play
	Pausa
	Conferma

47.4 Descrizione dei marchi Micropod™.

	<p>Attenzione</p>
	<p>Protezione defibrillatore tipo BF</p>
	<p>Ingresso gas</p>
	<p>Uscita gas</p>
	<p>Solo su prescrizione medica</p>
	<p>Marchio CE</p>
	<p>Simbolo WEEE</p>

SLE si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso le modifiche ritenute necessarie od opportune ad apparecchiature, pubblicazioni e prezzi.

Cronologia revisioni

Rev.	Data	Rif. modifica
1	30/04/ 10208	Numero iniziale
2	18/07/2018	CR1709
3	16/11/2018	CN 101 CR 1746 CR 1800 CR 1801 CR 1802 CR 1824 CR 1858
4	21/11/2018	CR 1889
5	11/07/2019	CR 1918 Mantis 1768 CR 1951 Mantis 1978 CR 1952 Mantis 2185 CR 1962 Mantis 2203 CR 2316 Mantis 2345 Mantis 2361
6	13/03/2020	CN 176



+44 (0)20 8681 1414



+44 (0)20 8649 8570



sales@sle.co.uk



www.sle.co.uk



SLE Limited

Twin Bridges Business Park

232 Selsdon Road

South Croydon

Surrey

CR2 6PL

UK



When the smallest thing matters